





Für den ersten Schritt der Matrix-Regeneration werden, basierend auf den vorangegangenen EDA-Messungen, Frequenzen (*Raymedys*) ausgewählt und in Form von galvanischem Strom angewandt.

- Der Klient liegt auf dem Bauch.
- Tragen Sie die Aloe-Restorate-Mischung (2TL:1TL, eventuell angewärmt) auf die angezeigten Hautareale auf.
- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Schließen Sie den Dermalroller (-) **an die schwarze i-Matrix-Buchse** an der Vorderseite des i-MATRIX an.
- **Mit der Null-Elektrode (+)** verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der **roten** i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes.
- Stellen Sie den Schalter auf **ON**. Stellen Sie sicher, dass die Stabantenne an der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Wenn die kabellose Übertragung nicht ausreichend arbeitet, erscheint eine Error-Meldung, die wieder verschwindet, sobald die notwendigen Maßnahmen durchgeführt worden sind.
- **Passen Sie die Amplitude an.** Die Stromamplitude kann mittels Cursor entlang der vertikalen Säule auf der rechten Seite des Bildschirms angepasst werden. Abhängig von Klient und der zu behandelnden Körperregion wird die Stromstärke unterschiedlich stark empfunden. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.

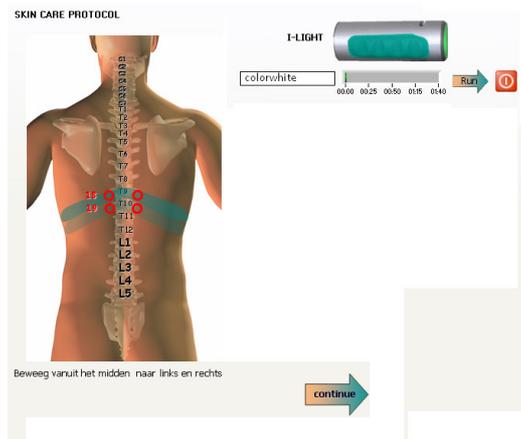


- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Klicken Sie auf den **run**-Pfeil neben dem oben angezeigten Raymedy.

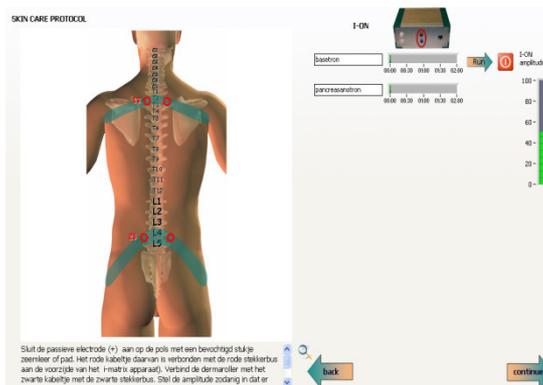


- Behandeln Sie die angegebene Zone mit dem Dermalroller. Bewegen Sie den Dermalroller **entlang der angezeigten Hautzonen**, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts. Die Behandlungszeit ist auf länger als 1 Minute voreingestellt, aber Sie können das Procedere für jedes Dermatome wiederholen oder auch jederzeit abbrechen.
- Mit Klick auf den **run**-Pfeil neben dem zweiten angezeigten Raymedy wird dieses aktiviert.
- Klicken Sie auf den **continue**-Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen.



- Entfernen Sie die Aloe-Restorate-Mischung sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf **continue** rechts unten fahren Sie im Programm fort.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch. (Ölreste reflektieren das Licht der nachfolgenden Behandlung. Es kann nicht in der Tiefe wirken.)

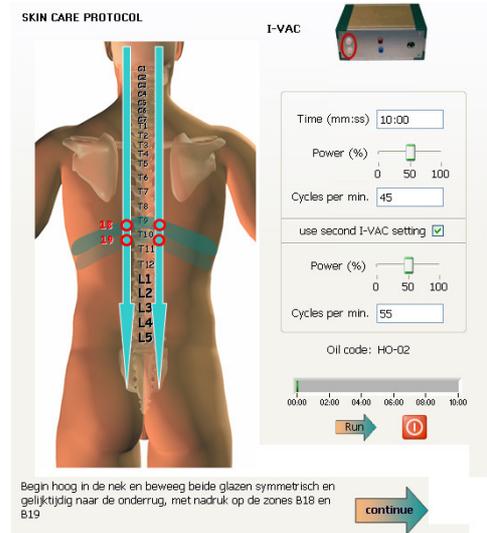

- Arbeiten Sie nun mit einem Schröpfglas weiter
 - von außen zur Wirbelsäule im gesamten Rückenbereich,
 - auf dem Blasenmeridian in angegebener Richtung
 - und direkt auf der Wirbelsäule (Matrixdrainage).
- Entfernen Sie das Öl mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).

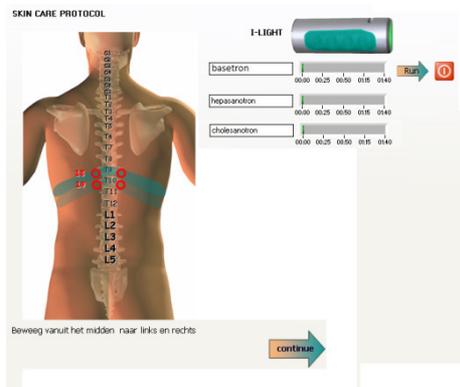



- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue**.
- Das Programm bittet Sie, eine weitere **EDA-MESSUNG** vorzunehmen.





ELIMINATION

- Klicken Sie auf den blinkenden Pfeil in der oberen Bildschirmhälfte, um mit dem 4. Schritt des Regenerationsprogramms zu beginnen, der Elimination.
- Ihr Klient liegt auf dem Rücken, der Bauch ist frei.
- Tragen Sie die dazugehörige Ölkombination auf die unten angegebenen Hautzonen auf (in diesem Fall Öl mit Essenz **AA-3**).
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf `run`.
- **Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:**
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
 2. Zwischen dem Großzeh und der 2. Zehe (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen
- Wechseln Sie auf das große Schröpfglas:
 1. Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
 2. Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Verlauf von Lebermeridian)
- 3. In den Achselhöhlen
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.

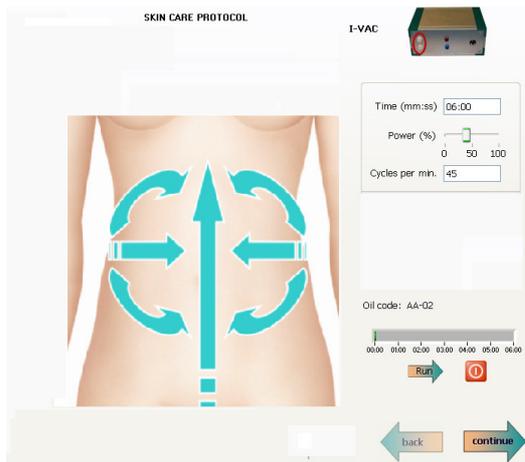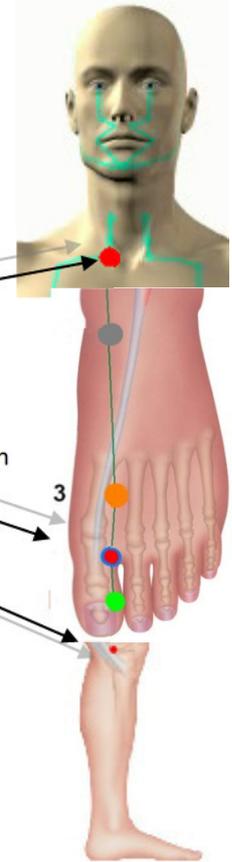


- Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite an und bewegen Sie diese wie angezeigt zur Bauchmitte hin, dann von der linken und rechten Bauchseite nach oben und wieder von der linken und rechten Bauchseite seitwärts bis zum Schambein.
- Folgen Sie dann mit den Schröpfköpfen dem Konzeptionsgefäß in der angegebenen Pfeilrichtung. Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Es reflektiert!)

- Das Programm bittet Sie wieder, eine **EDA-MESSUNG** vorzunehmen.
- Danach führt Sie ein Klick auf `continue` zum 5. Schritt des Programms.



KONSOLIDIERUNG

- Verbinden Sie den Stecker des Beamers mit dem **i-Matrix**.
- Klient in Rückenlage
- Halten Sie den Beamer auf den angezeigten Punkt.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf `run`.
- Da das „ProgrammDetox Körper“ eher abkühlend wirkt, geben Sie mit der „China Lampe“ 15 Minuten Wärme auf den Bauch!
- Mit Klick auf `continue` beenden Sie das Protokoll.

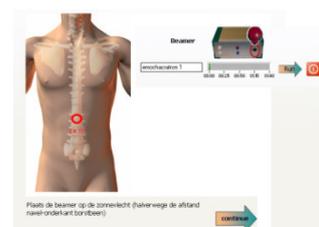

Protocoll is finished.




SKIN CARE PROTOCOL



Folgende Mischung muss vor der i-ON-Anwendung zubereitet werden: **Aloe vera (2 EL) + Restorate (1 TL)**


VORBEREITUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die Aloe+Restorat-Mischung auf den Nacken auf.
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Nutzen Sie den Ständer!)
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**.

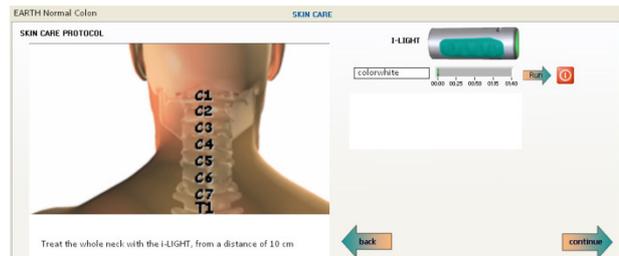


- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **rote** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf **Stopp**.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.

NACKENBEHANDLUNG MIT I-ON

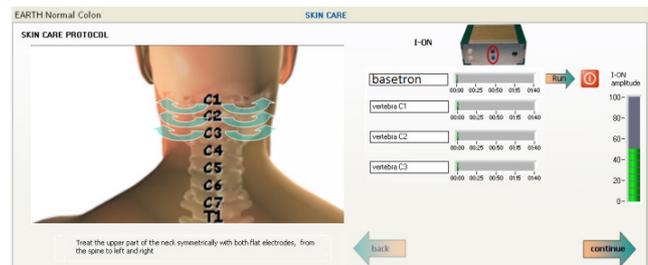

- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt passend zu den einzelnen Halswirbeln.
- Klicken Sie auf **run**, um die Raymedys zu aktivieren.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Mit Klick auf **continue** kommen Sie weiter.

NACKENBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

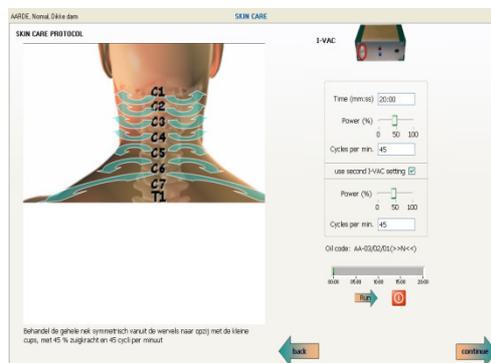

Klient in Bauchlage

- Tragen Sie die angegebene Ölkombination (2Tl :8Tr) angewärmt auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-VAC**.
- Wenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Es reflektiert!).
- Klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.




NACKENBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer!)
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das i-LIGHT
- Mit Klick auf “Continue” kommen Sie zur nächsten EDA-Messung.





- Reinigen Sie die Gesichtshaut.
- Tragen Sie ausreichend eventuell angewärmte Aloe-Restorate-Mischung (2TL :1TL) auf das Gesicht auf.
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer!).
- Mit Klick auf run aktivieren Sie das i-LIGHT.

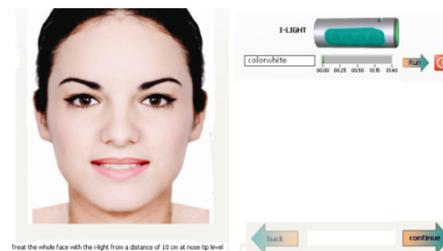

I-ON

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das rote Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Verbinden Sie die beiden schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf. Die praktische Erfahrung hat einen deutlich verstärkten Lifting-Effekt während und nach der galvanischen i-ON –Behandlung gezeigt, wenn beide Stabelektroden dieselbe (negative) Polarität haben. Auf diese Weise wird der Ionenaustausch nicht auf das lokal behandelte Gebiet beschränkt, sondern ausgedehnt bis zur (positiven) Null-Elektrode, die am Handgelenk befestigt ist.
- Arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy Basetron und Cicatron mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf Stopp.
- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden flachen Stabelektroden des i-ON .
- Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe -Mischung aufgetragen ist.
- Klicken Sie auf den run-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.

Passend zu dem laut vorangegangener EDA-Messung schwächsten Meridian werden drei Gesichtszonen nacheinander mit den beiden Stabelektroden behandelt.

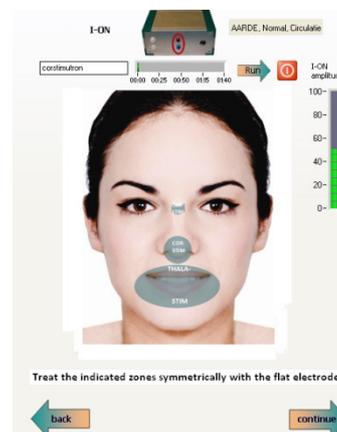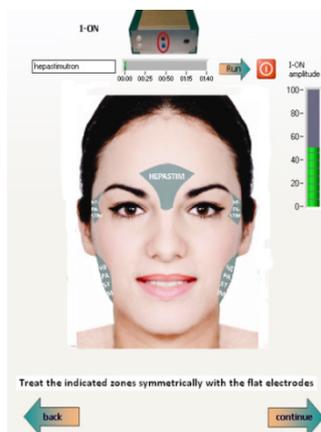





Behandlung mit dem i-VAC in 2 Schritten: Lymphdrainage und Bindegewebemassage. **Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung eher einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.**

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt:

- Lymphdrainage

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Bild)
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (siehe Bild)
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang).
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext. Yin Tang) bis zum Haaransatz.
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Tai Yang 3-4x pumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen

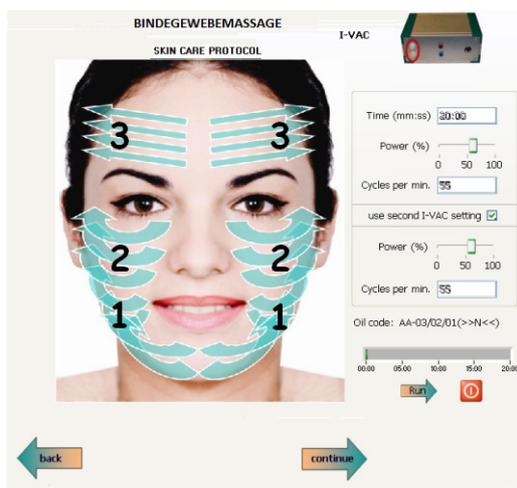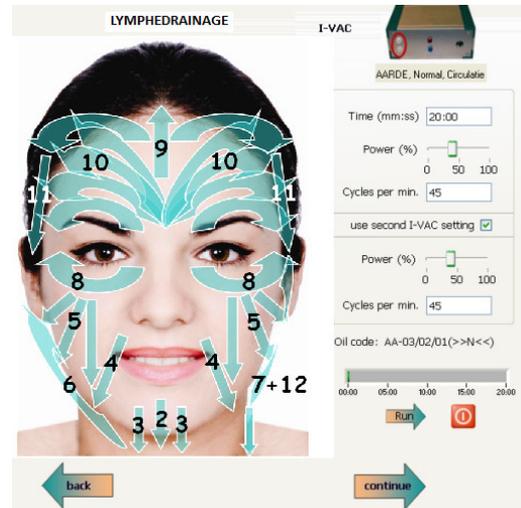


- **Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Zyklen)**
- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen
- **Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Zyklen)**
- Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen
- Entfernen Sie sorgfältig das restliche Öl mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).



Das Gesicht wird mit ähnlich meridianregulierenden Raymedys wie in Schritt 2a behandelt, nun aber mit Farblight, mit einem kräftigen hautvitalisierendem Raymedy als Abschluss.

- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer!).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**.

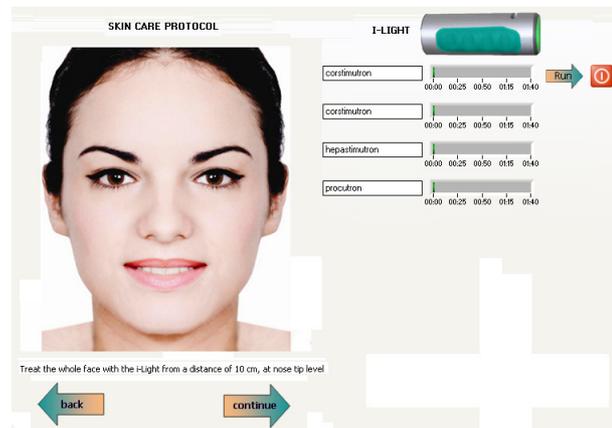


Mit einer weiteren **EDA-MESSUNG** wird das Raymedy für die Konsolidierung bestimmt.



KONSOLIDIERUNG


- Klient in Rückenlage
- Verbinden Sie den roten Beamer mit dem **i-Matrix-Gerät**.
- Halten Sie den Beamer auf den angezeigten Bereich.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den **run**-Pfeildä neben.
- Mit Klick auf **continue** wird Ihnen mitgeteilt, dass das Programm zu Ende ist.

Procoll is finished.

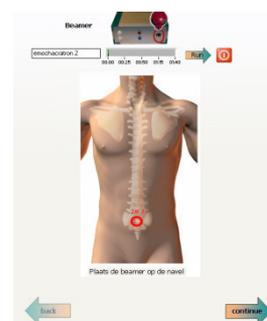



- Nehmen Sie **drei EDA-Messungen** vor, um den Elementtyp, das Energielevel und die Energieverteilung des Klienten zu bestimmen.
- Klicken Sie auf *Rejuvenation*.
- Im Fenster *select* wählen Sie die 1.



VERJÜNGUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


VORBEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

- Klient in Bauchlage.
- Tragen Sie die Aloe+Restore-Mischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2TL Aloe :1TL Restore)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer!)
- Mit Klick auf *run* aktivieren Sie das **i-LIGHT**




NACKENBEHANDLUNG MIT I-ON

- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad!) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy *Basetron* mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein.
- Drücken Sie auf *Stopp*.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy *C1* auf den Wirbel C1 plus das Dermatom).
- Klicken Sie auf den *run*, um die Raymedys zu aktivieren
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Mit Klick auf *continue* kommen Sie weiter.

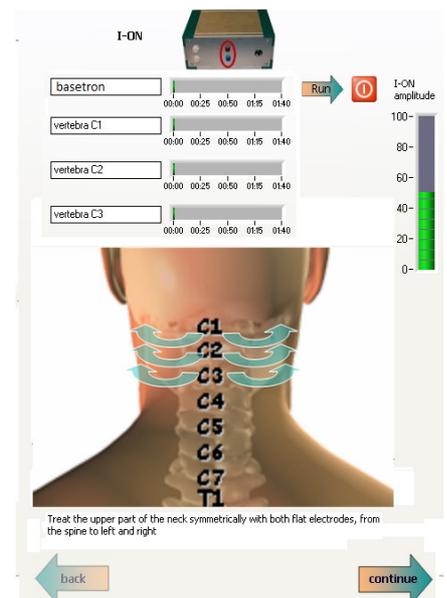




HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

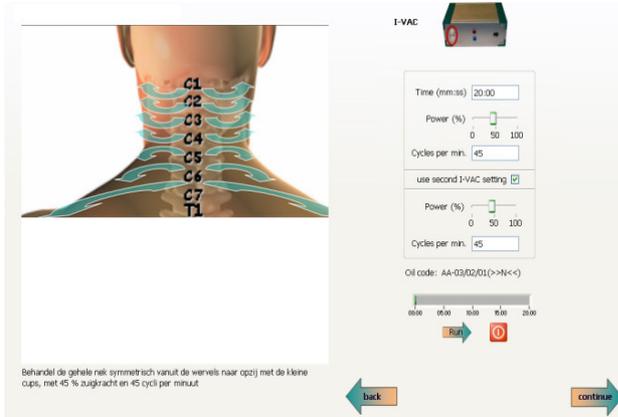

- Bereiten Sie 2 TL Mandelöl : 8 Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erde-normal-AA-02).
- Klient in Bauchlage.
- Tragen Sie die angesagte Ölkombination angewärmt auf die Behandlungszone auf.
- Mit Klick auf `run` aktivieren Sie das i-VAC.
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild).
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Es reflektiert!).
- Klicken Sie auf `continue` um weiterzukommen.

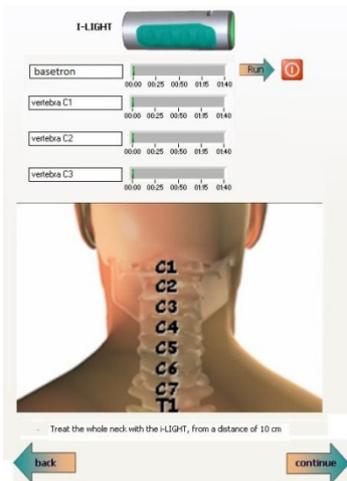


HALSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

- Klient in Bauchlage.
- Mit Klick auf `run` aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer!)

GESICHTSVERJÜNGUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

VORBEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS


- Klient in Rückenlage
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser.
- Tragen Sie die Aloe+Restoratemischung auf das Gesicht auf (2TL Aloe : 1TL Restorate).
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht.
- Mit Klick auf `run` aktivieren Sie das **i-LIGHT**.

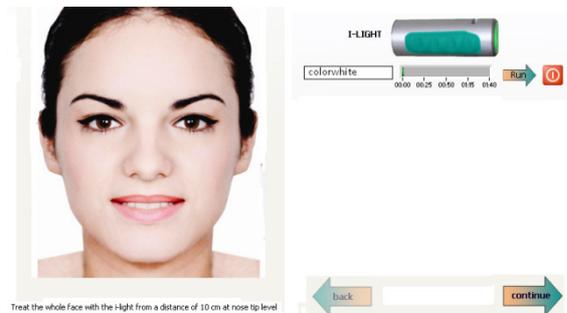



I-ON GESICHTSBEHANDLUNG

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad!) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys *Basetron* und *Cicatron* mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein.
- Drücken Sie auf **Stopp**.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h-Serum (2TL :7Tr:6Hübe) auf das Gesicht auf.
- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.

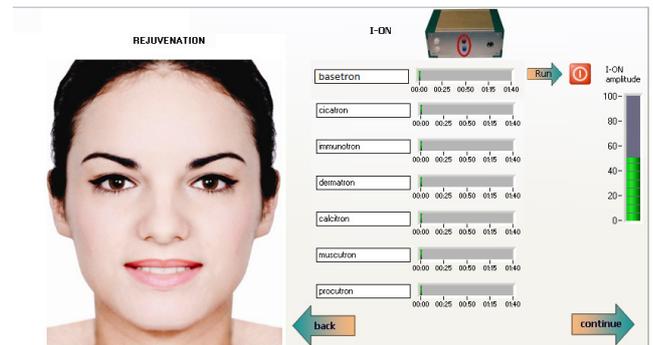


I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE.

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.


Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an!

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt:
- **Lymphdrainage**
 1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
 3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
 4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (siehe Bild)
 5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (siehe Bild)
 6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
 7. Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
 8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
 9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
 10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4x pumpen
 11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
 12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen

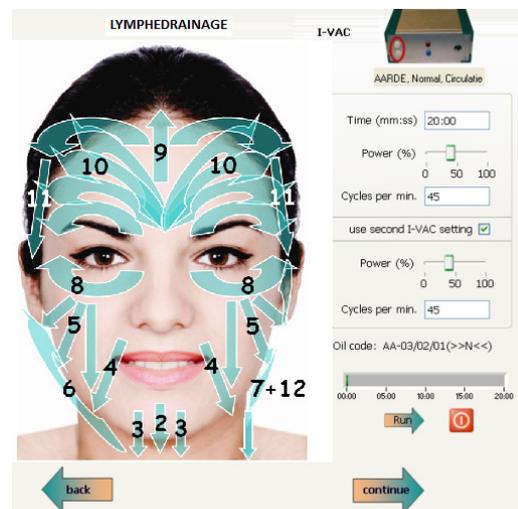




- **Bindegewebsmassage Stufe 1 (55 Cycle)**
 - von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild).
 - ebenso an den Wangen
 - Von der Mitte der Stirn aus nach außen
- **Bindegewebsmassage Stufe 2 (550 Cycle)**
 - Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
 - von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
 - ebenso an den Wangen
 - von der Mitte der Stirn aus nach außen

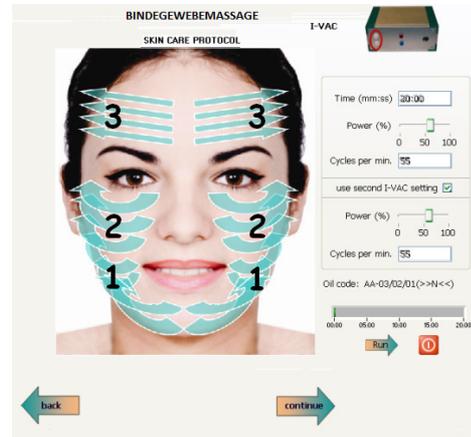

I-LIGHT GESICHT

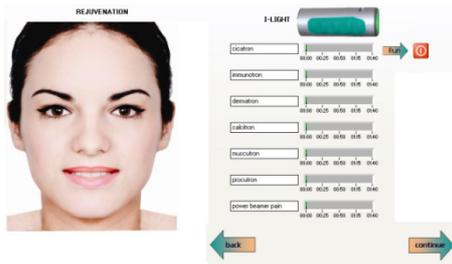


- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer!).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.

EDA-MESSUNG!



KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy *Emochakraton 5* gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

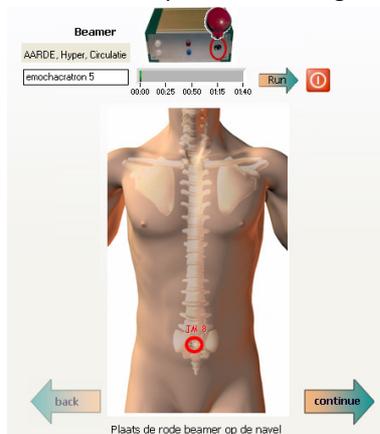


- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf **run**.
- Nach Klick auf **continue** ist das Programm beendet.

Protocoll is finished.



BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC


- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf `run`.
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian, auf Höhe von Halswirbel 7 und Steißbein) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf `continue` rechts unten fahren Sie im Programm fort.

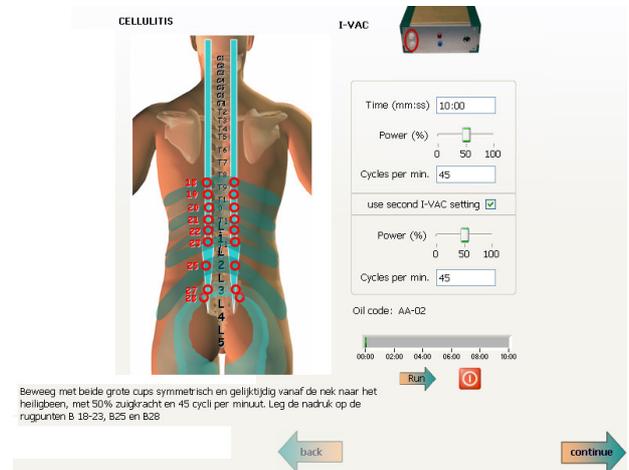

BEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen des **linken** Beines.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Rückseite der Beine auf.
- Klick auf den `run`-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf `continue` um weiterzukommen.

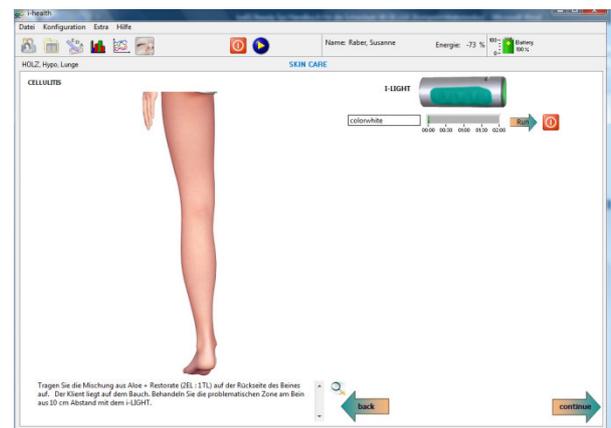


- Klient in Bauchlage
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen des **rechten** Beines.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Rückseite der Beine auf.
- Klicken Sie auf `run`, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf `continue` um weiterzukommen.






BEHANDLUNG MIT I-ON LINKS

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie (Wärmebildung).

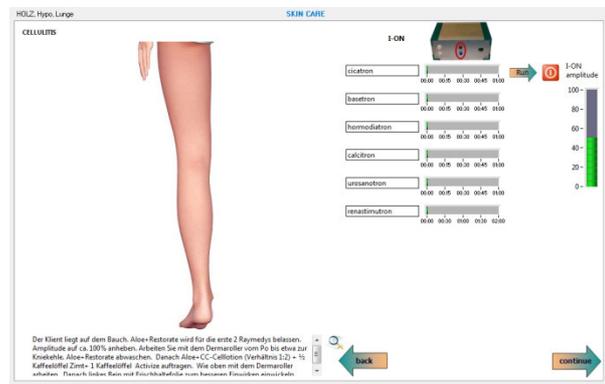

BEHANDLUNG MIT I-ON RECHTS

- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie.

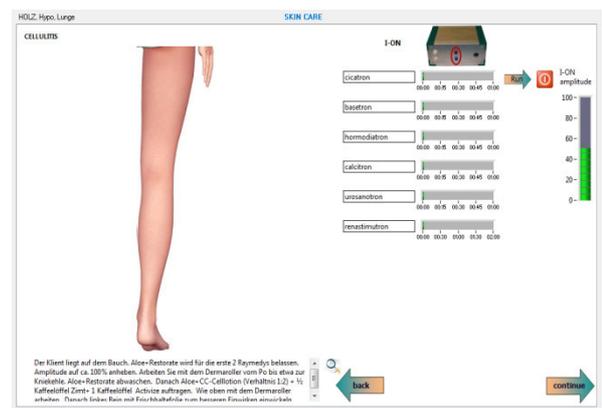




LYMPHDRAINAGE MIT I-VAC LINKS

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen,
 - zwischen Großzehe und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen
- Wechseln Sie auf das große Schröpfglas.
 - auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8): 7-8x pumpen
 - bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild).
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.



I-VAC BINDEGEWEBEMASSAGE

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die **Rückseite** des Beines zügig ab.

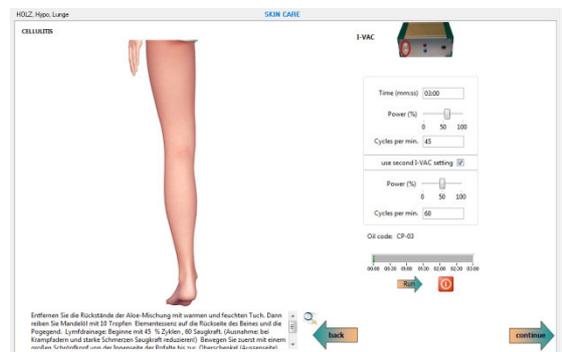

I-VAC MATRIXDRAINAGE




- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Rückseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Ölrreste mit einem feuchtwarmen Tuch sorgfältig entfernen (reflektiert!).



I-VAC LYMPHDRAINAGE RECHTS

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen,
 - zwischen dem Großzeh und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen
- Wechseln Sie auf das große Schröpfglas:
 - auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen
 - bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten). um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian).
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild).
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.

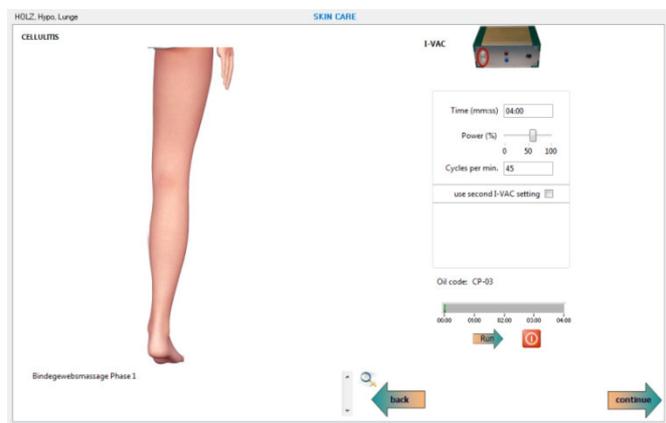

I-VAC BINDEGEWEBEMASSAGE

Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Rückseite des Beines zügig ab.

I-VAC MATRIXDRAINAGE


- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Rückseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Ölreste mit einem feuchtwarmen Tuch sorgfältig entfernen (Öl reflektiert!).





I-LIGHT BEHANDLUNG

- Behandeln Sie die Problemzonen des **rechten** Beines mit etwa 10cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf **run**.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

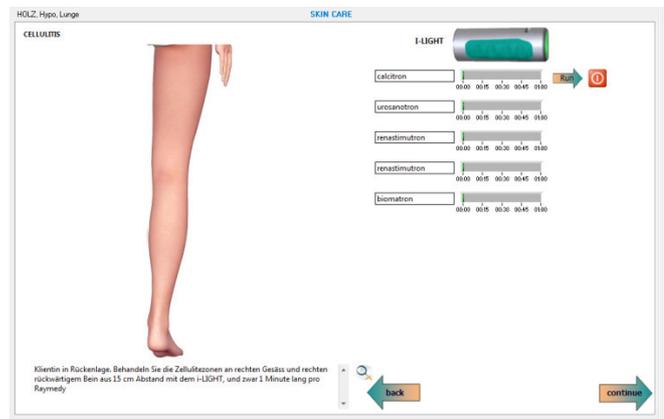

- Behandeln Sie die Problemzonen des **linken** Beines mit etwa 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf **run**.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.



Bitte die I-EDA-Messung vor der i-LIGHT-Behandlung durchführen.


1366	Lo 11	2269
1369	Ds 1	2420
1625	C 9	2465
2291	HC 1	2467
2327	H 8	2420
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2278
2411	Lo 1	2364
2420	M 45	2423
2424	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2501

Abschließend nehmen Sie eine **EDA-MESSUNG** vor.



BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

- Tragen Sie die angewärmte Ölmischung auf den Bauchbereich auf.
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf `run`.
- Bei **HYPO- und NORMALE Energie**: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins.
- Bei **HYPER-Energie**: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein.
- Folgen Sie mit den Schröpfköpfen der im Bild angegeben Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Es reflektiert!).
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf `continue` um weiterzukommen.

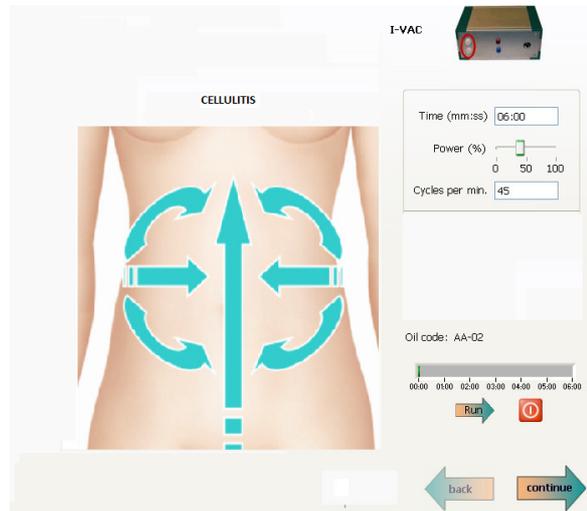

EDA-MESSUNG

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches **Energie aus dem Feuerelement zuführt**.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den `run`-Pfeil.
- Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf `continue` das Celluliteprogramm geschlossen.

Protocoll is finished.



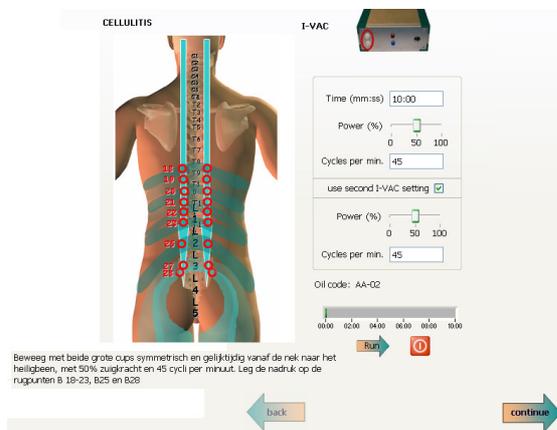

BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/auf Höhe Halswirbel 7 und Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf **continue** fahren Sie im Programm fort.

VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Seitenlage **rechts**
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf.
- Klicken Sie auf **run**, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.



BEINBEHANDLUNG MIT DEM I-ON

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung).





VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Seitenlage **links**.
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf.
- Klick auf den **run**-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.




BEINBEHANDLUNG MIT DEM I-ON



- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**. Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie (Wärmebildung).



I-VAC LYMPHDRAINAGE RECHTS

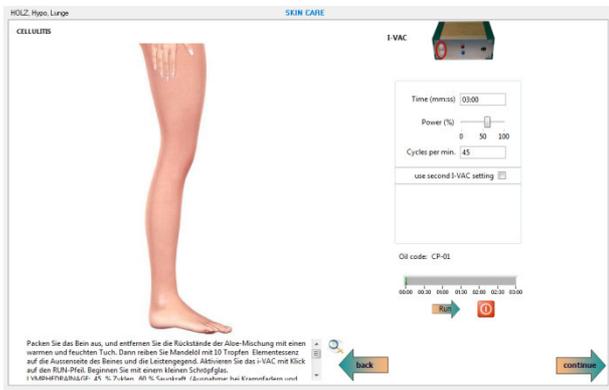

- Entfernen Sie nun sorgfältig die Aloe Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
 - zwischen dem Großzeh und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3): 7-8x pumpen
- Wechseln Sie auf das große Schröpfglas:
- Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen

- Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines ab.
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.

I-VAC BINDEGEWEBEMASSAGE

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines zügig ab.



I-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Außenseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (Öl reflektiert!).





I-VAC LYMPHDRAINAGE LINKS

- Entfernen Sie sorgfältig die Aloe-Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den run-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
 - zwischen Großzehe und 2. Zehe (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen



- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas,
 - auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen.
 - Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian).
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines ab.
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.



I-VAC BINDEGEWEBEMASSAGE

- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Außenseite des Beines zügig ab.

I-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Außenseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (Öl reflektiert!).



BEINBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Seitenlage **links**.
- Behandeln Sie die Problemzonen aus etwa 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.


- Klient in Seitenlage **rechts**
- Behandeln Sie die Problemzonen aus etwa 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf **run**.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.
- **ABSCHLIEßEND EDA-MESSUNG!**





BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

- Tragen Sie die angewärmte Ölmischung auf den Bauch auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den `run`-Pfeil.
- Bei **HYPO- und NORMALE Energie**: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins.
- Bei **HYPER-Energie**: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein.
- Folgen Sie unbedingt mit den Schröpfköpfen dem Konzeptionsgefäß in der angegeben Pfeilrichtung.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den `continue` um weiterzukommen.

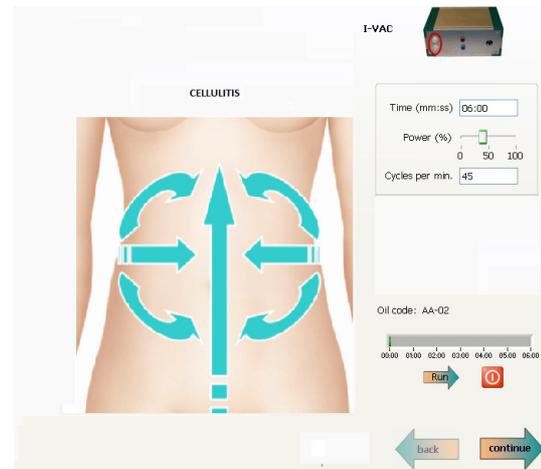

- Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue **EDA-MESSUNG** notwendig.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Phase de l'EDA mesurée pour l'échelle de l'énergie.


1366	Lo 11	2289
1369	Di 1	2429
1625	C 9	2405
2281	Re 1	2405
2327	H 9	2400
2363	Du 1	2383
2364	MP 1	2378
2411	La 1	2384
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2423	N 1	2458
2424	B 67	2381

KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy *Emochakraton 4*, welches Energie aus dem Feuelement zuführt.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den `run`-Pfeil.
- Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf `continue` das Celluliteprogramm geschlossen.

Protocoll is finished.

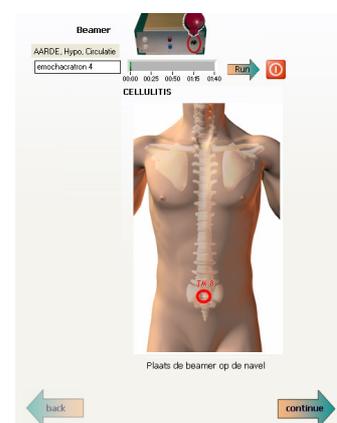



BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.

- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Bewegen Sie die beiden großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/auf Höhe Halswirbel 7 und Steißbein) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf **continue** rechts unten fahren Sie im Programm fort.



VORBEHANDLUNG MIT I-LIGHT



- Klient in Rückenlage
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Vorderseite des **linken** Beines auf.
- Klicken Sie auf **run**, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

- Klient in Rückenlage
- 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Vorderseite des **rechten** Beines auf.
- Klicken Sie auf den **run**, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!)
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.






BEHANDLUNG MIT I-ON

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die Problemzone des **linken Beines** mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie ein (Wärmebildung).
- **DIESELBE BEHANDLUNG MIT I-ON RECHTES BEIN**

I-VAC LYMPHDRAINAGE LINKS

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende Ölkombination angewärmt auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
 - zwischen dem Großzeh und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen.
- Wechseln Sie auf das große Schröpfglas
 - auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen
 - bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild).
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.

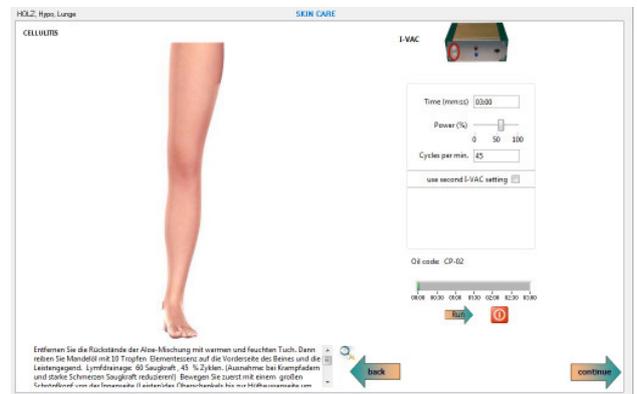



legs front side(MP/M)




I-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (Öl reflektiert!).

I-VAC LYMPHDRAINAGE RECHTS

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende Ölkombination angewärmt auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf run.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas:
 - in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
 - zwischen Großzehe und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
 - auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen
 - Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab (siehe Bild).-
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.

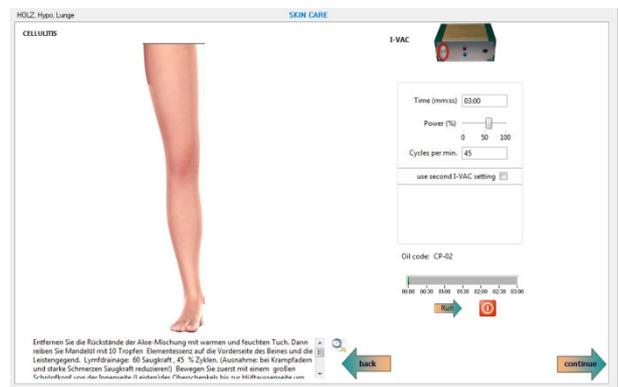


I-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an (mindestens 25%).
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Vorderseite des Beines ab. Hier ist das Zeitfenster auf 6 Minuten voreingestellt, da Sie mit dieser Frequenz 550 die besten Effekte erzielen.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (reflektiert!).




VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2TL:1TL) auf die Problemzonen.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bereich zwischen 6. Halswirbel und Schulterblätter (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den **continue**-Pfeil um weiterzukommen.

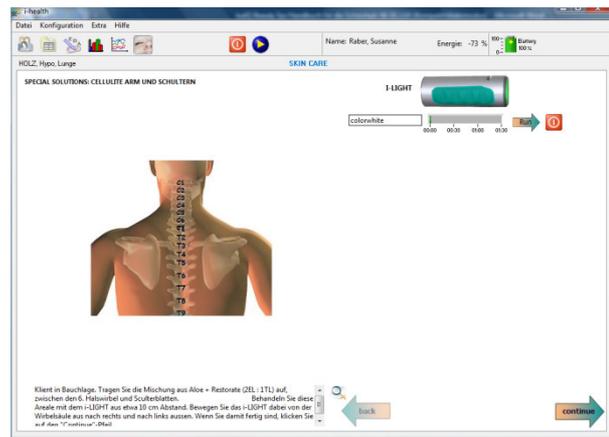


BEHANDLUNG MIT I-ON RÜCKEN

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedy *Basetron* und *Cicatron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.

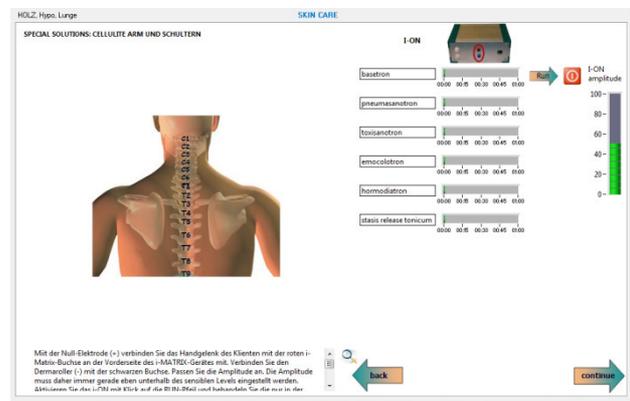

I-VAC LYMPHDRAINAGE

- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf
- Bewegen Sie die beiden großen Schröpfköpfe in angegebener Richtung auf dem Blasenmeridian
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Arbeiten Sie danach von außen nach innen die Problemzonen ab

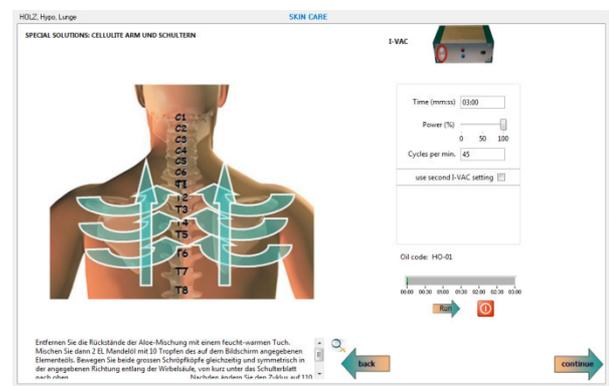




Legs side (G/Le)


I-VAC MATRIXDRAINAGE i

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an.
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von außen nach innen die Problemzonen ab.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (reflektiert!).

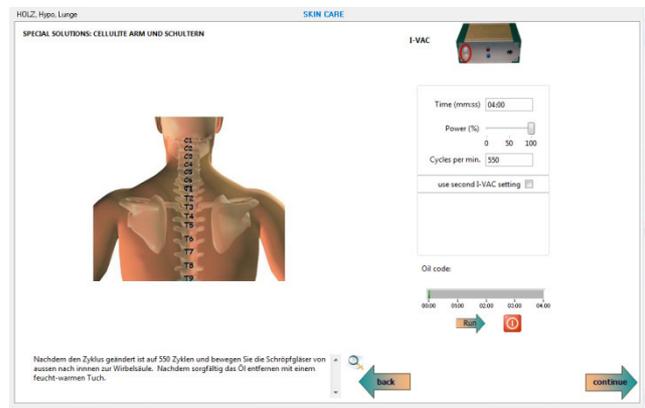

I-LIGHT

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den run-Pfeil.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

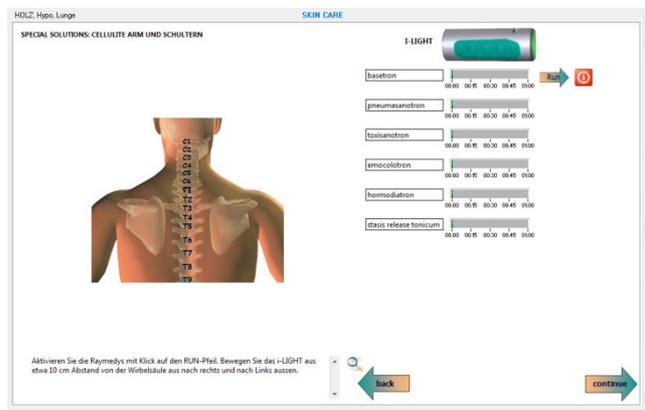

VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT ARM


- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2TL:1TL) auf die Problemzonen.
- Klick auf run, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.





BEHANDLUNG MIT I-ON ARM

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feucht warmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+Zimt+ Activize Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.

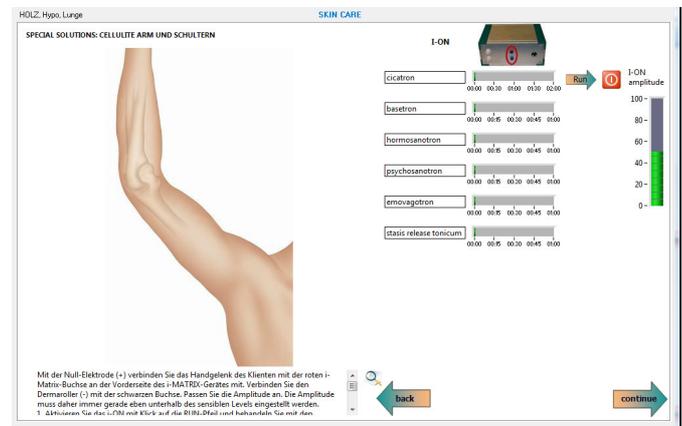


VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT ARM

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung (2TL:1TL) auf die Problemzonen .
- Klicken Sie auf den **run**-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer!).
- Klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.



BEHANDLUNG MIT I-ON ARM

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette am Arm des Klienten(feuchtes Wattepad!).
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf **run**.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Um eine bessere Tiefenwirkung zu erreichen, wickeln Sie den Arm in Folie ein.

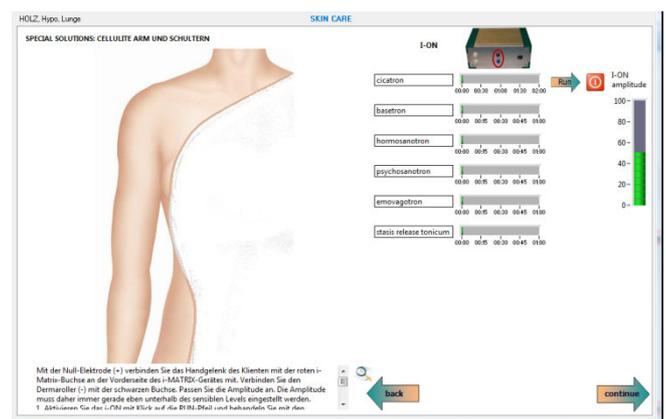

!!WIEDERHOLEN SIE DIE BEHANDLUNGSSCHRITTE AM ZWEITEN ARM !!




I-VAC LYMPHDRAINAGE

- Entfernen Sie nun sorgfältig die Aloe-Mischung.
- Tragen Sie die angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Mit dem großen Schröpfglas 7-8x in der Achselhöhle pumpen.
- Mit dem kleinsten Schröpfglas in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen.
- Wechseln Sie nun auf das mittlere Glas. Arbeiten Sie nun von unten nach oben zum Rumpf hin.
- Abschließend mit dem großen Schröpfglas 7-8x in der Achselhöhle pumpen.



i-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an.
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen ab.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (Öl reflektiert).

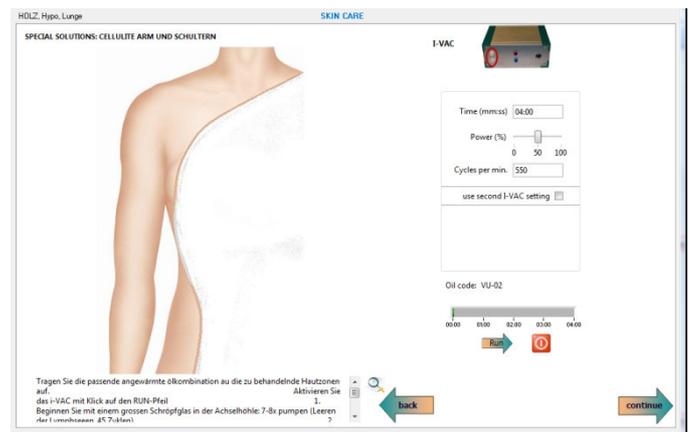


!! WIEDERHOLEN SIE DIE BEHANDLUNGSSCHRITTE AM ZWEITEN ARM !!




I-LIGHT

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf **run**.
- Klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

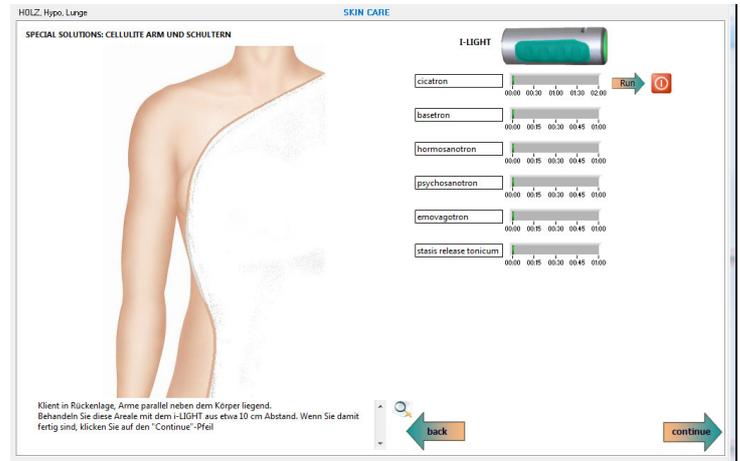

BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC LYMPHDRAINAGE

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Bei **HYPO- und NORMALE** Energie: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite (Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linke und rechte Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt vom Schambein zum Unterrand des Brustbeins.
- Bei **HYPER-Energie**: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein
- Folgen Sie mit den Schröpfköpfen unbedingt dem Konzeptionsgefäß in der angezeigten Pfeilrichtung.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

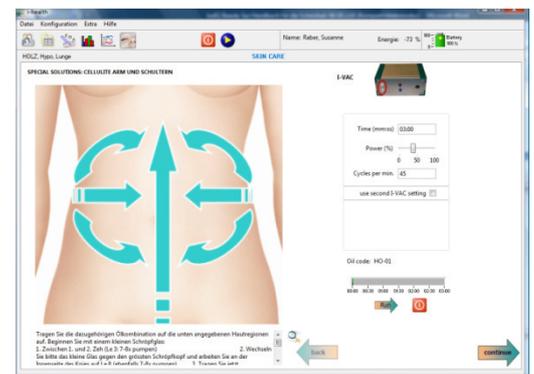

KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochakraton 4, welches Energie aus dem Feuelement zuführt

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf **run**.
- Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf **continue** das Celluliteprogramm geschlossen:

Procoll is finished.



ANTI-FALTEN




- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restorat-Mischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2TL Aloe :1TL Restorate)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer!)
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**.



NACKENBEHANDLUNG MIT I-ON

- Klient in Bauchlage.
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein.
- Drücken Sie auf **Stopp**.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy **C1** auf den Wirbel **C1** plus das Dermatom).
- Klicken Sie auf **run**, um die Raymedys zu aktivieren.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Mit Klick auf den **Continue**-Pfeil kommen Sie weiter.

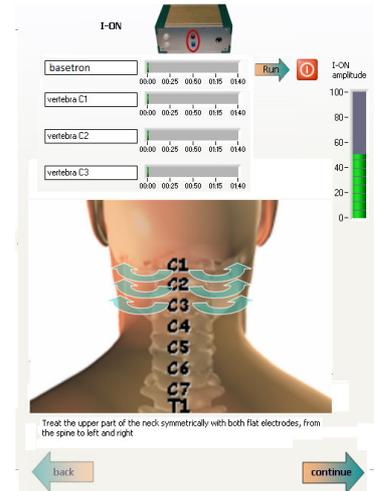


HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC




- Bereiten Sie 2TL Mandelöl : 8 Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erde-normal-AA-02).
- Klient in Bauchlage.
- Tragen Sie die angesagte Ölkombination angewärmt auf die Behandlungszone auf.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-VAC.
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Es reflektiert!).
- Klicken Sie auf **Continue** um weiterzukommen.

HALSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer!).






Im üblichen zeitlichen Rahmen eines Praxisbesuches ist es nicht möglich, mehr als 2 Faltenpartien in einer Sitzung zu behandeln. Besprechen Sie also, welche Falten die Problemfälle darstellen, setzen Sie Prioritäten und folgen Sie den Behandlungsanweisungen auf den Screens, für die Sie sich eben entschieden haben. Die anderen überspringen Sie.

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Mischung aus Aloe + Restorate (2TL:1TL), eine andere aus Aloe + Q10 + Beauty Line 12h Aktiv-Serum (2 TL:8 Tropfen:8 Hübe)


VORBEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEIß

- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser.
- Tragen Sie die Aloe+Restorate-Mischung auf den zu behandelnden Bereich auf.
- Richten Sie das i-LIGHT aus 10 cm Abstand auf diesen Bereich (Ständer!).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**.

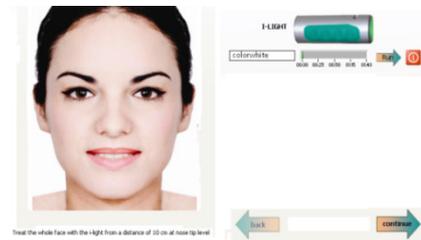

I-ON SCHRITT A

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad!) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedy *Basetron* und *Cicatron* mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein.
- Drücken Sie auf **Stopp**.

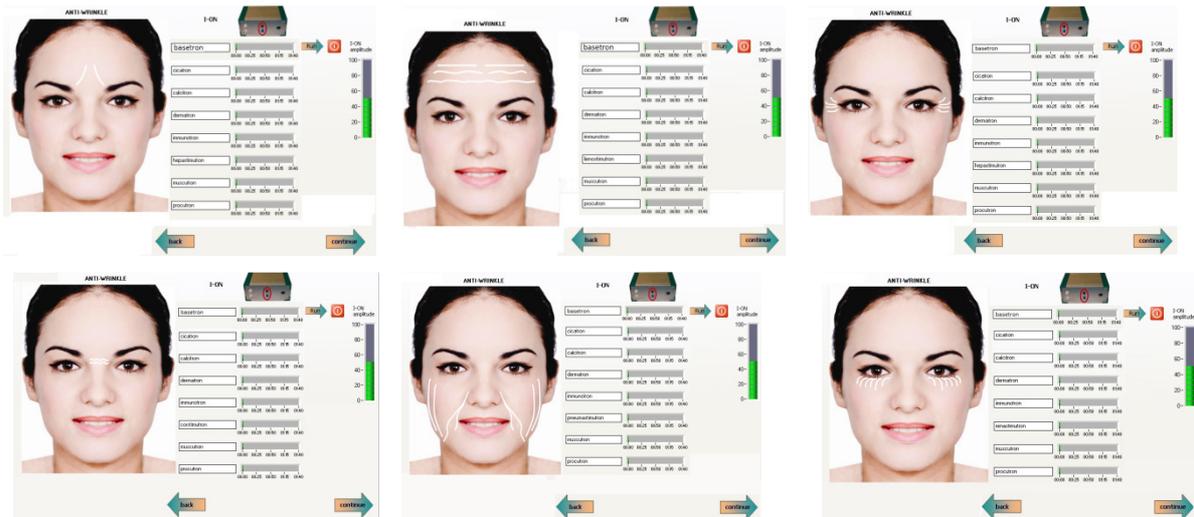

I-ON SCHRITT B

- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Beauty Line 12h-Serum auf das ganze Gesicht auf, besonders auf die zu behandelnde Faltenpartie. Sie können zusätzlich Beauty Line 12h Aktiv-Serum direkt auf die Falten auftragen.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den kugligen Köpfen auf.
- Behandeln Sie nun die angegebenen Zonen im Gesicht mit den beiden Stabelektroden des **i-ON**. Achten Sie darauf, dass immer genug Aloe-Mischung vorhanden ist. Bewegen Sie von der Mitte nach beiden Enden der Falten und zurück.
- Klicken Sie auf den **run**-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren.
- Das letzte Raymedy tragen Sie wieder auf das ganze Gesicht mit dem Dermaroller auf.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.





LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE MIT DEM I-VAC

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.

- Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an! Vorsicht bei Couperose!!
- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt (Lymphdrainage):

1. In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen;
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläsern von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns (Bild)
4. von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns (siehe Bild)
5. von den Wangen bis unter die Kante des Kinns (siehe Bild)
6. von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohr läppchen (Akupunkt 3E17)
7. von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11): 7-8x pumpen
8. vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
10. von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang 3-4x pumpen
11. von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohr läppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen

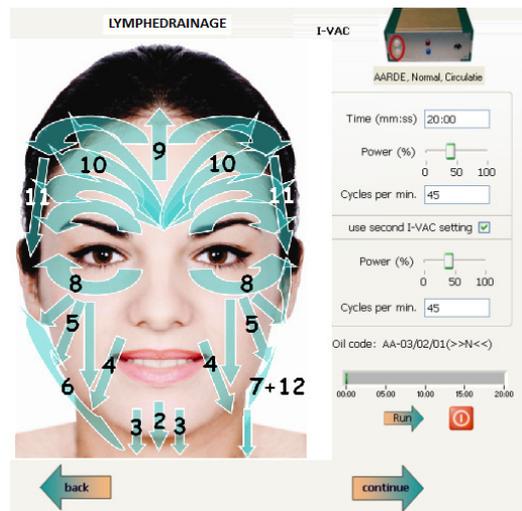




Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)

- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen


Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)

Ändern Sie den Cycle auf 550 und benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen

- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen

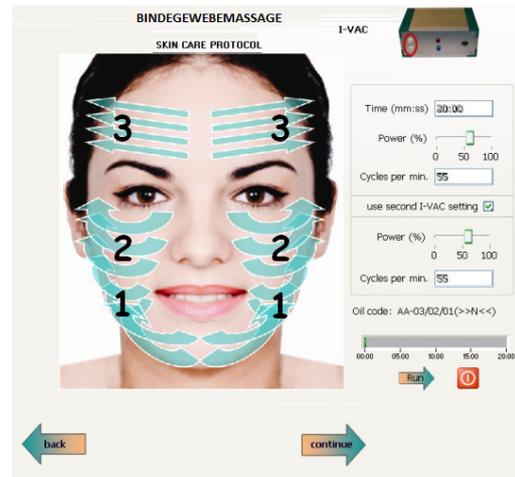

- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf Höhe der Nasenspitze auf das Gesicht (Ständer!).
- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den run-Pfeil.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

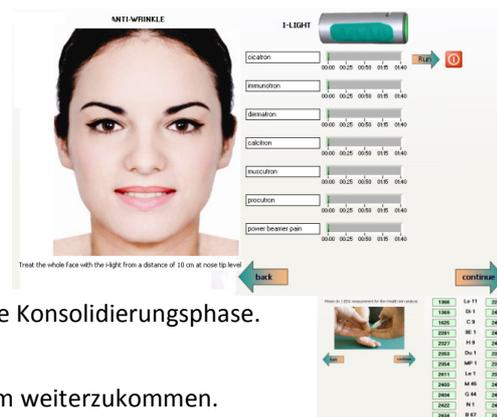

- Eine weitere EDA-Messung ist notwendig für die folgende Konsolidierungsphase.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER


Klient in Rückenlage

Passend zur aktuellen energetischen Balance im Erdelement wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 2: Es stabilisiert die persönliche Elementenergie.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf run.
- Mit Klick auf continue ist das Anti-Faltenprogramm beendet und wird geschlossen:




Protocoll is finished.



AKNE


VORBEREITUNG DER I-ON-BEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung (2TL:1TL) auf die zu behandelnden Zonen auf.
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer!)
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.

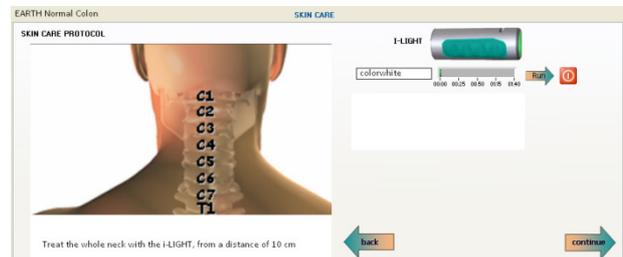


AKNEBEHANDLUNG DES NACKENS MIT I-ON:

- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy Basetron mit dem Dermalroller im ganzen Halsbereich ein.
- Drücken Sie auf **Stopp**.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Halswirbeln. (Raymedy C1 auf den Wirbel C1 plus das Dermatome).
- Klicken Sie auf den **run**-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Mit Klick auf **Continue** kommen Sie weiter.

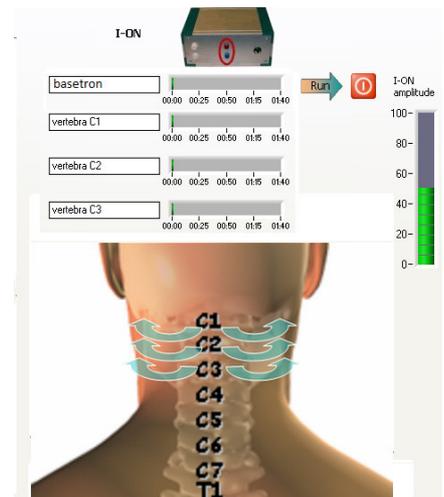

NACKENBEHANDLUNG MIT I-VAC


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte Ölkombination (2TL:8Tr) angewärmt auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-VAC**.
- Wenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild).
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).
- Klicken Sie auf **Continue** um weiterzukommen.

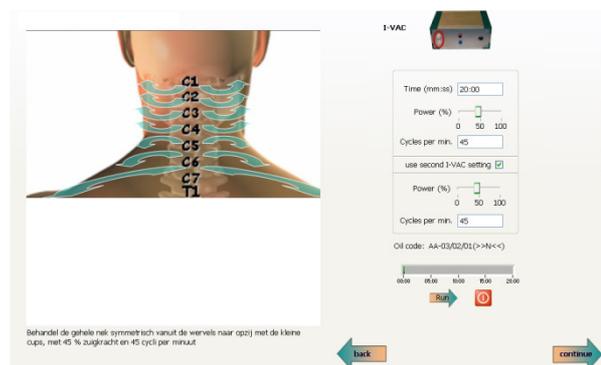




NACKENBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den **continue**-Pfeil

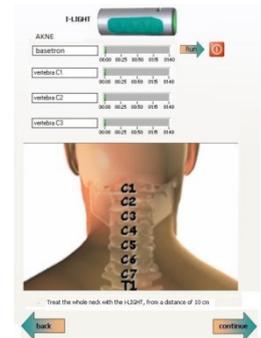


BEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

- Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Klient in Rückenlage, mit geschlossenen Augen
- Reinigen Sie das Gesicht mit Rosenwasser.
- Tragen Sie der Aloe + Restoratemischung (2TL:1TL) auf Gesicht und Hals auf.
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer!)
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**.

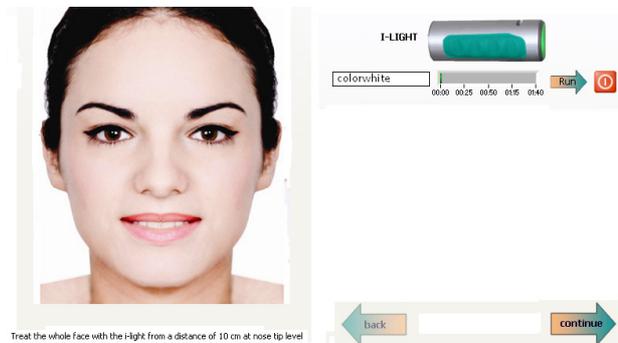

I-ON AKNE GESICHT

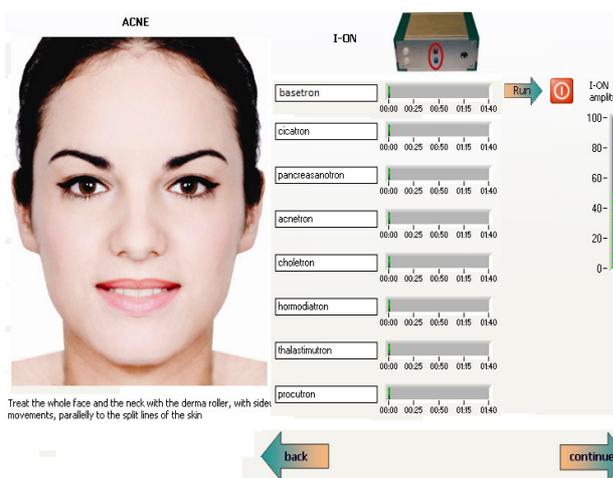


- Passen Sie die Amplitude an.
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad!) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys *Basetron* und *Cicatron* mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein. Drücken Sie auf **Stopp**.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10 (2TL:8Tr) auf
- Behandeln Sie weiter das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.



I-VAC AKNE GESICHT


- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-VAC**.
Dann schröpfen Sie mit dem kleinsten runden Gläschen wie folgt (**Lymphdrainage**):

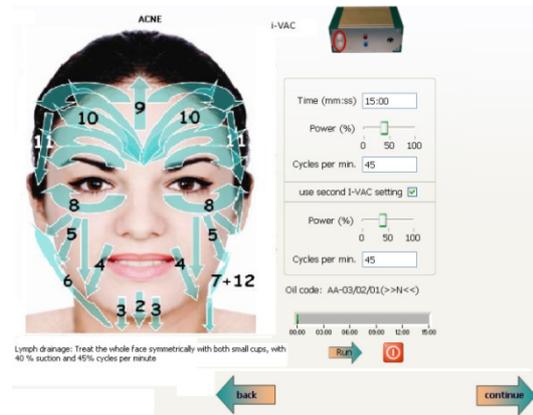

1. in der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
2. Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
3. Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
4. Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns
5. Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns
6. Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
7. Von dort zur Grube der Clavikular (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen.
8. Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
9. Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
10. Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang: 3-4x pumpen
11. Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
12. Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
13. Entfernen Sie sorgfältig das verblieben Öl mit einem feuchtwarmen Tuch.

I-LIGHT GESICHT

- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Richten Sie das **i-LIGHT** auf Höhe der Nasenspitze aus ca. 10 cm Distanz auf das Gesicht (Ständer!).
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

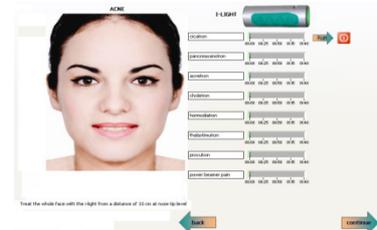

NEUE EDA-MESSUNG

- Es ist eine weitere EDA-Messung notwendig, um die Konsolidierungsphase abzuschließen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.



KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Klient in Rückenlage.

Passend zum aktuellen Energiemangel im Erde-Element wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy *Emochakraton 4*, um Energie aus dem Feuerelement zuzuführen.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Mit Klick auf **continue** wird das Programm geschlossen:








BEHANDLING DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian/ auf Höhe des 7. Halswirbels und des Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf **continue** rechts unten fahren Sie im Programm fort.

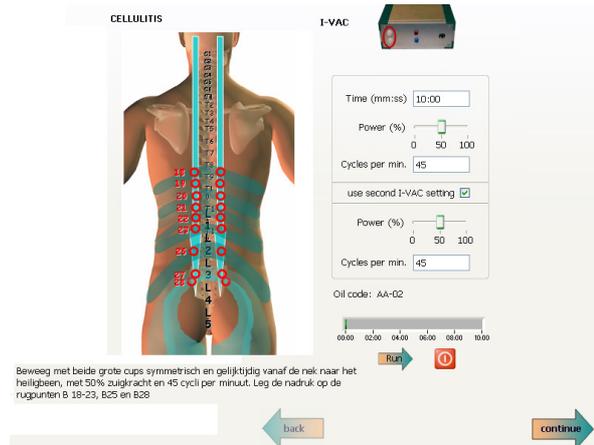

VORBEHANDLUNG MIT DEM I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- je 10 Min. Infrarot-Bestrahlung (China-Lampe) der Problemzonen.
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen des ersten Beines auf.
- Klicken Sie auf **run**, um das i-LIGHT zu aktivieren.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf das Bein (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.



WIEDERHOLEN SIE DIE ANWEISUNGEN AM ANDEREN BEIN.

BEHANDLUNG MIT I-ON LINKES UND RECHTES BEIN

Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.


- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys Cicatron und Basetron.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Zur Optimierung der Einwirkzeit packen Sie nun das Bein in Frischhaltefolie (Wärmebildung).
- **WIEDERHOLEN SIE DIE O.G. ANWEISUNGEN AM ZWEITEN BEIN.**






I-VAC LYMPHDRAINAGE LINKS

- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnde Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen run-Pfeil.
- Beginnen Sie mit einem kleinen Schröpfglas.
- In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
- Zwischen Großzehe und 2. Zeh (Akupunkt Leber 3) 7-8x pumpen
- Wechseln Sie bitte auf das große Schröpfglas:
- Auf der Innenseite des Knies (Akupunkt Leber 8) 7-8x pumpen
- Bewegen Sie das Schröpfglas von der Oberschenkelaußenseite bis zur Innenseite (Leisten), um die Lymphseen zu entleeren. (Verlauf von Lebermeridian)
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Arbeiten Sie nun von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab (siehe Bild).
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.

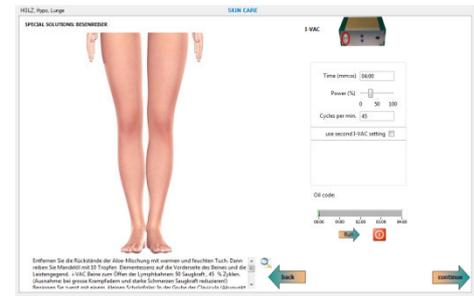

I-VAC MATRIXDRAINAGE

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an.
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen des Beines ab.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (Öl reflektiert!).

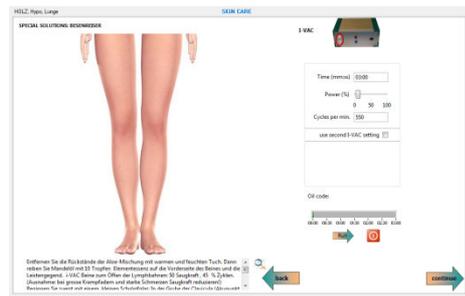

I-VAC LYMPHDRAINAGE RECHTS WIE OBEN




I-VAC MATRIXDRAINAGE RECHTS WIE OBEN





I-LIGHT BEHANDLUNG LINKES BEIN

- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10 cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!)
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf den run-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

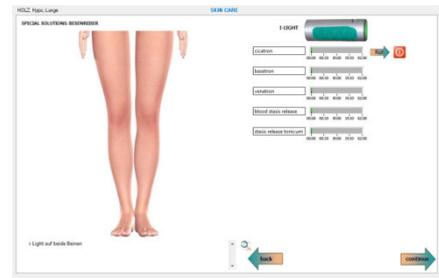


WIEDERHOLEN SIE DIE O.G. ANWEISUNGEN AM RECHTEN BEIN.



EDA-MESSUNG!

I-VAC BAUCHBEHANDLUNG

- Tragen Sie auf den Bauchbereich angewärmte Ölmischung auf.
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den run-Pfeil.
- Bei **HYPO- und NORMALE Energie**: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite(Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt von Schambein zum Unterrand des Brustbeins.
- Bei **HYPER-Energie**: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt von Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein.
- Folgen Sie unbedingt mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß.
- Entfernen Sie das ÖL sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (ÖL reflektiert!)
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

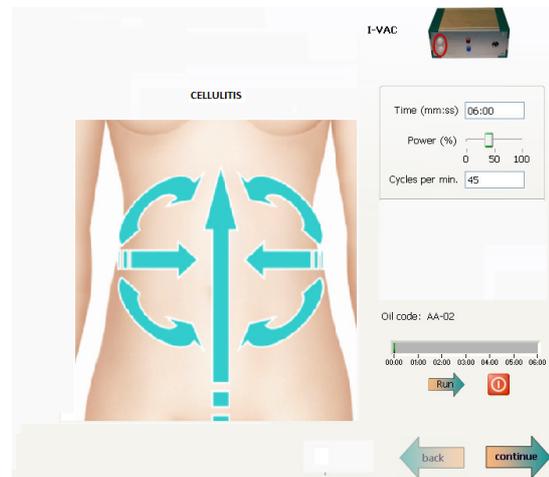

EDA-MESSUNG

Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig

- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches Energie aus dem Feuelement zuführt.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf run
- Mit Klick auf continue wird das Programm geschlossen.

Protocoll is finished.








Programm BL/NI Behandlung des Rückens mit dem i-VAC

- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken (im Bereich des Blasenmeridians) auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule (Blasenmeridian, in Höhe des 7. Halswirbels und des Steißbeins) und verweilen Sie 7-8 Saugimpulse auf den markierten Punkten.
- Mit Klick auf den **continue**-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.



Vorbehandlung mit dem i-LIGHT

- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen auf.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den **continue**-Pfeil um weiterzukommen.

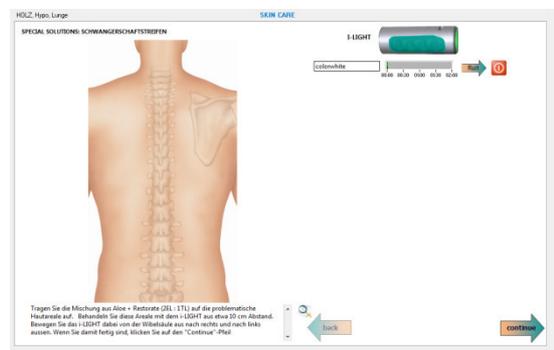

Behandlung mit i-ON Rücken

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basetron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.



i-VAC Lymphdrainage

- Tragen Sie die passende angewärmte Ölkombination auf die zu behandelnden Hautzonen auf.
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Arbeiten Sie nun von außen nach innen die Problemzonen ab.
- Achten Sie darauf, dass je nach Schmerzempfindlichkeit die Pumpintensität angepasst werden muss.






i VAC Matrixdrainage

- › Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an.
- › Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von außen nach innen die Problemzonen ab.
- › Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (reflektiert!).

i-LIGHT

- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

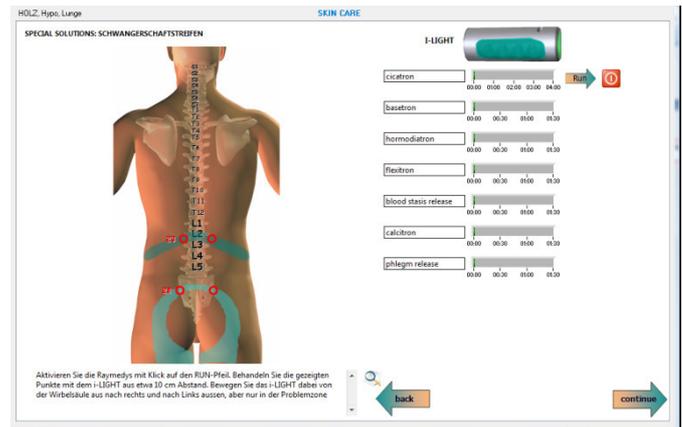

EDA-Messung!


Vorbereitung Bauch mit dem i-LIGHT

- Klientin in Rückenlage
- Tragen Sie die angewärmte Aloe+Restorate-Mischung auf die Problemzonen auf.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Bauch (Ständer!).
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.






Behandlung Bauch mit i-ON

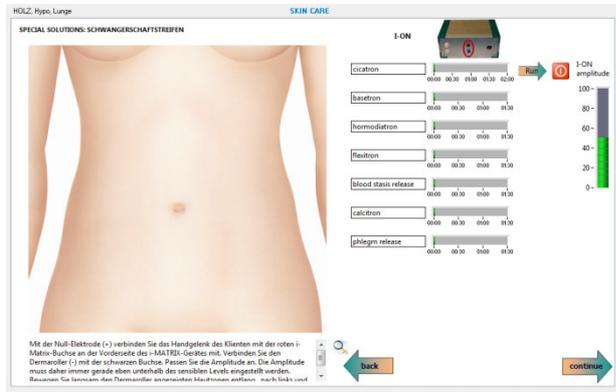

- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm der Klienti/9.
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den **run**-Pfeil.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den ersten beiden Raymedys *Cicatron* und *Basatron*.
- Klicken Sie auf **STOPP**.
- Entfernen Sie nun sorgfältig das Aloe-Restorate-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch und tragen Sie die angewärmte Aloe+CC Cell-Lotion+ Zimt+ Activize-Mischung auf.
- Behandeln Sie die Problemzone mit den restlichen Raymedys.
- Entfernen Sie sorgfältig das Aloe-Gemisch mit einem feuchtwarmen Tuch.

i-VAC Lymphdrainage


- Tragen Sie angewärmte Ölmischung auf den Bauchbereich auf.
- Danach nehmen Sie beide Schröpfköpfe in die Hand.
- Passen Sie eventuell die Pumpintensität an. Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf **run**.
- Bei **HYPO- und NORMALE Energie**: Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken und rechten Bauchseite (Taille) an und bewegen Sie diese wie angezeigt von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins, dann von der Taille zur Bauchmitte hin, dann von der Taille (linken und rechten Bauchseite) nach unten seitwärts bis zum Schambein. Zuletzt vom Schambein zum Unterrand des Brustbeins.
- Bei **HYPER-Energie**: Bewegen Sie beide Schröpfköpfe von der Taille bis zur Schambein, danach von der Taille bis zur Nabel, anschließend von der Taille nach oben bis zum Unterrand des Brustbeins. Zuletzt vom Unterrand des Brustbeins bis zum Schambein.
- Folgen Sie unbedingt mit den Schröpfköpfen der im Bild angegebenen Pfeilrichtung auf dem Konzeptionsgefäß.
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

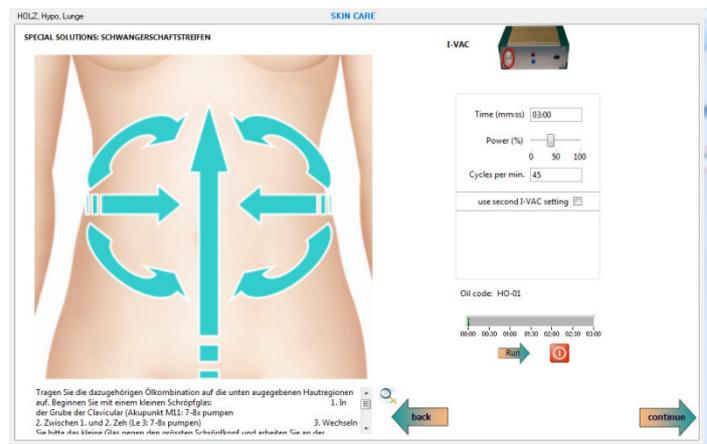




i-VAC Matrixdrainage

- Passen Sie die Pumpintensität dem Schmerzempfinden an.
- Arbeiten Sie nun mit nur einem Schröpfglas zügiger und oberflächlicher von unten nach oben die Problemzonen des Bauches ab.
- Danach Ölreste sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch entfernen (reflektiert!).

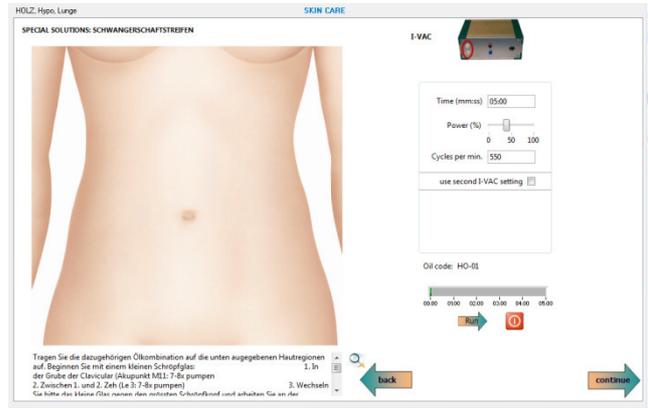


- Behandeln Sie die Problemzonen mit etwa 10cm Abstand mit dem i-LIGHT (Ständer!).
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klick auf run.
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf continue um weiterzukommen.

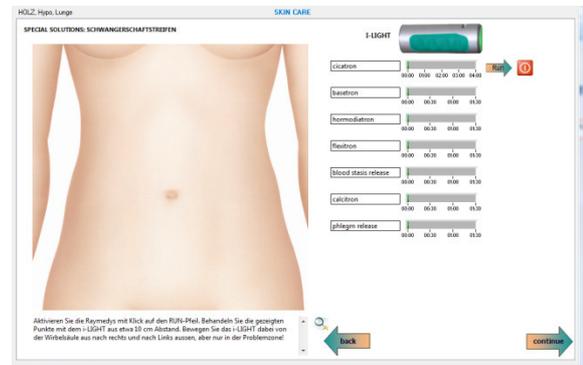

EDA-Messung!

Konsolidierung mit dem roten Beamer

- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochakraton 4, welches Energie aus dem Feuerelement zuführt.
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den run-Pfeil.
- Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf continue das Celluliteprogramm geschlossen:

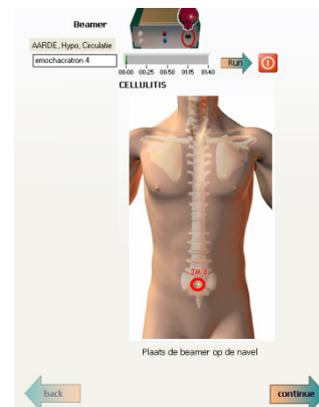

Procoll is finished.




VORBEREITUNG MIT I-LIGHT WEISS

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die Aloe+Restorate-Mischung auf die zu behandelnden Zonen auf (2TL Aloe :1TL Restorate)
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals (Ständer!).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das **i-LIGHT**




NACKENBEHANDLUNG MIT I-ON


- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an.
- Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad) am Arm des Klienten und arbeiten Sie das erste Raymedy *Basetron* mit dem Dermaroller im ganzen Halsbereich ein. Drücken Sie auf **Stopp**.
- Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem 2. schwarzen Kabel aus Ihrem Lieferumfang und stecken Sie die beiden Stabelektroden mit den flachen Köpfen auf.
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts wie angezeigt, passend zu den einzelnen Vertebrae. (Raymedy *C1* auf den Wirbel *C1* plus das Dermatome).
- Klicken Sie auf den **run**-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Mit Klick auf **continue** kommen Sie weiter.

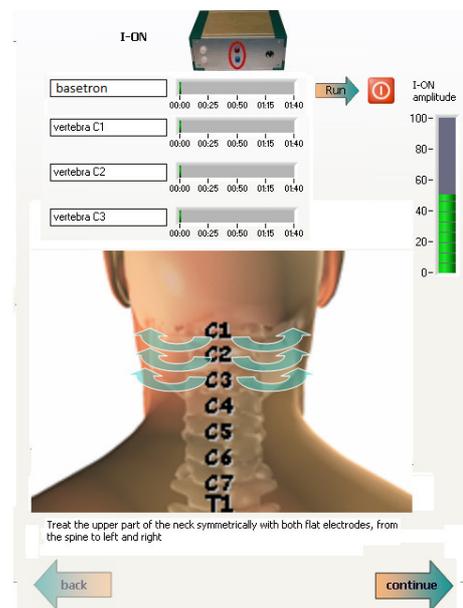

HALSBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

- Bereiten Sie 2 TL Mandelöl: 8 Tropfen der angegebenen Elementessenz vor (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte Ölkombination angewärmt auf die Behandlungszone auf.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-VAC.
- Verwenden Sie die mittleren Schröpfköpfe nach Anweisung an (siehe Bild).
- Entfernen Sie das Öl sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch (Öl reflektiert!).
- Klicken Sie auf **continue** um weiterzukommen.

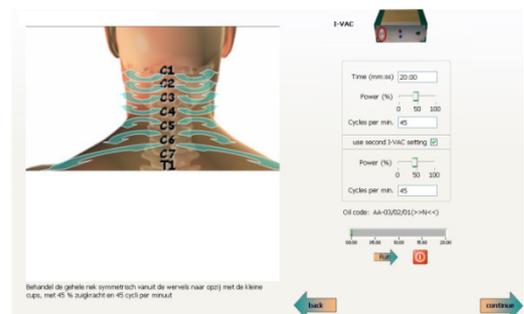

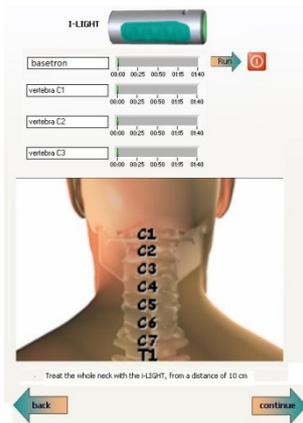


HALSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand (Ständer!).


I-ON VORBEHANDLUNG MIT I-LIGHT WEISS

- Klient in Rückenlage
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie die Aloe+Restorate-Mischung auf das Gesicht auf (2 TL Aloe : 1TL Restorate).
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht.
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT.

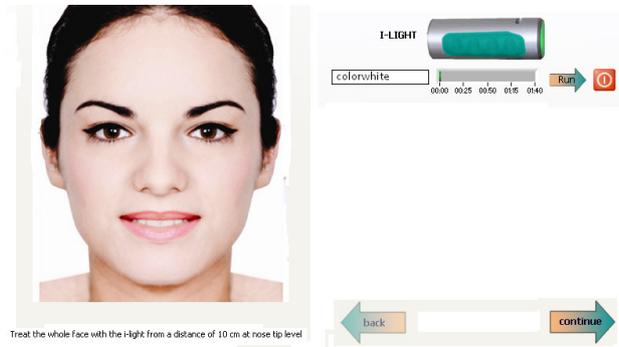

I-ON GESICHTSBEHANDLUNG

- Passen Sie die Amplitude an. Verbinden Sie das **ROTE** Kabel mit der Manschette (feuchtes Wattepad!) am Arm des Klienten und arbeiten Sie die ersten beiden Raymedys *Basatron* und *Cicatron* mit dem Dermaroller im ganzen Gesicht ein.
- Drücken Sie auf **Stopp**.
- Entfernen Sie das Aloe-Restorate-Gemisch sorgfältig mit einem feuchtwarmen Tuch.
- Tragen Sie nun großzügig eine angewärmte Mischung aus Aloe-Q10-Bauty Line 12h-Serum (2 TL:7 Tr:6 Hübe) auf das ganze Gesicht auf.
- Behandeln Sie das ganze Gesicht mit den verbliebenen Raymedys.
- Entfernen Sie die restliche Aloe-Mischung mit einem feuchtwarmen Tuch.

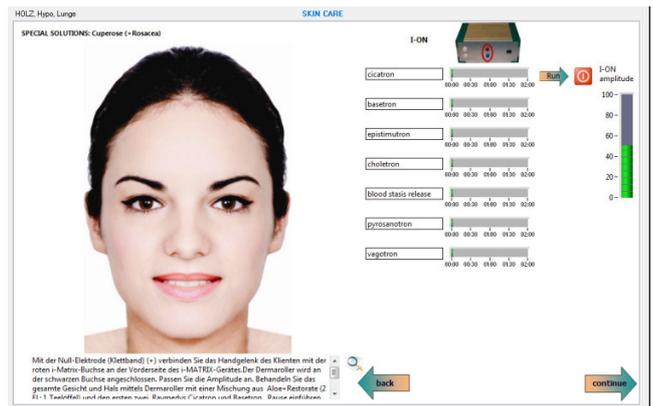




I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.

Wichtig: Passen Sie die Pumpintensität an die Hautbeschaffenheit Ihres Klienten an!
Vorsicht im Bereich der Äderchen!!

- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementkomplex vor und tragen Sie das Ölgemisch sorgfältig auf das ganze Gesicht auf. Dann schröpfen Sie mit den kleinsten runden Gläschen wie folgt (**Lymphdrainage**):
- In der Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
- Mitte der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns
- Dann weiter mit beiden kleinsten Schröpfgläschen von der Unterlippe bis unter die Kante des Kinns.
- Von der Nasolabialfalte bis unter die Kante des Kinns
- Von den Wangen bis unter die Kante des Kinns
- Von der Mitte der Unterkante des Kinns nach außen bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17)
- Von dort zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen
- Dann vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel (Akupunkt ext. Taiyang)
- Beginnend zwischen den Augenbrauen (Akupunkt ext.Intrang) bis zum Haaransatz
- Von der Mitte der Stirn jeweils nach außen zu den Schläfen und weiter auf den Akupunkt ext. Taiyang 3-4x pumpen
- Von dort nun bis zur Mulde unter dem Ohrläppchen (Akupunkt 3E17) 3-4x pumpen
- Zur Grube der Clavicula (Akupunkt Magen 11) 7-8x pumpen

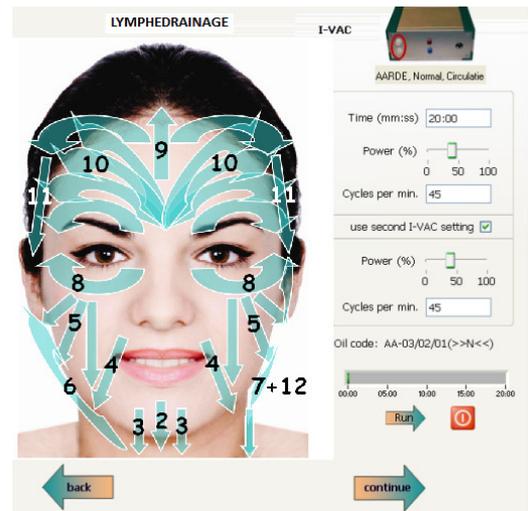


Bindegewebemassage Stufe 1 (55 Cycle)

- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen

Bindegewebemassage Stufe 2 (550 Cycle)


- Benutzen Sie nur ein flaches Schröpfgläschen
- von der Mitte aus unter der Lippe mit einer Bewegung nach oben (siehe Bild)
- ebenso an den Wangen
- von der Mitte der Stirn aus nach außen

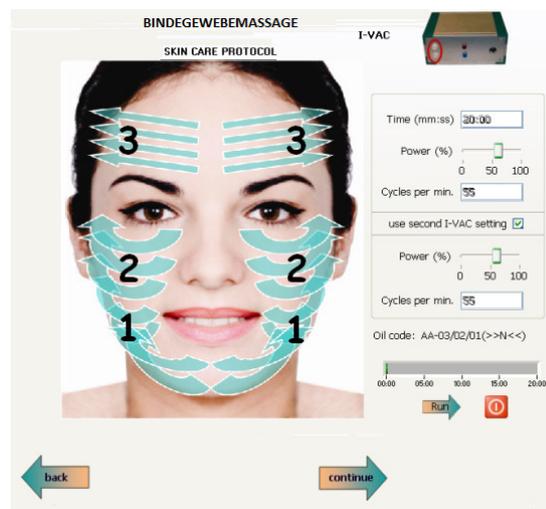



I-LIGHT GESICHT


- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht (Ständer!).
- Mit Klick auf **run** aktivieren Sie das i-LIGHT mit den Raymedys.

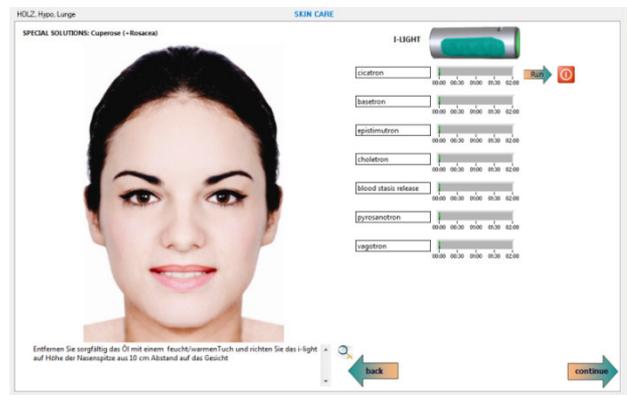

1986	Lu 11	2269
1989	Dc 1	2408
1925	C 9	2465
2281	DE 1	2405
2327	H 9	2400
2362	Du 1	2363
2364	Mo 1	2378
2411	La 1	2264
2405	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

MACHEN SIE EINE EDA MESSUNG

KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

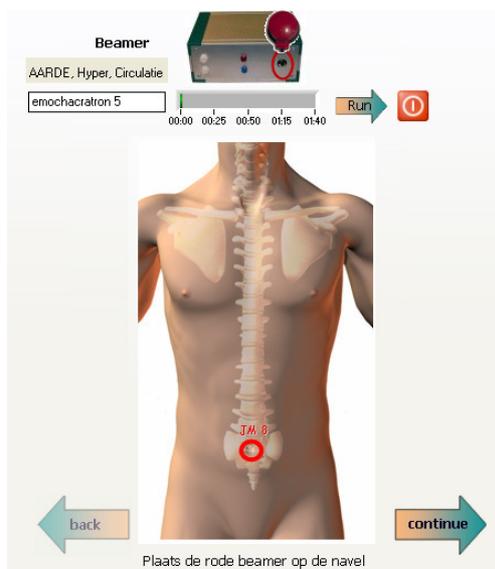

In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy Emochakratron 5 gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf **run**.
- Nach Klick auf **continue** ist das Programm beendet:

Protocoll is finished.