


HANDBUCH RAYMEDY ENERGY SKIN CARE



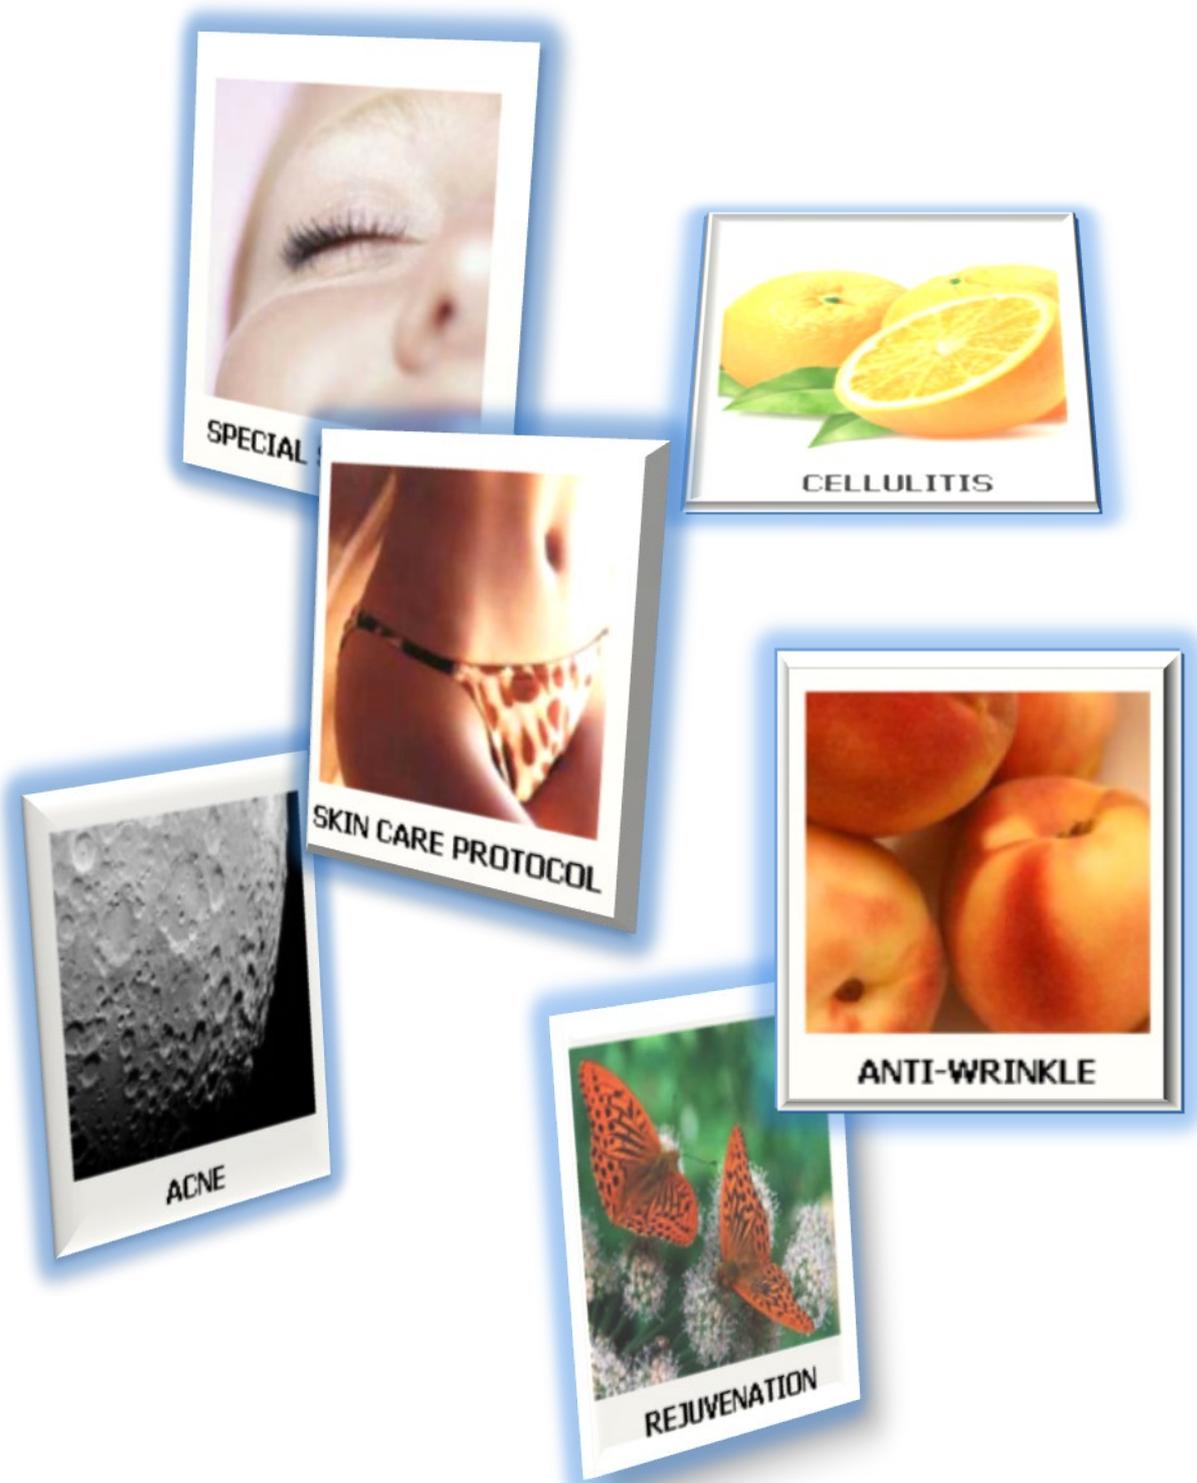

## INHALT

- 
- 1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME \_\_\_\_\_ 3**
- 1.2 MERIDIANE UND ORGANE \_\_\_\_\_ 3**
  - 1. RAYMEDYBEAUTY SYS: ZUSAMMENFASSUNG VON BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 5
- 2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN \_\_\_\_\_ 5**
- 2.2 BEHANDLUNG MIT i-LIGHT UND i-MATRIX \_\_\_\_\_ 5**
  - 3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS 10
- 3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN ? \_\_\_\_\_ 10**
- 3.2 KONTRAINDIKATIONEN \_\_\_\_\_ 12**
  - 4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL 13
- 4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES \_\_\_\_\_ 13**
- 4.2 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE \_\_\_\_\_ 14**
- 4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION \_\_\_\_\_ 15**
- 4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN \_\_\_\_\_ 15**
- 4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX \_\_\_\_\_ 18**
- 4.6. KONSOLIDIERUNG \_\_\_\_\_ 18**
- 4.7 START DES ENERGY SKIN CARE PROGRAMMS \_\_\_\_\_ 18**
- 5.1. REGENERATIONSPROGRAMM 1 \_\_\_\_\_ 21**
- 5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 – GESICHTSREVITALISIERUNG \_\_\_\_\_ 25**
- 5.3 REJUVENATION PROGRAMM \_\_\_\_\_ 32**
- 5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM \_\_\_\_\_ 36**
- 5.5 ACNE PROTOCOL \_\_\_\_\_ 43**
- 5.6 ZELLULITE-PROGRAMM \_\_\_\_\_ 49**
- 5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN \_\_\_\_\_ 54**



**RAYMEDYBEAUTY SYS:** Hautregeneration auf Basis der EDA (Electro Dermal Assessment)

## 1 INTERAKTIVE UND INTEGRIERTE BEHANDLUNGSPROGRAMME

Die Raymedy-Software für die elektronische Hautwiderstandsmessung wurde kombiniert mit den Geräten für die Anwendung von moduliertem galvanischem Strom, der rhythmischen Vacuummassage, der Stimulation mit Farbsequenzen und der elektromagnetische Regulation von Dermatomen, Reflexzonen und Akupunkturpunkten.


Alle Schritte des Programms wurden automatisiert; die Anweisungen des Programms sind dabei das direkte Ergebnis der letzten Messungen. Der Vergleich der Hautwiderstandsgrafiken vor, während und nach der kosmetischen Behandlung zeigt die genaue Reaktion des Klienten auf die Behandlung. Diese Herangehensweise gewährleistet eine wirksame und den aktuellen Erfordernissen entsprechende Behandlung.

### 1.2 MERIDIANE UND ORGANE

Der menschliche Körper ist ein offenes System in Bezug auf den Austausch von Energie und Information. Laut TCM sind Meridiane Kommunikationskanäle für Energie und Information. Sie sind wahrscheinlich das am längsten bekannte Regulationssystem innerhalb des Organismus. Seine Entwicklung beginnt im Embryonalstadium mit der Bildung der Blastomeren. Meridiane sind Proteinketten mit extrem hoher Leitfähigkeit, die den Bindegewebestrukturen folgen. Der elektrische Widerstand dieser Proteinketten liefert Information über den Zustand der Organe, die Funktion und Regulationsprozesse, die in Bezug zu diesen Meridianen stehen. Der Strom, der für die Raymedy-Messung verwendet wird, ist so minimal, dass er keine nennenswerte Wirkung auf Organe und Meridiane hat.

MERIDIAN	ORGAN	BEISPIELE FÜR DIE ZUSAMMENHÄNGE MERIDIAN-ORGAN-FUNKTION
Lunge	Lunge	Immunsystem, Haut, Gasaustausch
Dickdarm	Dickdarm	Lymphatisches System, Entgiftung
Magen	Magen	pH-Regulation
Milz/Pankreas	Milz, Pankreas, Blut	N. vagus, Kohlehydratstoffwechsel und Pankreas
Herz	Herz und Blutkreislauf	Emotionale Einflüsse, cardiale Blutversorgung

Dünndarm	Dünndarm	Enzymatische Verdauung
Blase	Blase	Urogenitalsystem, Nebenhöhlen, Augen, Wirbelsäule
Niere	Niere	Elimination von wasserlöslichen Substanzen, Flüssigkeitshaushalt
Kreislauf	Kreislauf und Epiphyse	Blutdruck, nervale Versorgung des arteriellen Systems, Kreislauf
Dreifach-Erwärmer	Hypophyse	Endokrines System
Leber	Leber	Proteinmetabolism
Gallenblase	Gallenblase	Cholesterol- und Fettmetabolism

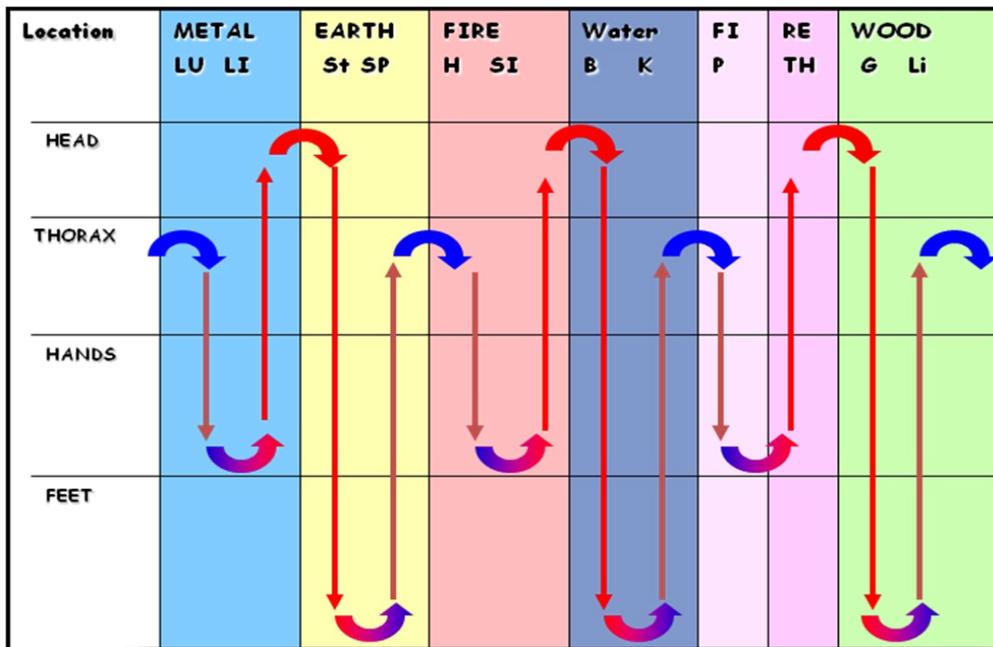

Topographie von Energie und Polarität im Meridiansystem der klassischen TCM. Der Kopf ist vollständig der Yang-Energie zugeordnet, die Brust zu 100% der Yin-Energie, während in Händen und Füßen die Polarität wechselt.



## 1. RAYMEDYBEAUTY SYS: ZUSAMMENFASSUNG VON BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

### 2.1 COMPUTERBERECHNETE KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

-Bewertung von vegetativem Stress und Übersäuerung mittels EDA, vorgenommen an den distalen Meridianpunkten an Händen und Füßen, wie sie in der TCM beschrieben sind.

-Verbesserung von vegetativer Stressregulation und Widerstandsfähigkeit, Optimierung von Blut- und Lymphkreislauf, Entgiftung, Entsäuerung und Hautregeneration mittels Elektromagnetismus, moduliertem galvanischem Strom, Vacuummassage und Farbsequenzen.

Das EnergySkinCare-Modul ist denkbar vielseitig und flexibel. Es und bietet ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten.

### 2.2 BEHANDLUNG MIT I-LIGHTUND I-MATRIX

#### 2.2.1 DIE HARDWARE.

Speziell für das EnergySkin-Modul entwickelt wurden das i-LIGHT(eine sehr starker LED-Farb-Beamer) und das i-MATRIX, ein kompaktes Gerät mit eingebauter Vacuumpumpe (i-VAC), einem galvanischen Modulator (i-ON) und einem Magnetfeldgenerator. Das i-VAC bietet digital gesteuertes rhythmisches Vacuumschröpfen der Haut und den damit verbundenen Bindegewebe- und Lymphstrukturen. Der modulierte galvanische Strom aus dem i-ON wird mit einem Dermaroller und Stabelektroden auf die Dermatome appliziert. Die Magnetfeldfrequenzen werden mit einem roten Beamer auf den Körper appliziert.

Die i-LIGHT-Batterie kann mit einem 5-Volt-Batterieladegerät aus dem Netz geladen werden. Wenn das Haut-Programm einmal gestartet und die beiden Geräte mit dem Laptop verbunden wurden, wird das passende Raymedy über die USB-Antenne auf das i-LIGHTheruntergeladen.

Das i-MATRIX-Gerät erhält seine Power ebenfalls aus dem Netz. Der modulierte galvanische Strom und die Magnetfeldsignale werden automatisch über die USB-Antenne an der Rückseite des Gerätes heruntergeladen.

#### 2.2.2.DIE SOFTWARE.

Die eigentliche Auswahl, der Befehl und die Dauer der Behandlungssignale ("Raymedys"), die während der kosmetischen Anwendung verwendet werden, werden automatisch (als Ergebnis einer EDA-Messung) angezeigt. Folgen Sie nur den Anweisungen auf dem Computerbildschirm. Die Raymedys sind verfügbar als



Farbsequenzen, als modulierte galvanische Signale und als Magnetfeldsignale. Die Farbsequenzen werden mit dem i-LIGHT, die modulierten galvanischen Signale mit dem i-ON und die magnetischen Feldsignale mit dem Beamer appliziert.

Das EnergySkinCare-Modul beinhaltet angesichts der verschiedenen individuellen kosmetischen Probleme mehrere Programme.

Beispiel: Die EnergySkinCare-Gesichtsrevitalisierung. Oft bringt schon die erste Behandlung mit diesem Protokoll sichtbare Ergebnisse. Darüber hinaus sind spezielle Programme verfügbar für die Behandlung von Zellulite, Falten, Verjüngung von Gesicht, Hals und Decolleté, außerdem spezielle Lösungen für die Hautfestigung an Brust, Armen, Beinen und Gesäß, Narben, Streifen, Male, (De-) Pigmentierungen, Couperose, Akne, Ekzem, Psoriasis und Rosacea.

---

### **2.2.3 AUFBAU DES PROGRAMMS**

Alle Programme sind ähnlich aufgebaut in Technologie und Durchführung wie die beiden Basis-Regenerationsprogramme, aber mit besonderem Augenmerk auf spezielle Problemzonen. In ca. 60-bis 90-minütigen Sitzungen werden Gesicht, Wirbelsäule, Bauch, Brust und Beine in 4 aufeinander folgenden Schritten auf angenehme, gründliche und effektive Art behandelt:

1. Matrixregulation
2. Revitalisation/Regeneration
3. Entgiftung
4. Festigung

Insbesondere dieser Aufbau und die Integration der Technologie werden für adäquate Stimulation von Fibroblasten und Kollagenen sorgen, die für die Revitalisierung und Hautverjüngung notwendig sind, ebenso wie Entsäuerung, Entgiftung und verbesserte Durchblutung für die Erhaltung der sichtbaren Ergebnisse.

---


### **2.2.4 MATRIX-REGULATION**

Im Regenerationsprogramm I wird die Entgiftung des Bindegewebes vorbereitet. Dieses Gewebe wird auch als Matrix, BBRS (Basic Bio Regulation System) oder Pischinger's Basic System bezeichnet.

Das Bindegewebe kontrolliert die Aufrechterhaltung der Homöostase, die durch kontinuierliche Anpassung den innerlichen biologischen Ausgleich darstellt zu den äußerlich wechselnden Gegebenheiten. Homöostase gewährleistet die Stabilität der Vitalfunktionen wie Temperaturregelung, Blutdruck, Blutzucker, Abwehr und pH-Wert. In vielen Situationen ist das Bindegewebesystem verschmutzt worden. Um Entgiftung zu fördern und Homöostase zu ermöglichen, werden spezifische Dermatome behandelt. Ein wichtiger und wirksamer Zugang zu diesen Dermatomen sind die sogenannten Back-Shu- oder YÜ-Punkte entlang der Wirbelsäule, auf dem inneren Ast des Blasenmeridians. Die Auswahl dieser Punkte wird vom Programm automatisch getroffen, als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die untenstehende Tabelle zeigt die Korrelation zwischen YÜ-

Punkten, Organen, Dermatomen und ihrer Lokalisation. Die verschiedenen Farben der Punkte auf dem Bild entsprechen den 5 Elementen: Metall (B13 und B25) silbergrau, Holz (B18 und B19) grün, Feuer (B14,15,22 und 27) rot und Wasser (B23 und B28) blau.

<b>Name</b>	<b>Organ</b>	<b>Element</b>	<b>Bindegewebszone</b>	<b>Lokalisation</b>
<b>B13</b>	Lunge	Metall	Lungen, Bronchien, Pleura, Brust	ICR 3
<b>B14</b>	Pericard	Feuer	Gallenblase, Magen und Milz	ICR 4
<b>B15</b>	Herz	Feuer	Leber, Magen, Solarplexus und Blut	ICR 5
<b>B18</b>	Leber	Holz	Nebennierenrinde	ICR 9
<b>B19</b>	Gallenblase	Holz	Nieren, Darm- und Gefäßwände	ICR 10
<b>B20</b>	Milz/Pankreas	Erde	Nieren, Blase, Urethra, Prostata	ICR 11
<b>B21</b>	Magen	Erde	Dünndarm, Ovarien, Lymphkreislauf	unterhalb der 12. Rippe
<b>B22</b>	Dreifach-Erwärmer	Feuer	Colon, Leistens	zwischen L1 und L2
<b>B23</b>	Nieren	Wasser	Appendix, Unterbauch, Oberschenkel	zwischen L2 und L3
<b>B25</b>	Dickdarm	Metall	Prostata, Unterschenkel, Knöchel, Füße, Zehen	zwischen L4 und L5
<b>B27</b>	Dünndarm	Feuer	Hüften, Becken, Hintern	neben der Untekante von S1
<b>B28</b>	Blase	Wasser	Hüften, Becken, Hintern	neben der Untekante von S2

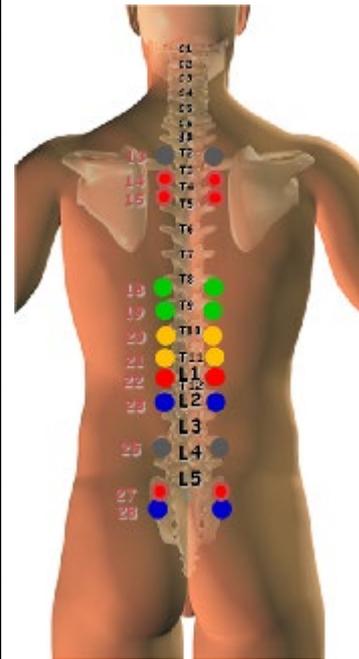

- a. Die Matrix-Regulation in 3 Schritten: Frequenzmodulierte Elektrophorese mit dem *i-ON*-Dermaroller bringt einen direkten Strom in den Körper auf Zonen und mit Frequenzen, die der Körper selbst ausgewählt hat, als Ergebnis der vorangegangenen EDA-Messungen. Die meisten dieser



problembezogenen Dermatome wurden im Gesicht lokalisiert, entlang der Wirbelsäule und im Unterleib. Mit der Behandlung dieser Dermatome wird die Durchblutung unterstützt und damit auch Entgiftung und Entsäuerung. Die Stimulierung der Fibroblastenproduktion führt zu einer bemerkenswerten Kräftigung, Verjüngung und Verbesserung von Gesichtshaut und Bindegewebeelastizität.

- b. Desweiteren wird die Homöostase kräftig unterstützt durch das *i-MATRIX*: rhythmisches, tiefes Vacuumschröpfen aktiviert Zellmetabolismus und Lymph- und Kapillarkreislauf. Es entfernt Ablagerungen und Knoten im Unterhautgewebe und reguliert das autonome Nervensystem über das Feedback der behandelten Dermatome.
- c. Alle problemrelevanten Wirbelsäulensegmente werden behandelt, vom Kopf bis zum Gesäßbereich. Zur energetischen Konstitution passende essentielle Öle verbessern das Behandlungsergebnis.
- d. Dieselben ausgewählten Hautsegmente werden mit dem *i-LIGHT* bestrahlt. Dieser sehr kraftvolle LED-Farbbeamer führt zur Photomodulation der Mitochondrien und der DNA-Synthese und Photonentransport in Haut-, Bindegewebs- und Muskelzellen. Die Kraftstoffversorgung des Organismus wird buchstäblich wiederhergestellt. Flexibilität, Stabilität und Glanz werden sichtlich profitieren. Neben der Stressregulation führt die *i-LIGHT*-Behandlung auch zu Harmonisierung, Entspannung und Revitalisierung.  
Kontraindiziert ist diese Behandlung bei Krampfanfällen in der Anamnese.  
Das *i-LIGHT* darf nicht direkt auf die Augen gerichtet werden.

### 2.2.5 GESICHTSREGENERATION/REVITALISATION: “DAS GALVANISCHE FACELIFTING”.

Das Regenerationsprogramm II startet mit der Behandlung der Halswirbelsäule, nacheinander mit dem *i-ON*, dem *i-VAC* und dem *i-LIGHT*. Diese Behandlung aktiviert indirekt die Gesichtsdermatome. Die drei vorausgegangenen Messungen sind notwendig, um die Gesichtsdermatome auszuwählen, die mit dem schwächsten Meridian zusammenhängen, außerdem auch für die Auswahl der Frequenz/des Raymedys, um ein direktes “galvanisches Lifting” durchzuführen.

Eine Verbesserung von Entsäuerung, Entgiftung, Durchblutung und Elastizität wird jetzt mit dem *i-ON*-Dermaroller und den Stabelektroden auf die problematischen Gesichtszonen in Gang gesetzt.

Danach wird das ganze Gesicht und der Hals mit den Vacuum-Schröpfköpfen des *i-VAC* massiert. Mit regulierbarer Saugkraft und Impulsfrequenz, kombiniert mit den zur energetischen Konstitution passenden essentiellen Ölen, wird eine Lymphdrainage und Massage des Bindegewebes erreicht.

Anschließend wird mit Hilfe des *i-LIGHT* die Verteilung der Photonen und die Stimulation der DNA-Synthese aktiviert, und zwar mit jenen Farbsequenzen, auf die der schwächster Meridian besonders ansprechen sollte.

---

## **2.2.6 ELIMINATION: BINDEGEWEBE- UND LYMPHDRAINAGE IM BAUCH- UND BRUSTBEREICH**

Besondere abdominelle und thorakale Entgiftungszonen werden ebenfalls mit der i-VAC-Schröpftechnik behandelt, unterstützt durch die individuell zusammengestellten essentiellen Öle. Die vorangegangenen Messungen sind notwendig, um die Bewegungsrichtung für diese Vorgänge zu ermitteln.

- Im Falle eines Energieüberschusses im Konstitutionselement werden Abwärtsbewegungen überwiegen.
- Im Falle eines Energiemangels oder eines normalen Energieniveaus im Konstitutionselement werden Aufwärtsbewegungen dominieren.

---

## **2.2.7 KONSOLIDIERUNG MIT MAGNETFELDFREQUENZEN UND INFRAROT**

Der letzte Schritt jedes Behandlungsprogramms ermöglicht dem Klienten, auf die Wirkung der Matrixregulation, Gesichtsrevitalisierung und Entgiftung mittels Bewertung der vegetativen Regulation zu antworten: Eine abschließende EDA-Messung errechnet das günstigste Magnetfeldsignal für eine optimale vegetative Regulation und zeigt so den bisherigen Behandlungserfolg.

Dieses spezielle Regulationssignal wird mit dem roten Beamer (dem EM-Transmitter) auf Brust-, Bauch- oder Halsregion appliziert. Die Durchblutung der peripheren Kapillaren wird so ausgeglichen, ebenso der zelluläre und der Neurotransmittermetabolismus. Es kommt zu einem tiefen und sehr angenehmen Gefühl von Ruhe und Entspannung.

### 3. AUSWAHL DES PASSENDEN PROGRAMMS

#### 3.1 WANN WENDE ICH WELCHES PROGRAMM AN?

In den meisten Fällen wird empfohlen, mit dem Regenerationsprogramm I (allgemeine Entgiftung) zu beginnen und mit dem Regenerationsprogramm II (Gesichtsrevitalisierung) nach einer Woche fortzufahren.

Daneben beinhaltet das EnergySkinCare-Modul besondere Programme für Zellulite, Falten, Verjüngung, Akne und "spezielle Lösungen" für Allergie, Couperose, Ekzeme, Narben, (De-) Pigmentierungen, Psoriasis und Rosacea. Alle Programme sind gleichartig aufgebaut und sorgen für eine ordentliche Reaktivierung und freien Energiefluss, indem saure und toxische Stoffe entfernt und stagnierende, festsitzende Energien ins Fließen gebracht werden. Der Körper reagiert darauf mit:

- Verbesserung der Regenerationsfähigkeit der Haut
- Steigerung von zellulärer Aktivität und Stoffwechsel
- Stimulation der natürlichen Fibroblastenproduktion
- Verbesserung des Feuchtigkeitshaushaltes der Haut
- Verbesserung von Hautdurchblutung und Stoffwechsel
- Verbesserte Oberfläche (weicher, elastischer, mehr Glanz)
- Verbesserte Bindegewebsstruktur
- Glättung von Linien und tiefen Falten
- Feinere Hautporen

**Die Programmoptionen**

Hauzustand	mögliche Ursachen	welches Programm?
Trockene und schuppige Haut	Insuffizientes Flüssigkeits- und Entgiftungsmanagement	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
gespannte und rissige Haut	Flüssigkeitsmangel	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Fleckige und irritierte Haut	Mangel an Schutz, hoher pH, mangelnde Balance zwischen Feuchtigkeit und Fett	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
farblose Haut	schlechte Durchblutung	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
schlechte Wundheilung	verminderte Fibroblastenaktivität	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Falten generell	Mangelnde Deckung der Zellschichten	Regenerationsprogramm I und II Anti-Falten
markante Nase-Mund-Falte	eingefallene schlaffe Wangen, verminderte Elastizität	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Augenringe	verminderte Entschlackung, reduziertes Sauerstoff- und Nährstoffangebot	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Stirnfalten	Risse und Verklebungen im Bindegewebe	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Zornfalten	Verklebungen der Hautschichten	Regenerationsprogramm I und II Anti-Falten
Wangenfalten	Risse und Verklebungen des Bindegewebes	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Couperose	Vascular capillar sclerosis	Regenerationsprogramm I und II Couperosis, Verjüngung
Unregelmäßige Pigmentation	allgemeine Alterung der Haut und unausgeglichenes Fett-Flüssigkeits-Verhältnis	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung
Oberlippenfalten	Lichenifikationen, Verdickungen	Regenerationsprogramm I und II Verjüngung, Anti-Falten
Akne vulgaris	Androgene Hormone, unausgeglichener Stoffwechsel, bakterielle Infektionen, äußere Umstände	Regenerationsprogramm I und II Akne
Cellulite	Hormone, Anhäufung und Verklebung von Fettzellen, Flüssigkeit und Toxinen	Regenerationsprogramm I und II Zellulite

---

### 3.2 KONTRAINDIKATIONEN

Einige Zustände oder Umstände sind nicht tauglich für die komplette oder partielle EnergySkinCare-Anwendung, wie beispielsweise:

- Verbrennungen, Verbrühungen, offene Wunden
- Hautinfektionen oder Entzündungen, virale und bakterielle Hauterkrankungen
- Furunkel und andere ansteckende Hautausschläge
- ernsthafte organische und/oder ansteckende Erkrankungen
- Elektromagnetische Stimulation ist kontraindiziert in der Schwangerschaft, bei erhöhter Thromboseneigung, bei Patienten mit implantiertem Schrittmacher oder Defibrillator und bei Patienten mit implantiertem Hörgerät
- Die i-LIGHT-Anwendung im Gesicht ist kontraindiziert bei Klienten mit Krampfanfällen in der Anamnese.

## 4. BEHANDLUNGSSEGMENTE/ZU BEHANDELNDE BEREICHE IM DETAIL

### 4.1 BEHANDLUNG DES BINDEGEWEBES

#### 4.1.1 EINFÜHRUNG

Das Bindegewebesystem ist in der Tat unser größtes Organ. Zusammen mit der extrazellären Flüssigkeit beinhaltet sie mehr als 60% des menschlichen Gewebes. Es verbindet Haut, Muskeln, Fett, Flüssigkeiten, Zellen und Organe. Es ist ein unabhängiges System und wird als B.B.R.S.(Basic-Bio-Regulation System), Matrix oder Pischinger's System.

Dieses System reguliert alle Vitalfunktionen wie Atmung, Kreislauf, Energiehaushalt, Stoffwechsel, Temperatur und pH.

Es kontrolliert den permanenten Austausch zwischen dem autonomen und dem zentralen Nervensystem, dem endokrinen System und dem Immunsystem.

Verteiler in diesem kompliziertem Austausch sind Neurotransmitter und den Stoffwechsel betreffende, immunregulierende und endokrine Substanzen. Alle wesentlichen Gegenmaßnahmen gegen pathogene Faktoren wie Kälte, Wind, Hitze, Schwüle, Nässe, Infektionen, Verletzungen, Narben und Fremdstoffen werden innerhalb des Bindegewebes ergriffen.

Lebensstil, Gewohnheiten und Lebensumstände, die Einstellung zum Leben und die Ernährung spielen eine wesentliche Rolle in der Aufrechterhaltung der Effektivität dieser autonomen, sich selbst regulierenden Anpassungsfähigkeit.

Biochemische Verschmutzung des Bindegewebesystems durch ständige Überladung scheint eine der wichtigsten Ursachen von chronischer Krankheit zu sein.

Aus diesem Grund ist die gründliche und konsequente Entgiftung des Bindegewebesystems der erste Schritt auf dem Weg zurück zu Vitalität, Schönheit und Gesundheit.

#### 4.1.2 BINDEGEWEBEZONEN: EIN WESENTLICHER BEHANDLUNGSBEREICH

Chronische, durch permanente Fehlregulation verursachte Bindegewebsveränderungen können in bestimmten Hautzonen anhand von Verfärbungen, Änderungen in Struktur, Temperatur und Durchblutung beobachtet werden. Diese Hautzonen stehen durch die segmentale Innervation in Bezug zu den inneren Organen.



Das Verhältnis zwischen bestimmten inneren Organen und (sub)dermalen Bereichen wurde um 1900 von dem britischen Neurologen Head entdeckt. Daher werden diese Bindegewebebereiche auch als "Head'sche Zonen" bezeichnet.

Alle inneren Organe und Organfunktionen haben ihr eigenes Projektionsfeld in Bindegewebezonen, genau unter der Haut. Die integrative Behandlung dieser Bindegewebezonen fördert die Selbstheilungskräfte sämtlicher Körperteile auf hormonale, neurologische und immunologische Weise.

### 4.1.3 DER URSPRUNG DER BINDEGEWEBEZONEN

Die embryonale Entwicklung zeigt in der Tat einen segmentalen Aufbau: eine aufeinanderfolgende Reihe miteinander verbundener Scheiben ähnlicher Zusammensetzung. Diese "slices" heißen auch "Somiten", "Ursegmente" und beinhalten verschiedene Strukturen. Diese Strukturen sind die Quellen besonderer Gewebe, die in einem späteren Entwicklungsstadium gebildet werden:

Sclerotome: die Quelle für die Bildung von Knochengewebe

Myotome: die Quelle für die Bildung von Muskelgewebe

Dermatome: die Quelle für die Bildung von Hautgewebe

Vasotome: die Quelle für die Bildung von Blutgefäßen

Viscerotome: die Quelle für die Bildung von Inneren Organen

Neurotome: die Quelle für die Bildung von Nervengewebe

Ein bestimmtes Segment enthält all diese Strukturen, was verständlich macht, dass jedes Teilchen von Haut, Muskel, Knochen, Nerv, Gefäß oder Organ aus einem Spinalsegment entspringt.

## 4.2 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE

Lymphdrainage und Massage des gesamten Bindegewebesystems werden mit Vacuum-Schröpf-Technik mit rhythmisch wechselndem Sog (i-VAC) vorgenommen. Dies fördert die Gefäßdurchblutung, den extrazellulären Stoffwechsel, den Lymphabfluss und den interstitiellen Toxinabtransport, und erreicht damit eine tiefe und gründliche Reinigung sämtlicher Gewebe und der gesamten Haut.

Vorzeitige und beschleunigte Alterung wird signifikant gebremst durch systematische Anwendung von Lymphdrainage und Bindegewebemassage, zusammen mit "galvanischem Facelifting", Farbtherapie und elektromagnetischer Feldtherapie. Dadurch fühlt sich jeder Klient nach einer SkinCare-Behandlung sehr entspannt und fit.

### 4.3 REVITALISIERUNG/REGENERATION

Die Behandlung mit dem i-On bewirkt eine indirekte Alkalisierung und eine Verbesserung von Durchblutung und Elastizität in den korrespondierenden Gesichtszonen. Lymphdrainage und Bindegewebemassage von Gesicht und Hals werden mit dem i-VAC durchgeführt.

Die abschließende Behandlung des Gesichtes mit dem i-LIGHT fördert die Stimulation der Photonenverteilung und DNA-Synthese durch die Applikation von speziell die Haut revitalisierenden Farbsequenzen.

### 4.4. LOKALISATION DER GESICHTSZONEN

#### OBERE HORIZONTALE STIRNZONE, AM HAARANSATZ

Diese Zone hat Bezug zur Blasenenergie. Horizontale Falten mit schuppiger und trockener Haut könnten das Resultat von stagnierender Flüssigkeit bei schwacher Nieren- und Blasenenergie sein.

#### MITTLERE HORIZONTALE STIRNZONE

Dieser Bereich hat Bezug zum Dünndarm. Schwache Verdauung durch Enzymmangel ist oft die Folge von unvollständiger Ausscheidung von Schlacken und Toxinen, und führt zu Falten und Pickel in diesem Bereich. Ausscheidung und Entgiftung können verbessert und erleichtert werden durch Korrektur der Ernährung, mehr körperlicher Aktivität und Zufuhr von natürlichem Wasser. Neben Erbfaktoren kann auch ein Zuviel an ungeeigneter, schlecht organisierter oder subjektiv ermüdender Arbeit frühzeitige Faltenbildung in diesem Bereich verursachen.

Eine blasser oder rote Stirn kann ein Anzeichen sein für gesteigerte Durchblutung oder emotionale Unausgeglichenheit.

#### TEMPORAL ZONE

Dieser Bereich hat Bezug zur Gallenblase. Hauterscheinungen an dieser Stelle können eine Anhäufung von Fettschlacken anzeigen und eventuelle Enttäuschungen aufgrund von zu hohen Erwartungen und Ungeduld.

#### ZONE ZWISCHEN DEN AUGENBRAUEN

Diese Zone hat Bezug zur Leber. Vertikale Falten zeugen von exzessivem Essen und Trinken, chronischem Stress, Schlafmangel und emotionaler Unausgeglichenheit durch nicht ausgedrückten, angestauten Ärger und dem Gefühl, generell unfähig zu sein.



---

## ZONE UM DIE AUGEN

Der Bereich unter den Augen hat Bezug zu den Nieren. Schwarz-blaue Augenringe können ein Zeichen sein für schwache Nieren- und Blasenenergie. Diese dunklen Ringe sind oft erblich bedingt und zeigen eine Dehydration, Flüssigkeitsstau und eine geringe Flüssigkeitsausscheidung an. Der Bereich oberhalb der Augen steht in Zusammenhang mit der Milz-Pankreas-Energie. Flüssigkeitsstau an dieser Stelle dürfte auf Probleme mit dem Kohlehydrat- und Zuckerstoffwechsel hinweisen. Gelb-braune Fettansammlungen um die Augen könnten chronische Probleme mit Leber- und Gallenblasenfunktion bedeuten. Ist der Bereich um die Augen grau gefärbt, dürften Erschöpfung, Stress und Durchblutungsstörungen vorliegen.

---

## NASE

Die Nase steht in Verbindung mit der Lunge bzw. der Atmung.

Nasenspitze und -rücken stehen in Bezug zur Herzenergie. Eine rote Nase mit weiten Kapillaren könnte ein Zeichen sein für ein Gefäßproblem, möglicherweise in Zusammenhang mit Blutdruck- oder Ernährungsproblemen.

---

## NASEN-MUNDWINKEL-FALTE

Dieser Bereich steht in Bezug zum Dickdarm. Hauterscheinungen oder eine tiefe Falte entlang der Nase könnten auf angestauten Müll und Toxine hinweisen, verursacht durch mangelhafte Colonaktivität (Obstipation oder Dysbiose).

---

## WANGEN

Falten im Bereich des Kieferknochens dürften auf unausgeglichene Lungenenergie hinweisen. Der Teil oberhalb des Kieferknochens, aber unterhalb der Nierenzone gehört zum Magen.

Empfindliche Couperose-Wangen könnten Ausdruck einer unausgeglichene Lungen-, Magen-, Milz- und/oder Herzenergie sein. Leichte Schwellungen dürften auf eine gestörte Kolonenergie hinweisen.

---

## ZONE UM DEN MUND

Die Haut um den Mund steht in Bezug zum Kreislaufmeridian.

Vertikale Falten um den Mund dürften hormonale Probleme anzeigen.

Pickel und Entzündungen in den Mundwinkeln können auf eine gestörte Herzenergie und/oder Colonenergie hinweisen.

**KINN**

Diese Zone steht, zusammen mit dem Augenbereich, in Bezug zu den Nieren. Entzündungen und Obstruktionen dürften auf Toxinansammlungen in den Nieren hinweisen, auf schwachen Flüssigkeitskreislauf und Menstruationsprobleme. Hautprobleme wie extremer Bartwuchs können mit hormonalen Disbalancen zu tun haben. Hautunreinheiten können eine schwache intestinale Funktion bedeuten.

**ÄUßERER KIEFERWINKEL**

Diese Zone bezieht sich auf die Gallenblasenenergie.

**HALS**

Rote Flecken oder unreine Haut mit Pickel stehen oft in Bezug zum Stresshormon Cortisol. Hauteruptionen im Hals- oder Brustbereich haben oft zu tun mit emotionaler Unausgeglichenheit und Problemen mit Lunge und Kreislauf.

**GESICHTSZONEN**

Gesichtszonen	Lokalisation	RAYMEDY
Blasenzone	Oberer horizontaler Stirnbereich	Renastimutron
Nierenzone	Unterhalb von Augen und Kinn	Renastimutron
Leberzone	Zwischen den Augen	Hepastimutron
Gallenblasenzone	Schläfenbereich Kieferwinkel	Hepastimutron
Herzzone	Nasenspitze und -rücken	Corstimutron
Dünndarmzone	Mittlerer horizontaler Stirnbereich	Lienostimutron
Kreislaufzone	Bereich um den Mund	Thalastimutron
Dreifach-Erwärmer-Zone	Äußerer Augenbrauenwinkel	Corstimutron
Magenzone	Wangen oberhalb des Wangenknochens	Lienostimutron
Milzzone	Oberhalb der Augenlider	Lienostimutron
Lungenzone	Wangenknochen, Nase	Pneumastimutron
Dickdarmzone	Nasen-Mundwinkel-Falte	Pneumastimutron



#### 4.5 ELIMINATION ÜBER ABDOMEN UND THORAX

Bindegewebemassage und Lymphdrainage im Abdominal- und Thorakalbereich mit dem i-VAC.

#### 4.6. KONSOLIDIERUNG

Der letzte Schritt jedes SkinCare-Programms gilt der Konsolidierung mittels Magnetfeldfrequenzen. Dies gibt dem Klienten das Gefühl von tiefer Ruhe und Entspannung, während das Vegetativum nachreguliert. Das Programm berechnet das hierfür günstigste Magnetfeldsignal und zeigt, wo es mit dem roten Beamer zu applizieren ist.

---

#### LOKALISATION DER AKUPUNKTURPUNKTE FÜR DIE KONSOLIDIERUNG

JM-3	vordere Mittellinie, 1 cun oberhalb des Schambeins
JM-8	auf den Nabel
JM-12	vordere Mittellinie, auf halbem Weg zwischen Brustbein und Nabel
JM-17	vordere Mittellinie, in der Mitte des Brustbeins
DM-14	rückwärtige Mittellinie, unterhalb von Vertebra C7 (Hals-Schulter-Niveau)

## 4.7 START DES ENERGY SKIN CARE-PROGRAMMS

### Die TDP Lampe

**Nach neuester wissenschaftlicher Forschung hat die Infrarot-Wärmebehandlung einen signifikant revitalisierenden Effekt auf die Gesichtshaut. Deswegen empfehlen wir nachdrücklich, jede EnergySkinCare-Behandlung mit einer 8-minütigen Bestrahlung des Gesichtes mit der TDP-Lampe zu beginnen.**

Die TDP-Minerallampe ist als Ferninfrarot-Wärmetherapiegerät ein medizinisch-technisches Gerät der FDA-Klasse II. Die Lampe ist NICHT Bestandteil der Hardware des EnergySkinCare-Programms.

Während die meisten Lampen eine gewöhnliche Nahinfrarotbirne nutzen, gibt die TDP-Lampe eine besondere



Bandbreite ferninfraroter elektromagnetischer Energie ab (im 2-50 Mikrometerbereich). Dieses Spektrum ähnelt dem der heilsamen Ferninfrarot-Strahlung der Moorbad-Anwendungen in der Balneotherapie. Analysen der Tonerde und spätere Versuche führten zur Entwicklung von medizinischem Gerät, das nun als TDP-Minerallampe bekannt ist, als eine therapeutische Ergänzung der Moxabustion. Die Lampe weist eine Mineralplatte auf, die mit einer einzigartigen geschützten mineralischen Rezeptur aus 33 Spurenelementen beschichtet ist. Diese Spurenelemente finden sich in verschiedenen chemischen Verbindungen auch im menschlichen

Körper. Da der menschliche Körper Ferninfrarotenergie leichter absorbiert als Nahinfrarotenergie, werden mögliche Defizite an Spurenelementen aufgefüllt. Klinische Untersuchungen bestätigen, dass die Kombination aus Ferninfrarot mit Spurenelementemission die Mikrozirkulation steigert und den Stoffwechsel ausgleicht, die Aktivität spezieller Enzyme steigert, Immunfunktion und Zellerneuerung fördert, die Haut regeneriert und das Bindegewebeverklebungen löst und so den natürlichen Heilungsprozess beschleunigt.

TDP ist ein Akronym für "Teding Diancibo Pu", was in etwas das spezielle elektromagnetische Spektrum meint. Die TDP-Minerallampe wurde 1978 in China erfunden und dort 1992 patentiert.

Sie wird von Akupunkteuren, asiatischen Körpertherapeuten und anderem medizinischen Fachpersonal genutzt. Der Stand der Forschung von 1985 zeigte, dass die Behandlung mit der TDP-Minerallampe bei über 30 verschiedenen Erkrankungen bei Mensch und Tier erfolgreich war.

In the USA ist die Behandlung mit der TDP-Minerallampe mit den Versicherern abrechenbar. Die Geräteklasse, der sie zugeordnet ist, ist von der FDA anerkannt für die zeitweise Linderung von Schmerzen und Arthritis.

### Zusätzliche synergistische Kosmetikprodukte

Wir empfehlen vier synergistische Kosmetikprodukte, die online bei FITLINE bestellt werden können:

- RESTORATE für die Remineralisierung und Alkalisierung der Haut
- Q10 DROPS und REBUILD 25 für bessere Ergebnisse bei der Antifaltenbehandlung
- CC CELL LOTION für die Optimierung der Zellulitebehandlung

Diese vier Produkte in Kombination mit den i-ON-Behandlungen zeigten einen derart bemerkenswerten synergistischen Therapieeffekt, dass wir sie in die Behandlungsprotokolle integrierten.

Folgenden Mischungen müssen vor der i-ON-Anwendung zubereitet werden:

- Für alle Protokolle außer SkinCare I: Aloe vera (2 EL) + Restorate (1 TL)
- Akne: Aloe vera (1 TL) + Q10 (7 Tropfen)


- Rejuvenation und Akne: Aloe vera (1 TL) + Q10 (7) + Rebuild 25 (3 Hübe)
- Zellulite: Aloe vera + CC Cell Lotion (1:2)

Jedes EnergySkinCare-Programm startet mit der Durchführung von 3 EDA-Messungen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil erscheint die SkinCare-Alkaline-Balance-Einführung auf dem Bildschirm, die Ihr Klient lesen sollte. Wir empfehlen, diese Einführung dem Klienten mindestens eine Woche vor seinem ersten Praxisbesuch zu mailen, um eine gute Vorbereitung sicherzustellen. Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil gelangen Sie auf das Auswahl-Menue des EnergySkin-Moduls.



Das linke Bild heißt "SkinCare-Protokoll". Mit Klick auf dieses Bild öffnet sich der nächste Bildschirm:

**Anzeige von Elementtyp, Energiemenge und schwächstem Meridian**

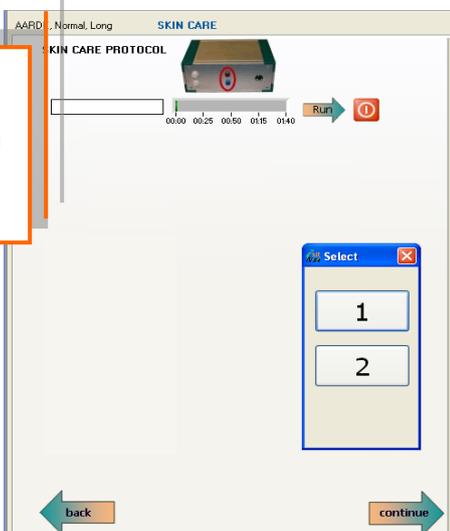

**Option für die Auswahl von Regenerationsprogramm1 oder 2**



## 5.1. REGENERATIONSPROGRAMM I

### 5.1.1 Regenerationsprogram I, Schritt 1

Für den ersten Schritt der Matrix-Regeneration werden, basierend auf den vorangegangenen EDA-Messungen, Frequenzen ("Raymedys") ausgewählt und in Form von galvanischem Strom angewandt.

- Der Klient liegt auf dem Bauch.
- **Schließen Sie den Dermaroller (-) an die schwarze i-Matrix-Buchse** an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes an.
- **Mit der Null-Elektrode (+)** verbinden Sie das Handgelenk des Klienten mit der **roten** i-Matrix-Buchse an der Vorderseite des i-MATRIX-Gerätes mit.
- Stellen Sie den Schalter auf "ON". Stellen Sie sicher, dass die Stabantenne an der Rückseite des Gerätes angeschlossen ist. Wenn die kabellose Übertragung nicht ausreichend arbeitet, erscheint eine Error-Meldung, die wieder verschwindet, sobald die notwendigen Maßnahmen durchgeführt worden sind. (siehe Bild).
- **Passen Sie die Amplitude an.** Die Stromamplitude kann mittels Cursor entlang der vertikalen Säule auf der rechten Seite des Bildschirms angepasst werden. Abhängig von Klient und der zu behandelnden Körperregion wird die Stromstärke unterschiedlich stark empfunden. Die Amplitude muss daher immer gerade eben unterhalb des sensiblen Levels eingestellt werden.
- Tragen Sie das Kontaktgel auf die angezeigten Hautareale auf.
- Klicken Sie auf den RUN-Pfeil neben dem oben angezeigten Raymedy.
- Bewegen Sie den Dermaroller **angezeigten Hautzonen entlang**, von der Wirbelsäule aus nach links und rechts. Die Behandlungszeit ist auf länger als 1 Minute voreingestellt, aber Sie können das Procedere für jedes Dermatom wiederholen oder auch jederzeit abbrechen. Mit Klick auf den RUN-Pfeil neben dem zweiten angezeigten Raymedy wird dieses aktiviert.
- **Klicken Sie auf den Continue-Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen**

SKIN CARE PROTOCOL

I-ON

heparanatron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40 RUN

cholesanatron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

100-  
80-  
60-  
40-  
20-

IVAC upload raymedy.vi

Make sure the I-VAC device is powered on

Busy... the window will be closed automatically if it succeeded


Cancel

Beweg met de dermarollervanuit het midden naar links en naar rechts

continue


## 5.1.2 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 2 DIE PULSIERENDE VACUUMMASSAGE

- Entfernen Sie das Kontaktgel.
- Tragen Sie das Mandelöl, vermischt mit dem speziell informierten Komplex aus essentiellen Ölen, auf den Rücken auf.
- Aktivieren das i-VAC mit Klick auf den RUN-Pfeil
- Bewegen Sie beide großen Schröpfköpfe symmetrisch und gleichzeitig in der angegebenen Richtung entlang der Wirbelsäule.
- Mit Klick auf den CONTINUE-Pfeil rechts unten fahren Sie im Programm fort.

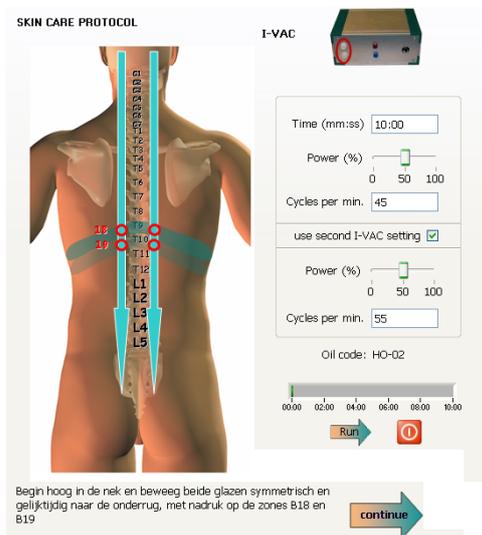

## 5.1.3 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 3

- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den RUN-Pfeil.
- Behandeln Sie die gezeigten Punkte mit dem i-LIGHTaus etwa 10 cm Abstand. Bewegen Sie das i-LIGHT dabei von der Wirbelsäule aus nach rechts und links außen.
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den CONTINUE-Pfeil.

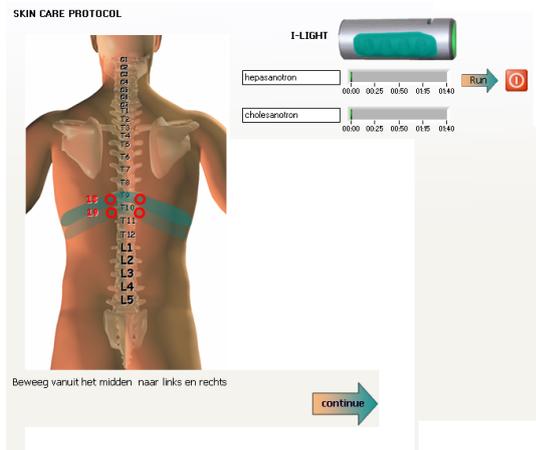


- Das Programm bittet Sie, eine weitere EDA-Messung vorzunehmen.



- Klicken Sie wieder auf den großen Pfeil.

#### 5.1.4 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 4 ELIMINATION

- Klicken Sie auf den blinkenden Pfeil in der oberen Bildschirmhälfte, um in das 4. Stadium des Regenerationsprogramms zu gelangen, die Elimination.
- Ihr Klient liegt auf dem Rücken, der Bauch ist frei.
- Tragen Sie die dazugehörige Ölkombination auf (in diesem Fall AA-3).
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den kleinen RUN-Pfeil.
- Nehmen Sie beide Schröpfköpfe in eine Hand.
- Setzen Sie mit den beiden Schröpfköpfen auf der linken oder rechten Bauchseite an und bewegen Sie diese wie angezeigt zur Bauchmitte hin, dann in der Mitte nach oben und seitwärts bis unter das Schlüsselbein. Danach behandeln Sie die andere Seite.

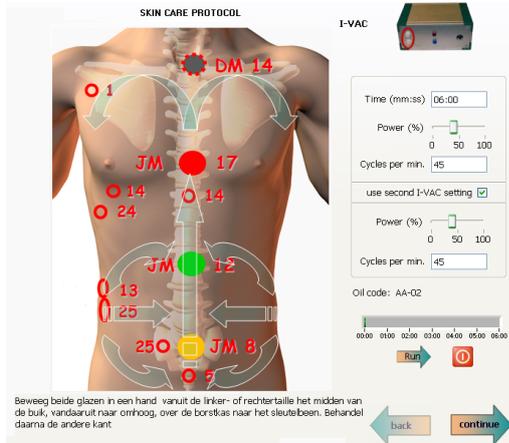


- Das Programm bittet Sie wieder, eine EDA-Messung vorzunehmen. Danach führt ein Klick auf den "continue"-Pfeil Sie zum 5. Schritt dieses Programms.



Heb		
Text 1 meidaan	Middelen instellen	
5109	Lo 11	3540
4937	Di 1	3498
4144	C 9	3926
3634	3E 1	4588
3383	H 9	4869
3419	Du 1	4873
4889	MP 1	4941
4726	Le 1	5086
4844	M 45	5852
4836	G 44	6827
4912	N 1	7203
4928	B 67	6319

### 5.1.5 REGENERATIONSPROGRAMM 1, SCHRITT 5 KONSOLIDIERUNG

- Verbinden Sie den Stecker des roten Beamers mit dem i-Matrix-Gerät.
- Klient in Rückenlage
- Halten Sie den Beamer auf den auf dem Bild angezeigten Punkt.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil neben dem angezeigten Raymedy.

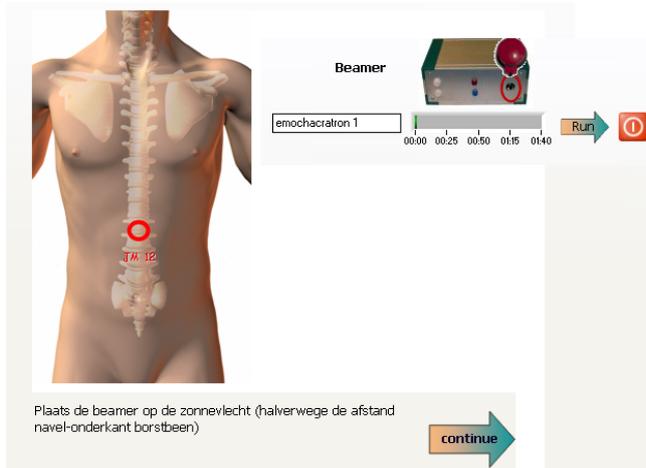

- Mit Klick auf den “continue”-Pfeil erfahren Sie, dass das Protokoll zu Ende ist: **Protocoll is finished.**

## 5.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2 –GESICHTSREVITALISIERUNG

### 5.2.1 Regenerationsprogramm 2 Schritt 1

Behandlung des Halses mit i-ON, i-VAC und i-LIGHT

Folgende Mischung müssen vor der i-ON-Anwendung zubereitet werden:

- Aloe vera (2 EL) + Restorate (1 TL)

#### Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit dem i-LIGHT




- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT ca 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT


## Nackenbehandlung mit i-ON

- Klient in Bauchlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Behandeln Sie den oberen Teil des Halses mit den beiden Stabelektroden des **i-ON** symmetrisch von der Wirbelsäule aus nach links und rechts
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um die Raymedys zu aktivieren
- Mit Klick auf den "Continue"-Pfeil kommen Sie weiter

## Nackenbehandlung mit i-VAC

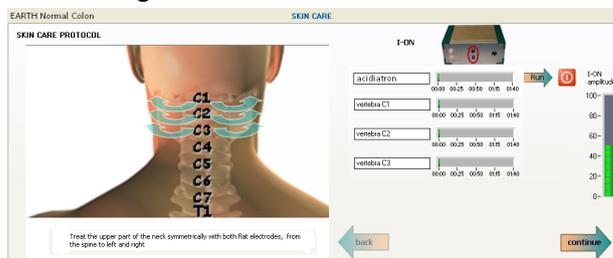


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie die angesagte Ölkombination auf die Behandlungszone auf (in diesem Fall Erde-normal-AA-02)
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-VAC**
- Wenden Sie die kleinen Schröpfköpfe nach Anweisung an
- Klicken Sie auf "Continue" um weiterzukommen

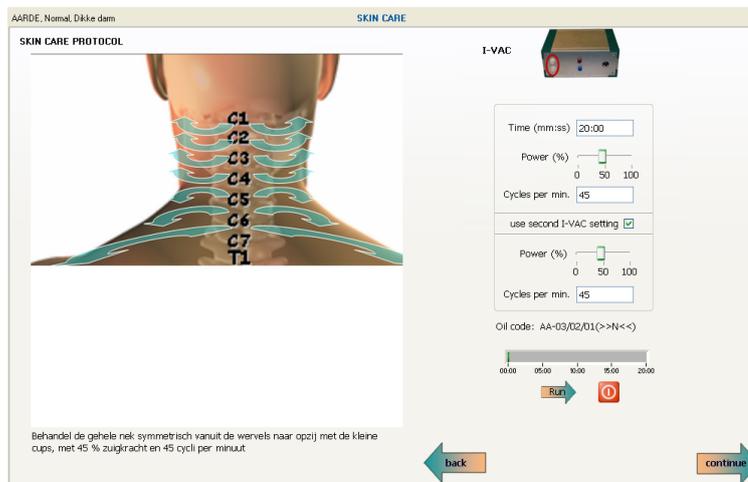


## Nackenbehandlung mit i-LIGHT

- Klient in Bauchlage
- Halten Sie das i-LIGHT ca 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf “run” aktivieren Sie das i-LIGHT

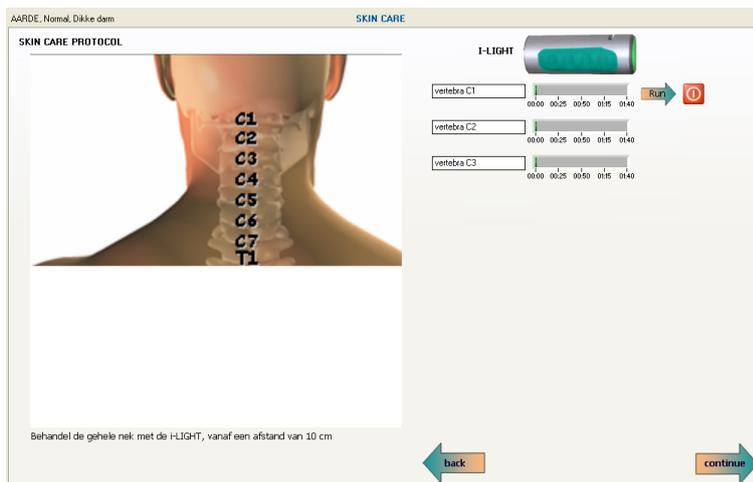


- Mit Klick auf “Continue” kommen Sie zur nächsten EDA-Messung

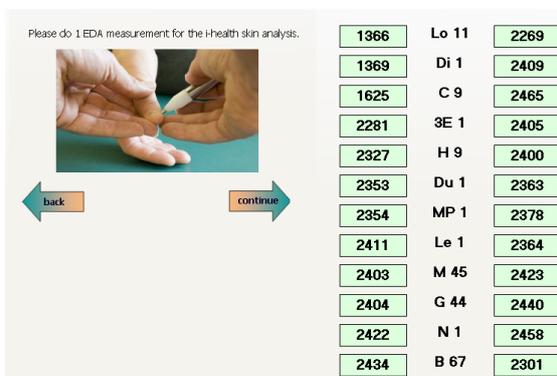

## 5.2.2 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2A: GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON

- Reinigen Sie die Gesichtshaut
- Verwenden Sie ausreichend Aloe+Restorate
- Fangen Sie an mit Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Passen Sie die Amplitude an (meist zwischen 70 und 80, wenn die 0-Elektrode gut angefeuchtet ist)
- Aktivieren Sie mit Klick auf den “run”-Pfeil das Raymedy Cicatron.
- Behandeln Sie nachdem zuerst das ganze Gesicht mit dem Dermaroller mit den Raymedys Cicatron und Acidiatron

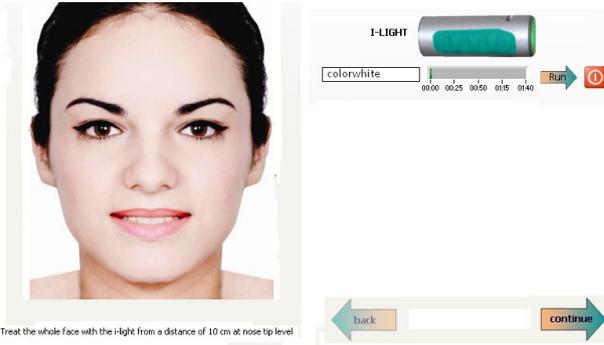

I-LIGHT


colorwhite

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

back continue

Treat the whole face with the I-light from a distance of 10 cm at nose tip level

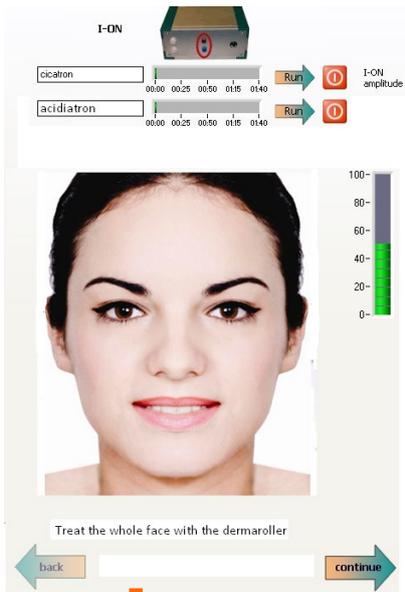

I-ON

cicaltron

acidiatron

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

I-ON amplitude




100-  
80-  
60-  
40-  
20-  
0-

Treat the whole face with the demaroller

back continue

Passend zu dem laut vorangegangener EDA-Messung schwächsten Meridian werden 3 Gesichtszonen nacheinander mit den beiden Stabelektroden behandelt.

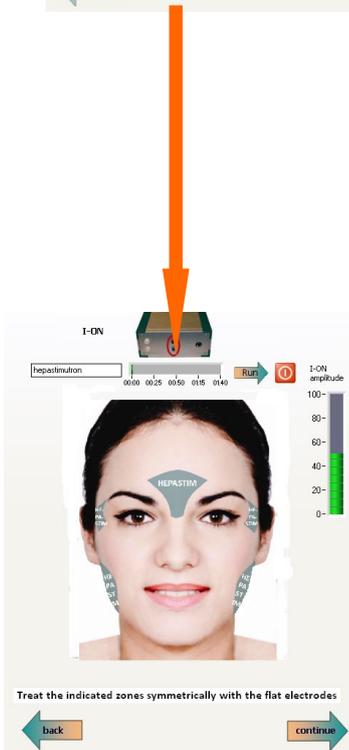


I-ON

hepasmultion

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

I-ON amplitude




HEPASTIM

100-  
80-  
60-  
40-  
20-  
0-

Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes

back continue

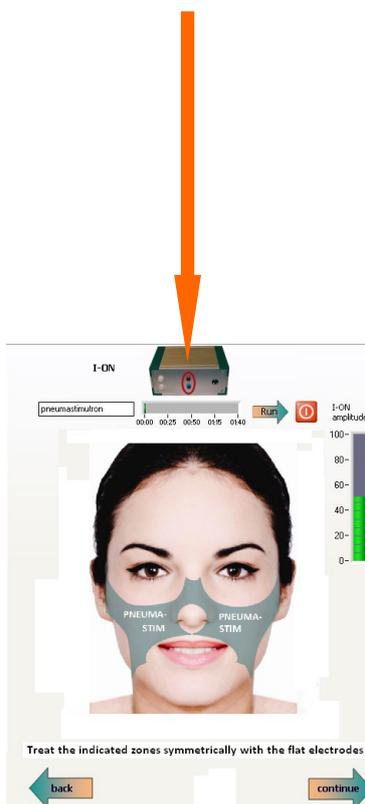

I-ON

pneumastimultion

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

I-ON amplitude




PNEUMASTIM

100-  
80-  
60-  
40-  
20-  
0-

Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes

back continue

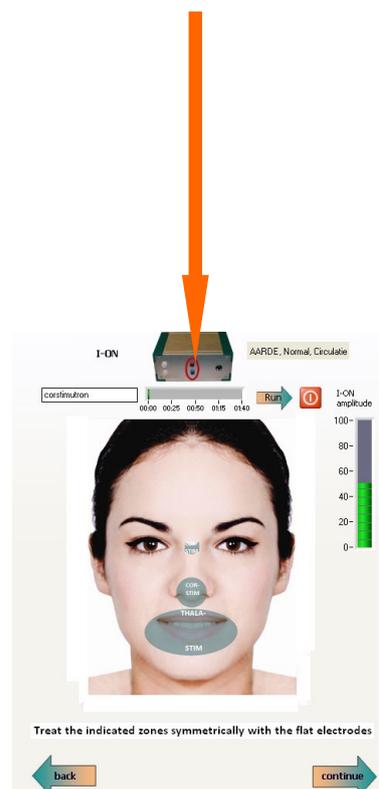

I-ON


AARDE, Normal, Circulate

thalamultion

00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

I-ON amplitude



THALASTIM

100-  
80-  
60-  
40-  
20-  
0-

Treat the indicated zones symmetrically with the flat electrodes

back continue


### 5.2.3 REGENERATIONSPROGRAMM 2, SCHRITT 2B. GESICHTSSCHRÖPFUNG

Behandlung mit dem i-VAC in 2 Schritten: Lymphdrainage und Bindegewebemassage. **Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.**

- Entfernen Sie die verbliebene Aloe-Mischung
- Bereiten Sie die Mischung aus Mandelöl und dem angezeigten Elementekomplex vor.



### 5.2.4 REGENERATIONSPROGRAMM 2 SCHRITT 2C. GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-LIGHT.

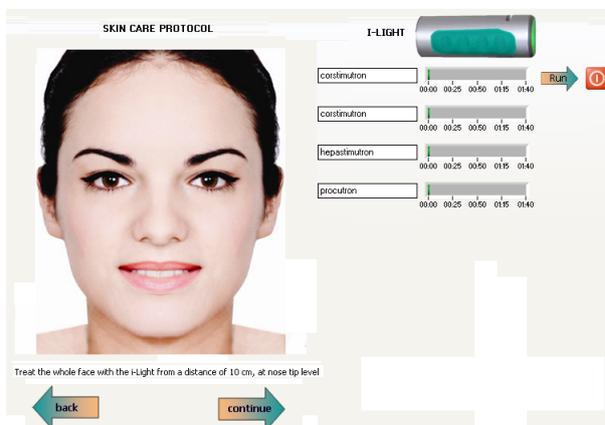


- Das Gesicht wird mit ähnlich meridianregulierenden Raymedys wie in Schritt 2a behandelt, nun aber mit Farblight, mit einem kräftigen hautvitalisierendem Raymedy als Abschluss



- Mit einer weiteren EDA-Messung wird das Raymedy für die Konsolidierung bestimmt.

### 5.2.5 REGENERATIONSPROGRAMM 2; SCHRITT 3 KONSOLIDIERUNG

- Klient in Rückenlage
- Verbinden Sie den roten Beamer mit dem i-Matrix-Gerät
- Halten Sie den Beamer auf den angezeigten Bereich.
- Aktivieren Sie das entsprechende Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil neben diesem Raymedy.

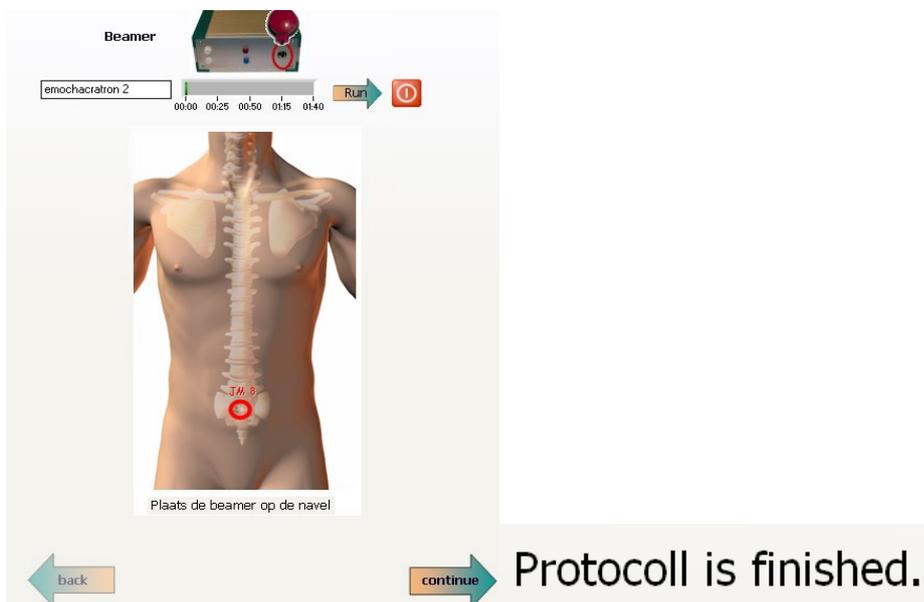

- Mit Klick auf den "continue"-Pfeil wird Ihnen mitgeteilt, dass das Programm zu Ende ist.


### 5.3 REJUVENATION PROGRAMM



#### Das REJUVENATION-PROGRAMM (ANTI-AGE) im Überblick


1. Bestrahlung des Gesichtes für 8 Minuten mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf den Hals
4. Weißes Licht mittels i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll: Der gesamte Nacken wird mit dem Dermaroller mit den ersten beiden Raymedys (Cicatron und Acidiatron) behandelt.
6. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
7. I-LIGHT nach Protokoll
8. Gesichtsmaske mit Aloe+Restorate
9. I-LIGHT mit weißem Licht
10. i-ON mit dem Dermaroller mit Cicatron und Acidiatron
11. Entfernung der Reste von Aloe+Restorate, dann weiter mit dem I-ON Protokoll, mit Aloe + Q10 + Rebuild 25
12. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
13. I-LIGHT nach Protokoll
14. EDA-Messung
15. Emochakraton mit Beamer

- Nehmen Sie 3 EDA-Messungen vor, um den Elementetyp, das Energielevel und die Energieverteilung des Klienten zu bestimmen.
  - Dann klicken Sie auf "Rejuvenation".
  - Im Fenster „select“ wählen Sie die 1




### 5.3.1 VERJÜNGUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

#### Vorbereitung i-ONbehandlung mit i-LIGHT WEISS

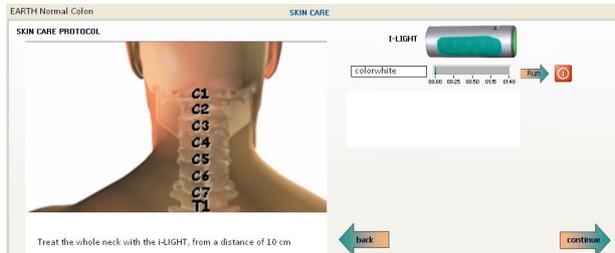


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

#### Halsbehandlung mit i-ON

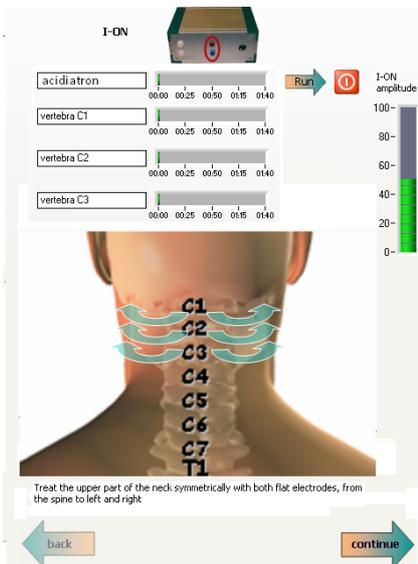

- Klient in Bauchlage
- Bringen Sie die Null-Elektrode am Handgelenk des Klienten an
- Tragen Sie das Kontaktgel auf die zu behandelnde Zone auf
- Passen Sie die Amplitude an
- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil um die Raymedys zu aktivieren
- Behandeln Sie mit den beiden flachen Stabelektroden des i-ON
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen


#### Halsbehandlung mit i-VAC

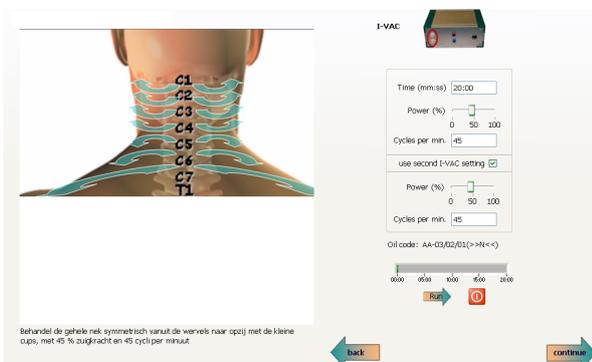

- Klient in Bauchlage
- Mischen Sie das Mandelöl mit dem Elementekomplex
- Tragen Sie es im zu behandelnden Bereich auf
- Mit Klick auf den "run"-Pfeil aktivieren Sie das i-VAC-Gerät
- Verwenden Sie die kleinen Vacuum-Schröpfköpfe laut Anweisung
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den

"continue"-Pfeil

#### Halsbehandlung mit i-LIGHT

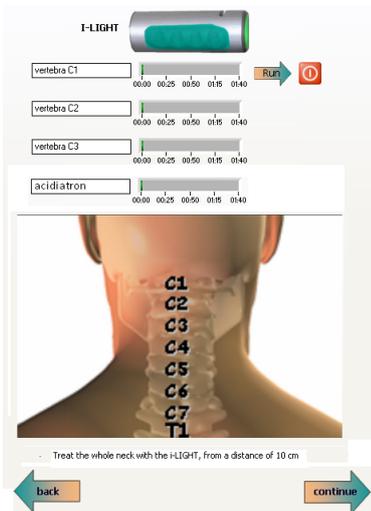

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT
- Behandeln Sie den Hals mit dem i-LIGHT aus etwa 10 cm Abstand


### 5.3.2 GESICHTSVERJÜNGUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT



Treat the whole face with the i-light from a distance of 10 cm at nose tip level



- i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Klient in Rückenlage
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

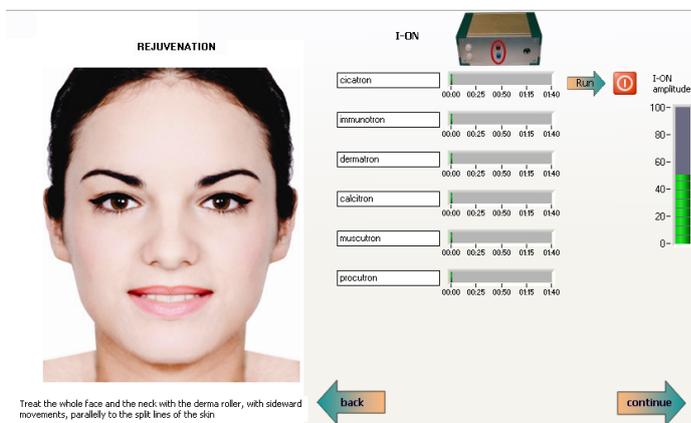

Treat the whole face and the neck with the derma roller, with sideward movements, parallelly to the split lines of the skin

Bringen Sie die Null-Elektrode am Handgelenk des Klienten an

- Passen Sie die Amplitude an
- Klicken Sie auf den "run"- Pfeil um die erste 2 Raymedys zu aktivieren
- Behandeln Sie das Gesicht mit dem Dermaroller
- Entfernen Sie verbliebenes Aloe-Restoratemischung
- Bereiten Sie die Mischung aus Aloe + Q10 + Rebuild25 vor, und tragen Sie diese Mischung auf Gesicht und Hals auf.

- Gehen Sie weiter mit der Gesichtsbehandlung
- Klicken Sie den "continue"- Pfeil um weiterzukommen

### 5.3.3 I-VAC-BEHANDLUNG IN 2 SCHRITTEN: LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE.

Je nach Saugkraft, Pulsation und Bewegungsrichtung hat die i-VAC-Behandlung einen Drainageeffekt auf das lymphatische System oder eine entgiftende und regenerierende Wirkung auf das Bindegewebe.

- Entfernen Sie das verbliebene Kontaktgel
- Mischen Sie das Mandelöl mit dem angegebenen Elementekomplex



### 5.3.4 I-LIGHT GESICHTSBEHANDLUNG

Please do 1 EDA measurement for the i-Health skin analysis.




1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca 10 cm Distanz auf die Nasenspitze
- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "Run"-Pfeil
- Mit Klick auf "continue" wird eine weitere EDA-Messung für die folgende Gesichtsrevitalisierung erforderlich

### 5.3.5 KONSOLIDIERUNG MIT DEM BEAMER

In diesem Beispiel hat das Programm, passend zum aktuellen Energieüberschuss im Erde-Element, automatisch das Raymedy Emochacatron 5 gewählt: Abführung des Energieüberschusses an das Metall.

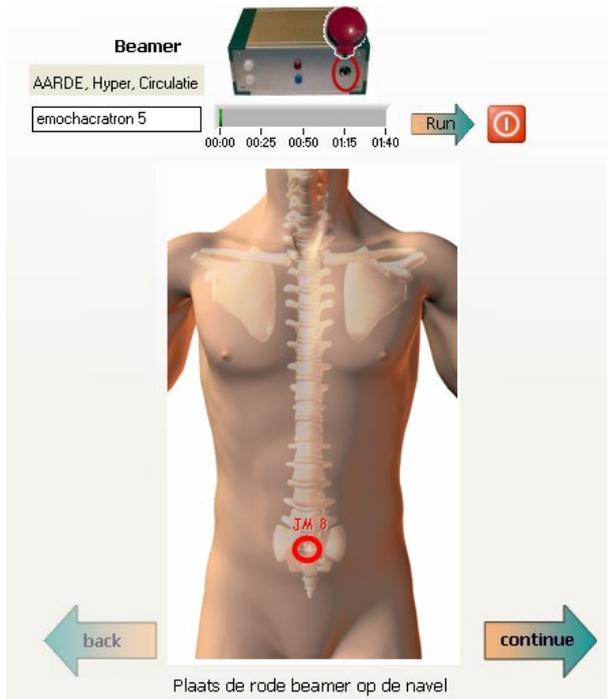

- Klient in Rückenlage
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"- Pfeil

Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Programm beendet:

**Protocoll is finished.**

## 5.4 ANTI-FALTEN-PROGRAMM




ANTI-WRINKLE

### Das ANTI-WRINKLE-PROGRAMM im Überblick

1. Bestrahlung des Gesichts für 8 Min. mit der Infrarot-Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen der Aloe-Restorate-Mischung auf den Nacken
4. weißes Licht mit dem i-LIGHT
5. I-ON nach Protokoll mit Aloe + Restorate: Mit dem Dermaroller wird der gesamte Nacken mit den ersten beiden Raymedys behandelt
6. i-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
7. I-LIGHT nach Protokoll
8. Gesichtsmake mit Aloe+Restorate
9. Weißes Licht mit dem i-LIGHT
10. i-ON: Dermaroller mit Cicatron und Acidiatron
11. Entfernung der Rückstände von Aloe + Restorate, weiter mit dem I-ON-Protokoll mit Aloe + Q10 + Rebuild 25 (extra Rebuild 25 auf die Falten )
12. i-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
13. i-LIGHT nach Protokoll
14. EDA-Messung
15. Emochakraton mit dem Beamer


### 5.4.1 VORBEREITENDE HALSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

#### Vorbereitung i-ONbehandlung mit i-LIGHT WEISS

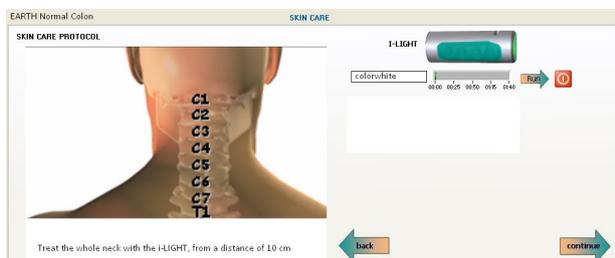

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT


#### Halsbehandlung mit i-ON

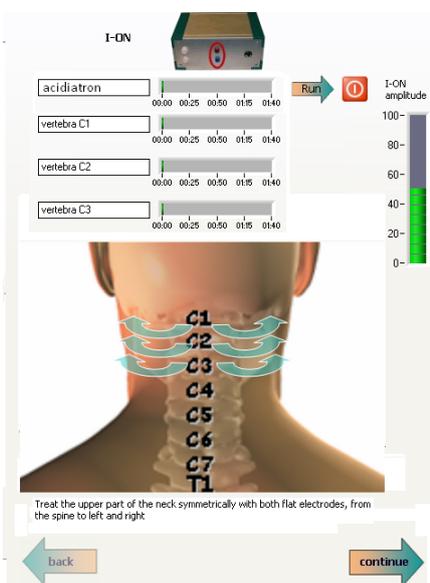

Treat the upper part of the neck symmetrically with both flat electrodes, from the spine to left and right

- Klient in Bauchlage
- Bringen Sie die Null-Elektrode am Handgelenk des Klienten an
- Tragen Sie das Kontaktgel auf die zu behandelnde Zone auf
- Passen Sie die Amplitude an
- Klicken Sie auf den "run"- Pfeil um die Raymedys zu aktivieren
- Behandeln Sie mit den beiden flachen Stabelektroden des i-ON
- Klicken Sie auf den "continue"- Pfeil um weiterzukommen


### Halsbehandlung mit i-VAC

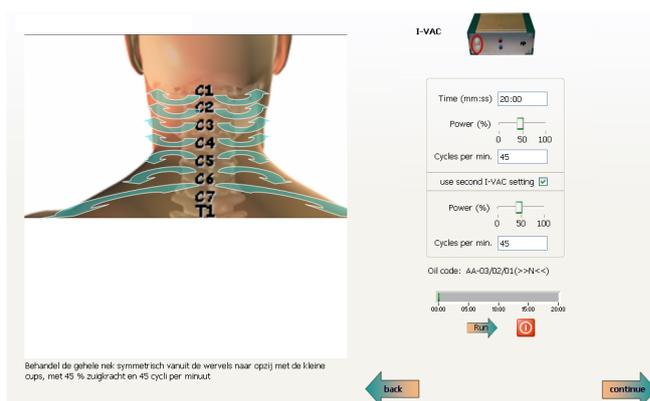

Behandel de gehele nek. symmetrisch vanuit de wervels naar opzij met de kleine cups, met 45 % zuigracht en 45 cycli per minuut

- Klient in Bauchlage
- Mischen Sie das Mandelöl mit dem Elementekomplex
- Tragen Sie es im zu behandelnden Bereich auf
- Mit Klick auf den "run"- Pfeil aktivieren Sie das i-VAC-Gerät
- Verwenden Sie die kleinen Vacuum-Schröpfköpfe laut Anweisung
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"- Pfeil

### Halsbehandlung mit i-LIGHT

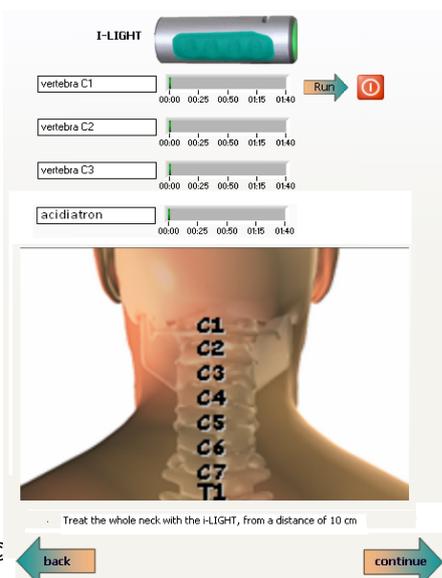


Treat the whole neck with the i-LIGHT, from a distance of 10 cm

- Klient in Bauchlage
- Mit Klick " auf den "run"-Pfeil aktivieren Sie das i-LIGHT
- Halten Sie das es aus ca. 10 cm Abstand auf den Hals
- Wenn Sie mit diesem Schritt fertig sind, klicken Sie auf "continue"



## 5.4.2 BEHANDLUNG DER HÄUFIGSTEN FALTEN MIT DEM I-ON

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Mischung aus Aloe + Restorate, eine andere aus Aloe + Q10 + Rebuild25. Verwenden Sie zusätzlich Rebuild25 direkt auf die Falten.

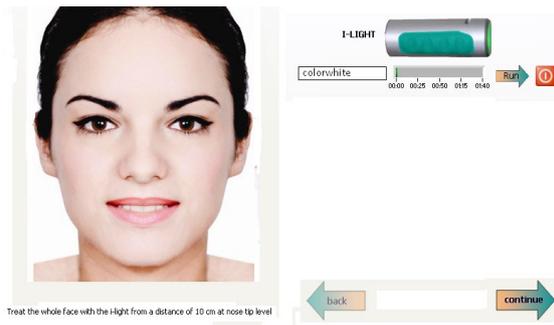

- Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

Im üblichen zeitlichen Rahmen eines Praxisbesuches ist es nicht möglich, alle Falten gründlich zu behandeln. Besprechen Sie also, welche Falten die Problemfälle darstellen, setzen Sie Prioritäten und folgen Sie den Behandlungsanweisungen auf den Screens, für die Sie sich eben entschieden haben. Die anderen überspringen Sie.

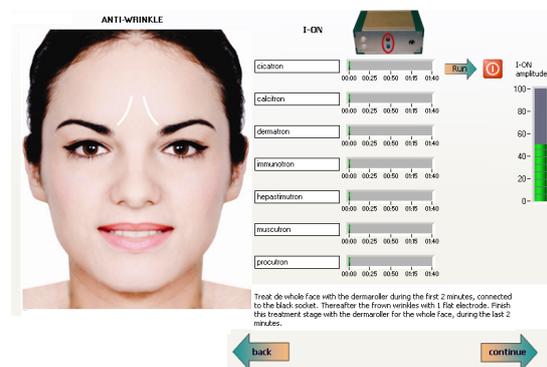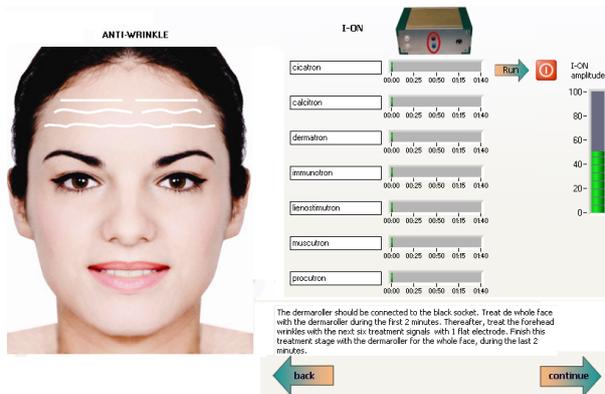

**ANTI-WRINKLE**




Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
constimatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40

I-ON amplitude: 0-100

The demaroller should be connected to the black socket. Treat the whole face with the demaroller during the first 2 minutes. Thereafter the upper nose wrinkles with 1 flat electrode. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

**ANTI-WRINKLE**





Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
hepatoimmunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40

I-ON amplitude: 0-100

Treat the whole face with the demaroller, connected to the black socket, during the first 2 minutes. Treat thereafter the crowfeet wrinkles on one side with the next 6 treatment signals with one flat electrode. Then, treat the other side in the same way. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

**ANTI-WRINKLE**

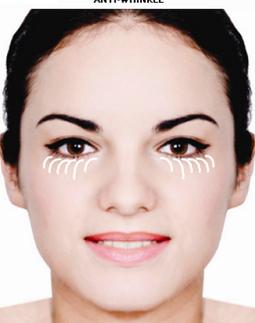
Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
renastimatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40

I-ON amplitude: 0-100

The demaroller should be connected to the black socket. Treat the whole face with the demaroller during the first 2 minutes. Thereafter the frontal eye wrinkles with one flat electrode. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

**ANTI-WRINKLE**

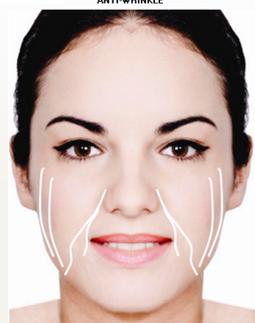Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
pneumastimatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40

I-ON amplitude: 0-100

The demaroller should be connected to the black socket. Treat the whole face with the demaroller during the first 2 minutes. Thereafter the nasolabial wrinkles with one flat electrode. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

**ANTI-WRINKLE**




Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
thalsstimatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40

I-ON amplitude: 0-100

The demaroller should be connected to the black socket. Treat the whole face with the demaroller during the first 2 minutes. Thereafter the upper lip wrinkles and nasolabial wrinkles with one flat electrode. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

**ANTI-WRINKLE**




Mode	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
calcitron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
dermatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
immunotron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
pneumastimatron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
muscutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40
procutron	00:00	00:25	00:50	01:15	01:40


I-ON amplitude: 0-100

The demaroller should be connected to the black socket. Treat the whole face with the demaroller during the first 2 minutes. Thereafter the neck wrinkles with one flat electrode. Finish this treatment stage with the demaroller for the whole face, during the last 2 minutes.

back continue

### 5.4.3 LYMPHDRAINAGE UND BINDEGEWEBEMASSAGE MIT DEM I-VAC



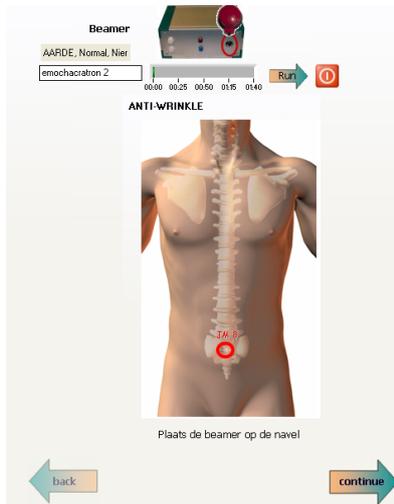

## KONSOLIDIERUNGSPHASE

**Klient in Rückenlage**


**Passend zur aktuellen energetischen Balance im Erdelement wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Enochacatron 2: es stabilisiert die persönliche Elementenenergie**

**Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil**

Mit Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Anti-Faltenprogramm beendet und wird geschlossen:

Protocoll is finished.

## 5.5 AKNE-PROTOKOLL

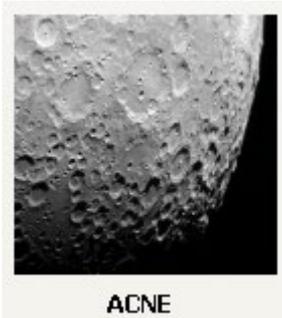


### Überblick über das Akne-Programm

1. Bestrahlung des Gesichts für 8 Min mit der Infrarot Lampe (TDP-lamp)
2. 3 EDA-Messungen
3. Auftragen von Aloe + Restorate auf den Hals
4. Weißes Licht mit dem i-LIGHT
5. i-ON nach Protokoll mit Aloe + Restorate: Der gesamte Hals wird mit dem Dermatroller mit der ersten beiden Raymedys behandelt
6. i-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
7. i-LIGHT nach Protokoll
8. Gesichtsmaske mit Aloe + Restorate
9. weißes Licht mit dem i-LIGHT
10. i-ON: Cicatron und Acidiatron mit dem Dermaroller
11. Entfernung der Aloe+Restorate-Rückstände, weiter mit dem I-ON-Protokoll mit Aloe + Q10
12. i-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
13. i-LIGHT nach Protokoll
14. EDA-Messung
15. Emochakraton mit dem Beamer


### 5.5.1 VORBEREITENDE AKNEBEHANDLUNG DES HALSES MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

## Vorbereitung der i-ON-Behandlung mit i-LIGHT WEISS

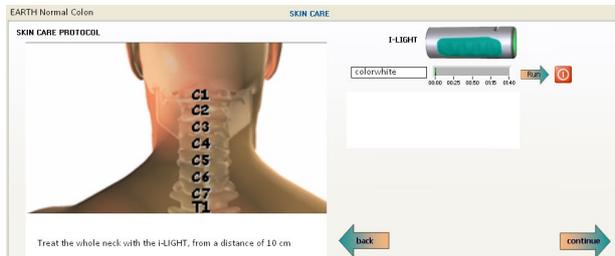


- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf die zu behandelnden Zonen auf
- Halten Sie das i-LIGHT aus ca 10 cm Abstand auf den Hals
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

## Aknebehandlung des Halses mit i-ON:

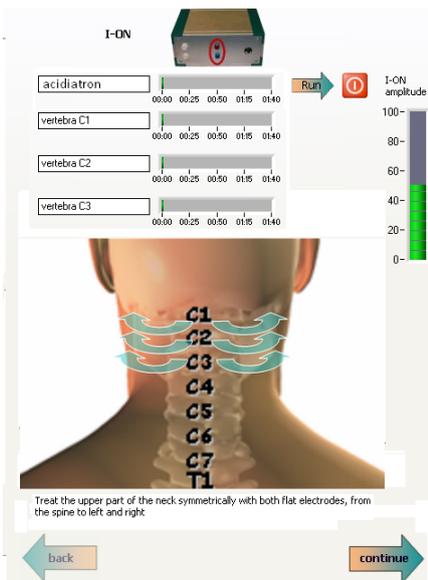


- Klient in Bauchlage
- Bringen Sie die Null-Elektrode am Handgelenk des Klienten an
- Tragen Sie das Kontaktgel auf die zu behandelnde Zone auf
- Passen Sie die Amplitude an
- Klicken Sie auf den "run"- Pfeil um die Raymedys zu aktivieren
- Behandeln Sie mit den beiden flachen Stabelektroden des i-ON
- Klicken Sie auf den "continue"- Pfeil um weiterzukommen

## Aknebehandlung am Hals mit dem i-VAC:

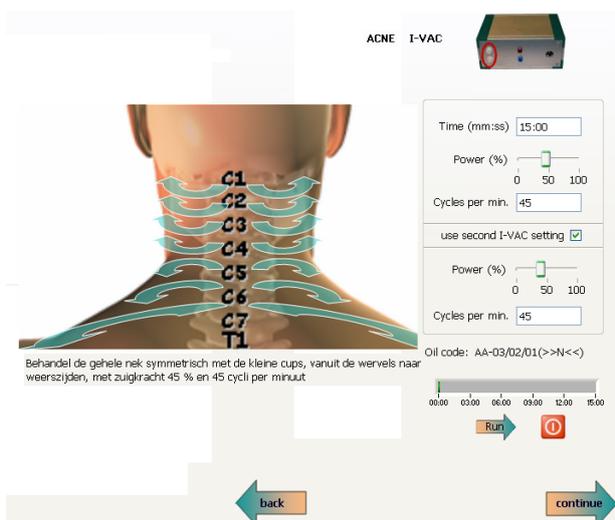

- Klient in Bauchlage
- Tragen Sie das mit dem Elementekomplex vermischte Mandelöl wie auf dem Bildschirm aufgezeigt auf den zu behandelnden Bereich auf
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-VAC
- Verwenden Sie die kleinen Vacuum-Schröpfköpfe nach Anweisung
- Klicken Sie auf „continue“

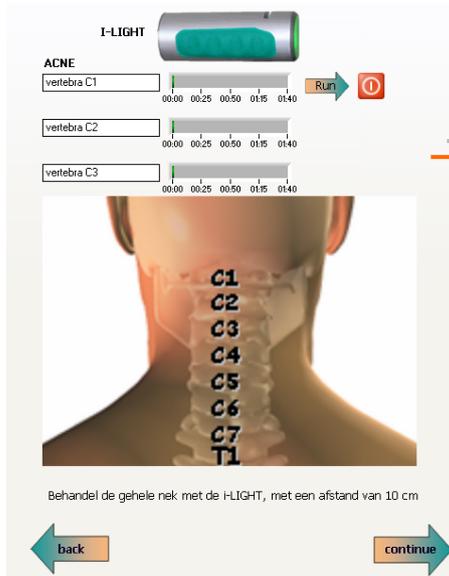


### AKNEBEHANDLUNG DES HALSES MIT DEM i-LIGHT:

Klient in Rückenlage

Richten Sie das i-LIGHT aus ca. 10 cm Distanz auf den Hals  
Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT


Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

## 5.5.2 BEHANDLUNG DER GESICHTSAKNE MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

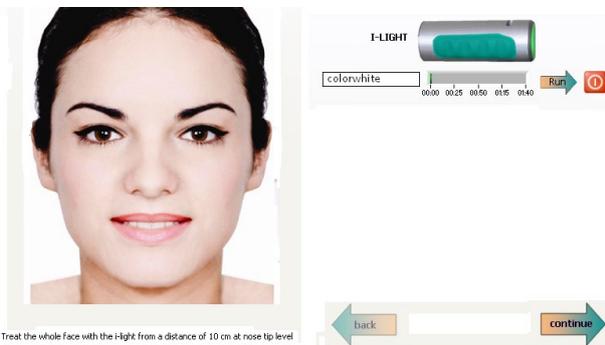

- i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe + Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das **i-LIGHT**

### Gesichtsaknebehandlung mit i-ON:

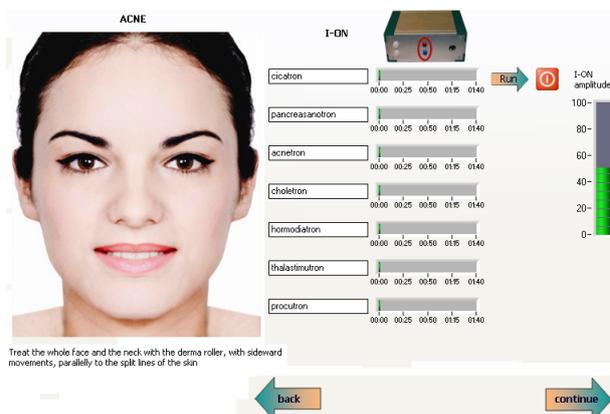


- Adaptieren Sie die Stromamplitude gerade unter das sensible Niveau
- Aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "run" –Pfeil
- Schließen Sie den Dermaroller an der schwarzen Buchse am i-Matrix-Gerät an
- Schließen Sie die Null-Elektrode an der roten Buchse des i-Matrix-Gerätes an
- Behandeln Sie das ganze Gesicht mit dem ersten Raymedy durch Klick auf den "run"–Pfeil
- Entfernen Sie die Reste von Aloe +



Restore und machen Sie weiter mit Aloe+Q10


- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu kommen

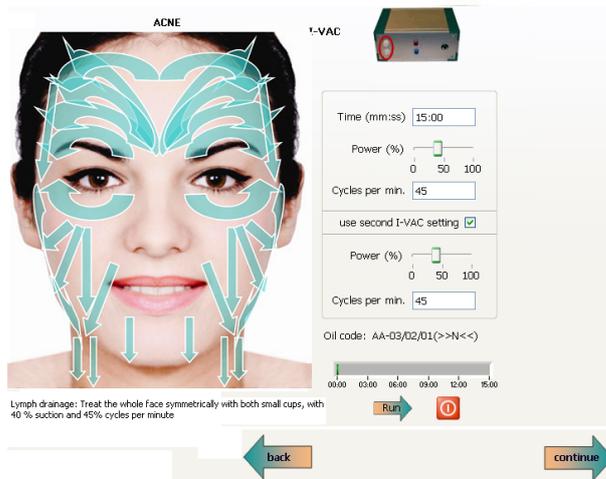

### Gesichtsaknebehandlung mit i-VAC:

Klient in Rückenlage


Entfernen Sie das verbliebene Kontaktgel und mischen Sie das Mandelöl mit dem Elemente-Ölkomplex wie auf dem Bildschirm angegeben Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

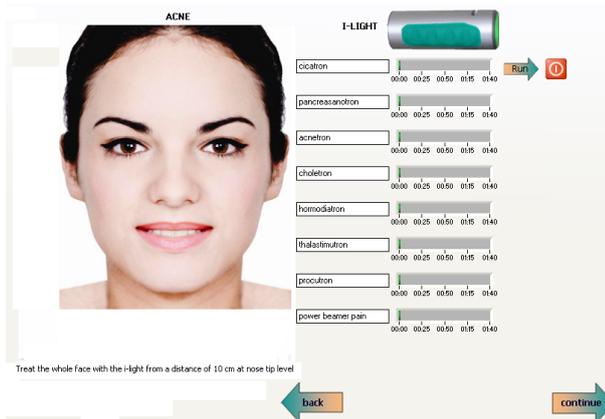

### Gesichtsaknebehandlung mit dem i-LIGHT:

- Klient in Rückenlage
- Entfernen Sie das überschüssige Öl und aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "run"-Pfeil neben den Raymedys
- Richten Sie das i-Light auf Höhe der Nasenspitze aus ca 10 cm Distanz auf das Gesicht
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

## 5.5.3 AKNEPROGRAMM:KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

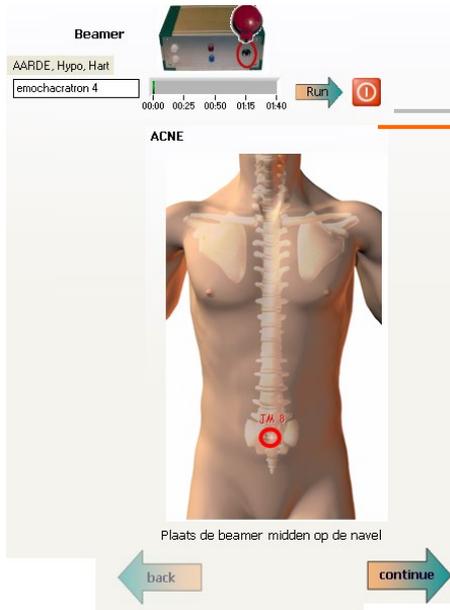

#### KONSOLIDIERUNGSPHASE

- Klient in Rückenlage
- Passend zum aktuellen Energiemangel im Erdeelement wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochacatron 4, um Energie aus dem Feuelement zuzuführen.
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Nach Klick auf den "continue"-Pfeil ist das Akneprogramm beendet und wird geschlossen:  
Protocoll is finished.

## 5.6 ZELLULITE-PROGRAMM

Aus praktischen topographischen Gründen wurde die Zellulite in diesem Programm in 3 Formen unterteilt, entsprechend der Korrelation mit den zugehörigen Meridianen:


Ga/Le, (Gallenblase/Leber), MP/Ma (Milz/Pankreas-Magen) und N/Bl (Niere/Blase)

Ga/Le-Zellulite wird behandelt, während der Klient auf der rechten oder linken Seite liegt, MP/Ma-Zellulite in Rückenlage und die N/Bl-Zellulite in Bauchlage. Da die MP/Ma-Funktion bei allen Zellulite-Arten eine wichtige Rolle spielt, empfehlen wir, jede Zellulite-Behandlung mit der Behandlung der MP/Ma-Meridiane/Zonen zu kombinieren.

*Während des Zellulite-Programms werden Bilder von den Zellulite-Zonen, den Dermatomen, den Shu-Punkten und den Alarm-Punkten gezeigt.*

**3 EDA-Messungen bestimmen den Konstitutionstyp des Klienten (normal, hypo- oder hyper)**

Nach Auswahl des Zellulite-Programms erscheinen 3 Arten von Zellulite auf Ihrem Bildschirm:

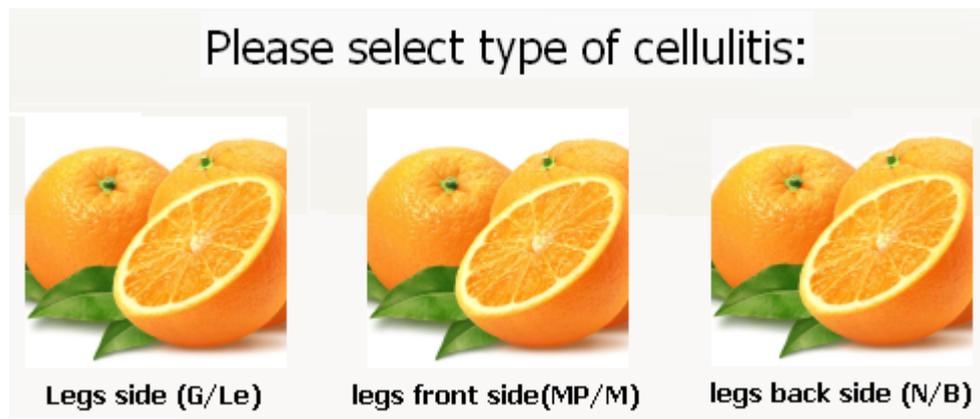


Alle Zellulite-Programme liefern eine Zellulite-Behandlung insbesondere der Beine und sind ähnlich aufgebaut. Der Unterschied besteht nur bezüglich der Behandlungszonen. Deswegen wird nur das Ga/Le-Programm im Detail beschrieben.

### 5.6.1 ZELLULITE-PROGRAMM GA/LE (AUSSENSEITE DER BEINE)



Es sind 3 EDA-Messungen notwendig für die Bestimmung von Elementtyp, Energieniveau, Regulationsfähigkeit, Energieverteilung und des schwächsten Meridians. Als Ergebnis zeigt der nächste Bildschirm die empfohlene Bewegungsrichtung für die Schröpfköpfe mit dem persönlichen Ölkomplex an.

### 5.6.2 ZELLULITE-PROGRAMM GA/LE BEHANDLUNG DES RÜCKENS MIT DEM I-VAC

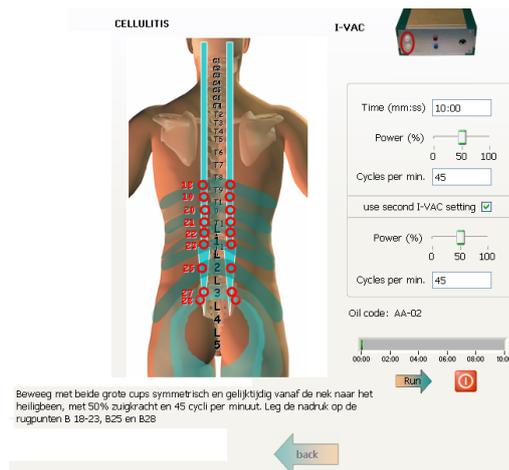

**CELLULITIS**

**I-VAC**

Time (mm:ss) 10:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Oil code: AA-D2

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00

back continue

Beweeg met beide grote cups symmetrisch en gelijktijdig vanaf de nek naar het heiligbeen, met 50% zuigracht en 45 cycli per minuut. Leg de nadruk op de rugpunten B 18-23, B25 en B28

#### ZELLULITE: Behandlung des Rückens mit dem i-VAC:


- Klient in Bauchlage
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Saugkraft und Pulsation sind programmiert
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil, wenn Sie damit fertig sind.

### 5.6.3 ZELLULITEPROGRAMM GA/LE: BEHANDLUNG DER PROBLEMZONEN MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT


Die hier beschriebene Behandlung muss am anderen Bein wiederholt werden.

- 8 Min. Infrarot-Bestrahlung der Problemzonen
- Auftragen der Aloe+Restorate-Mixtur auf die lateralen Problemzonen
- Mit dem i-LIGHT weißes Licht auf diese Bereiche
- i-ON: Cicatron und Acidiatron mit dem Dermaroller
- Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe mit CC Cell-Lotion

- Weiterführung der i-ON-Behandlung

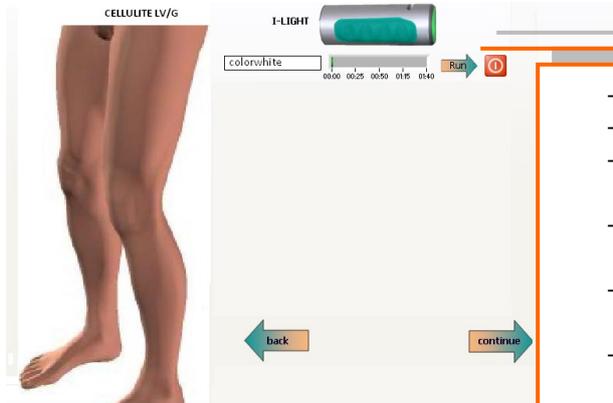


- CELLULITE: Vorbehandlung mit dem i-LIGHT
- Klient in Seitenlage rechts oder links
- Tragen Sie die Aloe+Restorate-Mischung auf die lateralen Problemzonen auf
- Klick auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Richten Sie das i-LIGHT aus ca 10 cm Distanz auf das Bein
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

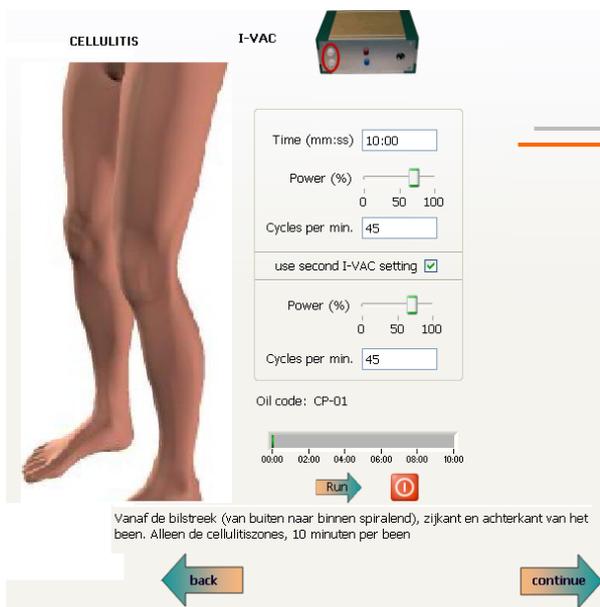

#### ZELLULITE:


- Beinbehandlung mit dem i-ON
- Klient in Seitenlage
- Passen Sie die Stromamplitude an
- Aktivieren Sie das i-ON mit Klick auf den "run"-Pfeil
- Nach Cicatron entfernen Sie die Aloe+Restorate-Reste und tragen Aloe+CC Cell-Lotion auf
- Fahren Sie fort mit der i-ON-Behandlung
- Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen

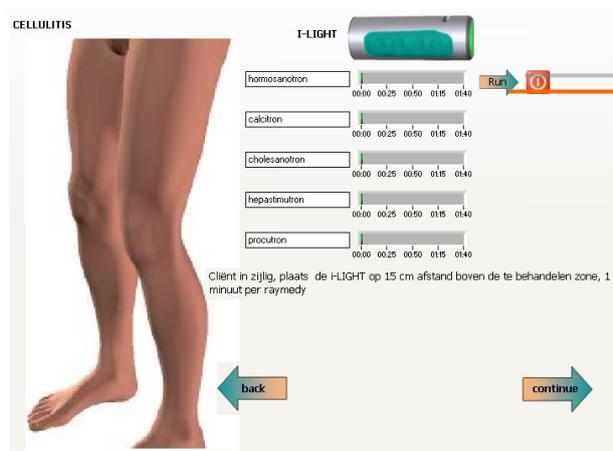

#### ZELLULITE:


- Beinbehandlung mit dem I-LIGHT
- Klient in Seitenlage rechts oder links
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Aktivieren Sie das i-LIGHT mit Klickauf den "run"-Pfeil
- Wenn Sie mit dem i-LIGHT fertig sind, klicken Sie auf "continue" um weiterzukommen

## 5.6.4 ZELLULITEPROGRAMM GA/LE: BAUCHBEHANDLUNG MIT DEM I-VAC

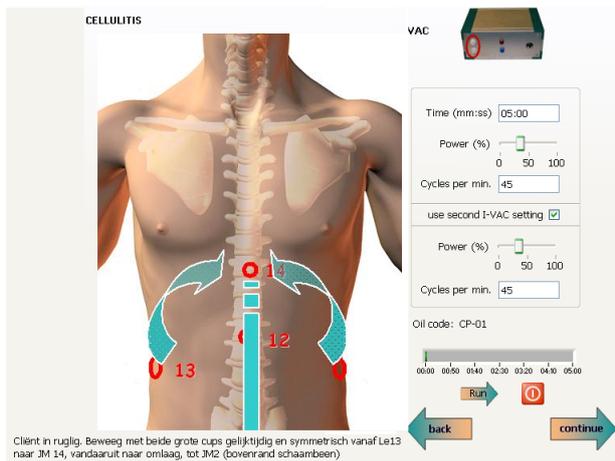

### ZELLULITE:


- **Bauchbehandlung mit dem I-VAC**
- **Klient in Rückenlage**
- **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm**
- **Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den "run"-Pfeil**
- **Saugkraft und Pulsation sind programmiert**
- **Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um weiterzukommen**

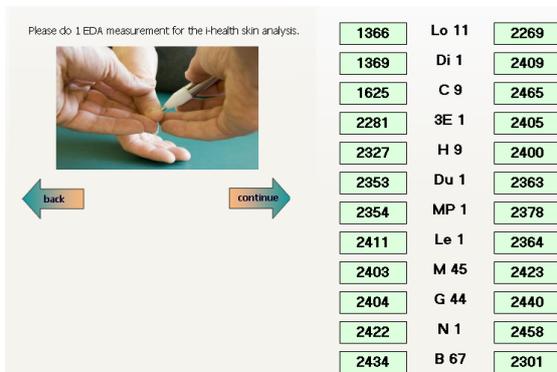

### NEUE EDA-MESSUNG

- **Für die abschließende Konsolidierungsphase ist eine neue EDA-Messung notwendig**
- **Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm**

## 5.6.5 ZELLULITEPROGRAMM: KONSOLIDIERUNG MIT DEM ROTEN BEAMER

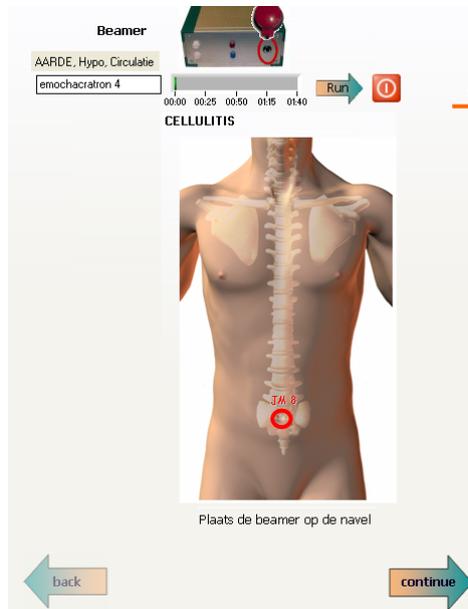

### KONSOLIDIERUNGSPHASE

- Klient in Rückenlage
- Passend zum aktuellen Energiemangel im Konstitutionselement Erde wählt das Programm in diesem Beispiel automatisch das Raymedy Emochacratron 4, welches Energie aus dem Feuelement zuführt
- Halten Sie den roten Beamer auf den Nabel und aktivieren Sie das Raymedy mit Klick auf den "run"-Pfeil

Nach Beendigung der Konsolidierungsphase wird mit einem Klick auf den "continue"-Pfeil das Zelluliteprogramm geschlossen:

Protocoll is finished.

### Das CELLULITE-PROGRAMM Milz-Pankreas/Magen und Niere/Blase


1. 8-minütige Bestrahlung der Problemzonen mit der Infrarot-Lampe
2. 3 EDA-Messungen
3. Lymphdrainage nach Protokoll
4. Auftragen von Restorate auf die Problemzonen der Vorder-oder der Rückseite von einem Bein
5. Weißes Licht mit dem i-LIGHT
6. Acidiatron mit dem Dermaroller des i-ON
7. Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2), Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion werden nicht entfernt.
8. Auftragen von Aloe+Restorate auf die Problemzonen von Vorder- oder Rückseite des anderen Beines
9. Weißes Licht mit dem i-LIGHT
10. Acidiatron mit dem Dermaroller des i-ON
11. Entfernung der Aloe-Restorate-Rückstände und Auftragen von Aloe + CC-Cell-Lotion (Verhältnis 1:2), Weiterbehandlung mit dem i-ON. Die Reste von Aloe + CC-Cell-Lotion werden nicht entfernt
12. Reinigen Sie das zuerst behandelte Bein mit einem heißen Handtuch.
13. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
14. Reinigen Sie das zweite behandelte Bein mit einem heißen Handtuch.
15. I-VAC nach Protokoll mit Mandelöl und Fünf-Elemente-Komplex
16. Entfernen Sie die Mandelölmischung von beiden Beinen
17. i-Light gemäß Protokoll

18. Lymphdrainage des Abdomens
19. EDA –Messung
20. Emochakraton mit dem Beamer

## 5.7 SPEZIELLE LÖSUNGEN

Programme für einige spezielle Haut- und Schönheitsprobleme sind in Vorbereitung. Diese Kapitel beinhaltet ein typisches „Demo-Protokoll“, das der Kosmetikerin erlaubt, Interessenten und neue Klienten mit sämtlichen Inhalten des EnergySkinCare-Moduls vertraut zu machen.


### 5.7.1 DEMO-PROGRAMM RÜCKENBEHANDLUNG MIT DEM I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

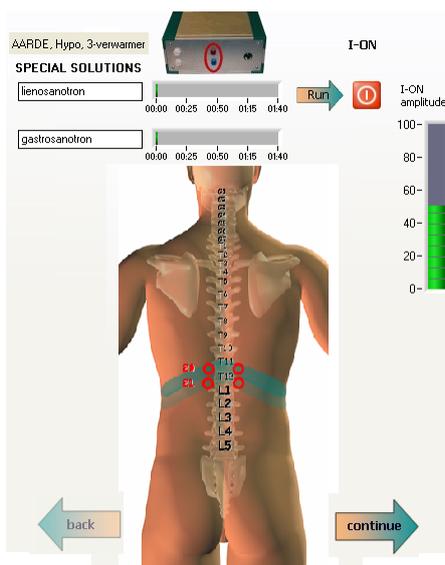

Beweg mit de dermaroller vanuit het midden naar links en rechts

#### DEMO-PROGRAMM: i-ON Rücken-Behandlung


- Passen Sie die Stromamplitude an
- Klicken Sie auf den “run”-Pfeil um das i-ON zu aktivieren
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Klicken Sie auf den “continue”-Pfeil um zum nächsten Schritt zu kommen

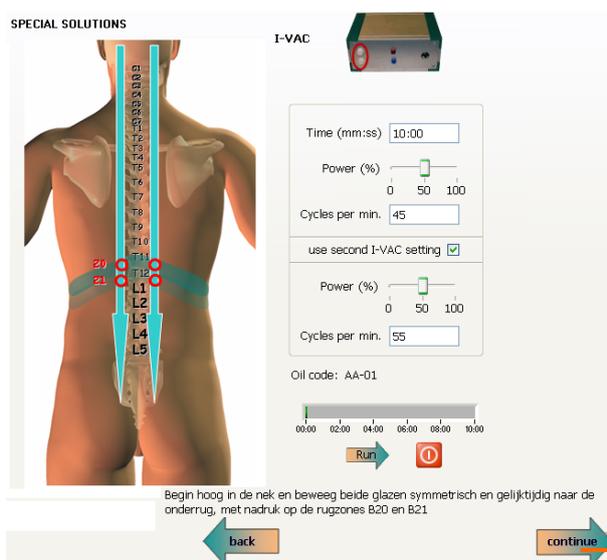

Begin hoog in de nek en beweeg beide glazen symmetrisch en gelijktijdig naar de onderrug, met nadruk op de rugzones B20 en B21

#### DEMO-PROGRAMM: i-VAC Rücken-Behandlung


- Klient in Bauchlage
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Aktivieren Sie das i-VAC mit Klick auf den “run”-Pfeil
- Saugkraft und Pulsationen sind programmiert
- Wenn Sie mit dem i-VAC fertig sind, klicken Sie den “continue”-Pfeil um weiterzugehen

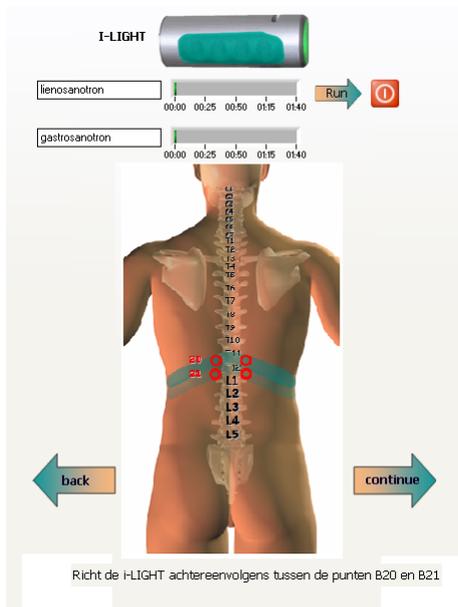

### DEMO-PROGRAMM: i-LIGHT RÜCKENBEHANDLUNG

- Klicken Sie auf den "run"-Pfeil, um das i-LIGHT zu aktivieren
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Mit Klick auf den "continue"-Pfeil gehen Sie zum nächsten Schritt

Please do 1 EDA measurement for the iHealth skin analysis.

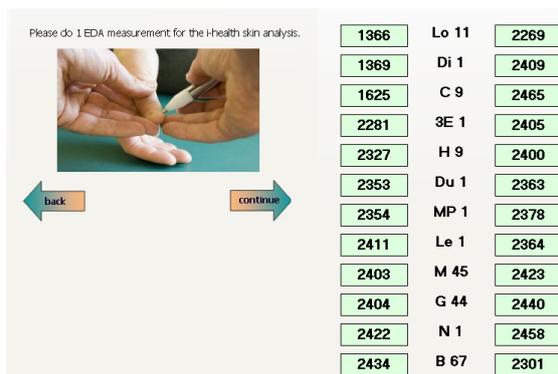

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301


### NEUE EDA-MESSUNG

- Für die nächste Phase, die Gesichtsbehandlung, ist eine weitere EDA-Messung notwendig
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu kommen


## 5.7.2 DEMOPROGRAMM GESICHTSBEHANDLUNG MIT I-ON, I-VAC UND I-LIGHT

Bereiten Sie zwei Mischungen vor: eine Aloe-Restorate-Mixtur und eine aus Aloe + Q10 + Rebuild25.

Reinigen Sie das Gesicht mit Rosenwasser. Tragen Sie eine Maske aus Aloe und Restorate auf und bestrahlen Sie das Gesicht mit weißem Licht. Bitten Sie den Klienten, während dieser Bestrahlung die Augen zu schließen.

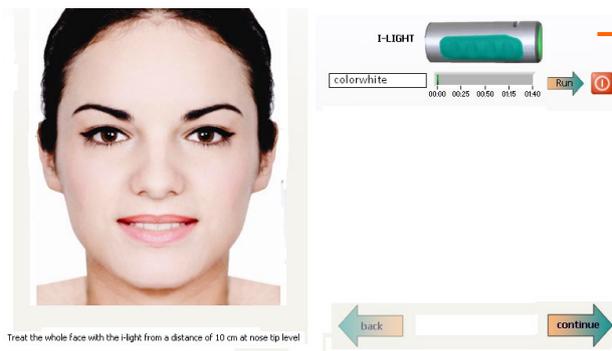

- i-ON Vorbehandlung mit i-LIGHT WEISS
- Klient in Rückenlage mit geschlossenen Augen
- Reinigen Sie zuerst das Gesicht mit Rosenwasser
- Tragen Sie der Aloe+Restoratemischung auf Gesicht und Hals auf
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus 10 cm Abstand auf das Gesicht
- Mit Klick auf "run" aktivieren Sie das i-LIGHT

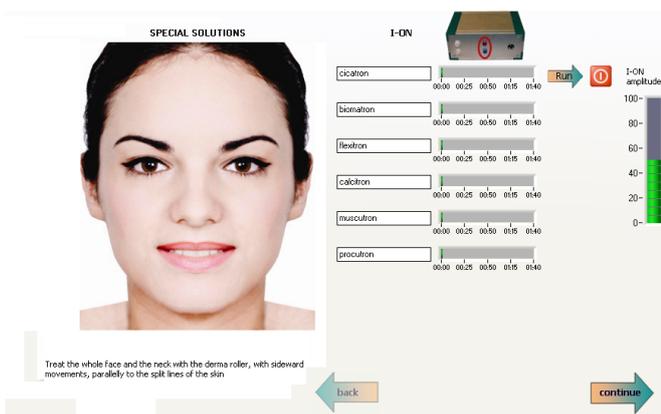


### DEMO-PROGRAMM: i-ON GESICHTSBEHANDLUNG

- Stellen Sie die Amplitude knapp unter dem sensiblen Niveau ein
- Aktivieren Sie die ersten 2 Raymedys mit Klick auf den "run" -Pfeil
- Behandeln Sie die angegebenen Hautzonen mit dem Derrmaroller
- Entfernen Sie die Rückstände der Maske, tragen Sie die Aloe-Q10-Rebuild 25-Mischung auf und fahren Sie fort mit dem Protokoll
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu gehen

AARDE, Normal, Circulatie

SPECIAL SOLUTIONS

I-VAC

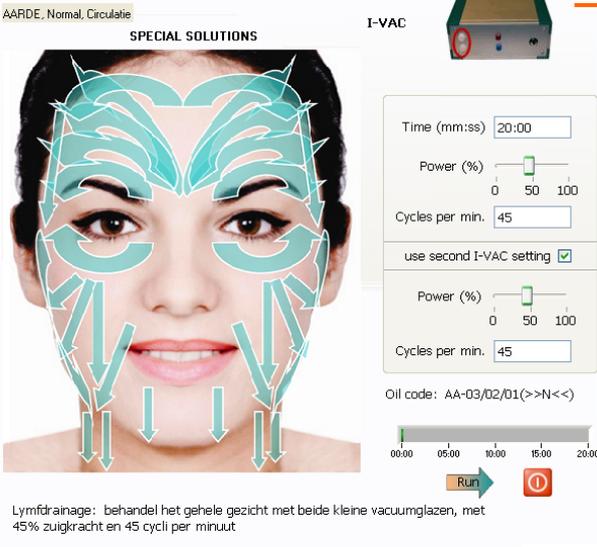

Time (mm:ss) 20:00

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

use second I-VAC setting

Power (%) 0 50 100

Cycles per min. 45

Oil code: AA-03/02/01 (>>N<<)

00:00 05:00 10:00 15:00 20:00

Run

Lympfdrainage: behandel het gehele gezicht met beide kleine vacuümglazen, met 45% zuigkracht en 45 cycli per minuut


back continue

### DEMO-PROGRAMM: i-VAC Gesichtsbehandlung

- Klient in Rückenlage
- Entfernen Sie das verblieben Kontaktgel und mischen Sie das Mandelöl mit dem Elementeöl-Komplex wie auf dem Bildschirm angezeigt
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- Klicken Sie auf den "continue"-Pfeil um zum nächsten Schritt zu gehen

SPECIAL SOLUTIONS

I-LIGHT

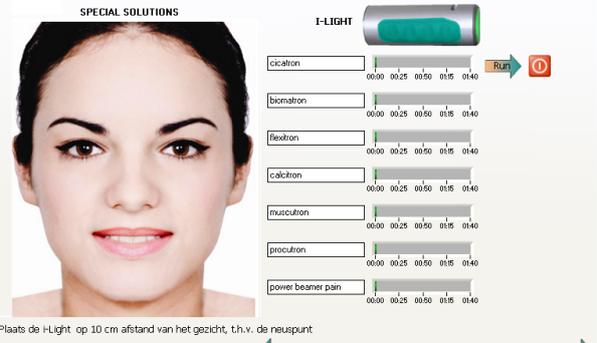

calcitron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

biomatron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

flexitron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

calchiron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

muscutron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

procutron 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

power beamer pain 00:00 00:25 00:50 01:15 01:40

Run

Plaats de i-Light op 10 cm afstand van het gezicht, t.h.v. de neuspunt

back continue

### DEMO-PROGRAMM: i-LIGHT Gesichtsbehandlung

- Klient in Rückenlage
- Entfernen Sie die Ölreste und aktivieren Sie die Raymedys mit Klick auf den "run"-Pfeil neben den Raymedys auf dem Bildschirm
- Richten Sie das i-LIGHT auf Höhe der Nasenspitze aus ca 10 cm Distanz auf das Gesicht
- Klicken Sie auf den „continue“-Pfeil, um zum nächsten Schritt zu kommen

Please do 1 EDA measurement for the i-health skin analysis.



back continue

1366	Lo 11	2269
1369	Di 1	2409
1625	C 9	2465
2281	3E 1	2405
2327	H 9	2400
2353	Du 1	2363
2354	MP 1	2378
2411	Le 1	2364
2403	M 45	2423
2404	G 44	2440
2422	N 1	2458
2434	B 67	2301

### NEUE EDA-MESSUNG

Eine nächste EDA-Messung ist notwendig für die Konsolidierung

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm  
Dann klicken Sie auf "continue", um weiterzukommen

### 5.7.3 D MIT DE

### KONSOLIDIERUNG

- Klient in Rückenlage

Entsprechend dem in diesem Beispiel gegebenen Energieüberschuss im Erde-Element hat das Programm automatisch das Raymedy Emochacratron 5: Ableitung des Energieüberschusses an des Element Metall

- Halten Sie den roten Beamer auf dne Nabel und aktivieren Sie das Raymedy durch Klick auf den "run"-Pfeil

AARDE: Hyper, Dikke darm

emochacratron 5

0:25 00:50 01:15 01:40 Run

SOLUTIONS



Plaats de rode beamer op de navel

back continue

Mit Klick auf den "continue"-Pfeil schließt sich dieses Demo-Programm. Sie lesen:

Protocoll is finished.