



RAYMEDY OPLEIDINGEN

Handleiding Meridiaandiagnose





Handleiding Meridiaandiagnose (Software V7)

Deze handleiding hoort bij het Seminar programma met de volgende onderdelen:

De Techniek:

De software, het gebruik van de help-functie en de menu's.

Maken van back-ups: verzorgen van je bedrijfskapitaal.

De licentie, hoe te installeren en waarvoor de licentie is.

Zorgenvrij werken met de hardware: waar moet je op letten.

Oefening

De eerste stap in de praktijk:

De patientgegevens invoeren en een consult starten

De meridiaan-meting: alle ins and outs.

Volgens protocol en met provocatie.

Oefening in het meten en het bekijken van de grafieken.

Achtergrond en basiskennis:

Wat is een meridiaan, hoe kan ik me daar een voorstelling van maken.

Energie-vormen en een energetisch model van de mens.

De energie die zoals we die met het Raymedy systeem meten

De grafieken: welke informatie kan ik daar uit aflezen ?

Interpretatie van een aantal voorbeeldgevallen.

Grafieken interpreteren van je eigen cliënten.

De Techniek:

De software, het gebruik van de help-functie en de menu's.




Installatie van de software: U ontvangt de link om de Raymedy Software te downloaden via de e-mail. Na het downloaden staat de file in de map 'downloads'. Wanneer u 2x op deze file klikt dan wordt de software geïnstalleerd. Zodra deze is geïnstalleerd staat de snelkoppeling waarmee de software gestart wordt op het bureaublad.

Starten van de Help functie, de zoekfunctie en het gebruik van de 3D afb.

De help-functie kan op twee manieren gestart worden:

1. Gebruik de functie-knop 'F1' in de bovenste rij op je toetsenbord. Dan wordt de pagina in de Help-functie geopend die aansluit bij je onderwerp. In het rechtervenster werd op F1 geklikt terwijl het scherm 'consult geopend was'. De Help-pagina verschijnt die betrekking heeft op het beheren van je consulten en metingen.
2. Klik in een grafiek op de afkorting van de naam van de meridiaan. Na het klikken op het rode vlakje H9 werd de 3D afbeelding van de hart-meridiaan geopend en de beginpagina met informatie over de hartmeridiaan.

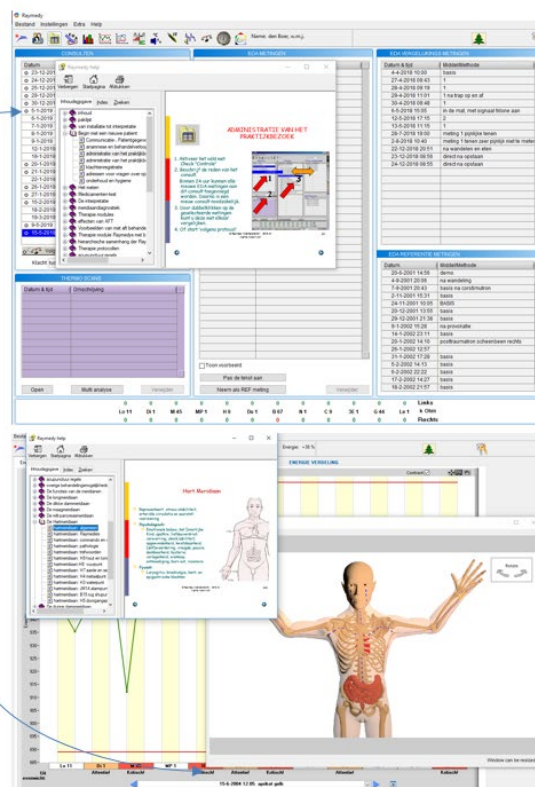

Er zijn 3 mogelijkheden om informatie te zoeken.

- De functietoets 'F1'. Daarmee wordt de Help-pagina geopend.
- Wanneer u klikt op de meridiaan-naam op de onderste balk van een grafiek met overzicht van de 12 meridiaan-paren.



- Wanneer je waar je naar zoekt invult in de pagina van de raymedy's :

Zoek naar deze woorden in de beschrijving van de raymedys:

bloedarmoede

Gevonden Raymedys:

Vitatron Vitamin B 8	Vitatron Vitamin B 12
Vitatron Phosphor	Vitatron Iron / Eisen
Vitatron Lysine	

Signaal duur (mm:ss) 02:00 INFO PLAY: PC Raycer

De helpfunctie: inhoudsopgave

De inhoudsopgave van de helpfunctie staat in de linker-kolom.

Als je klikt op het +-tekening dan wordt de inhoud van dat hoofdstuk geopend.

In dit voorbeeld is op het +-teken van de regel 'Het meten' geklikt.

Opmerking: de hoofdstukken inhoud t.m. het meten zijn gedateerd.

Raymedy help

Verbergen Startpagina Afdrukken

Inhoudsopgave Index Zoeken

- Inhoud
- paklijst
- van installatie tot interpretatie
- Begin met een nieuwe patient
- Het meten
- Medicamenten-test
- De interpretatie
- meridiaandagnostiek
- Therapie modules
- effecten van AFT
- Voorbeelden van met aft behandelde
- Therapie module Raymedys met bear
- hierarchische samenhang der Raymex
- Therapie protocollen


Inhoudsopgave Index Zoeken

- Inhoud
- paklijst
- van installatie tot interpretatie
- Begin met een nieuwe patient
- Het meten
 - de meting van de huidweerstand
 - de meting van de huidweerstand
 - de meting van de huidweerstand
 - provoceren en vergelijken van me
 - provocatie (voortzetting)
 - de meting van de huidweerstand
 - de meting van de huidweerstand
 - Het maken van een eigen testpro

De Help Functie: het zoeken en de 'wildcard'

De trefkans dat je vindt wat je zoekt neemt erg toe door het gebruik van het teken asterisk '*'.

Wanneer je bijvoorbeeld hart* intypt dan krijg je de lijst met alle dia's waar het woord hart gebruikt is, maar ook hartmeridiaan, hartkloppingen, hart- en vaatziekten, hart-energie.

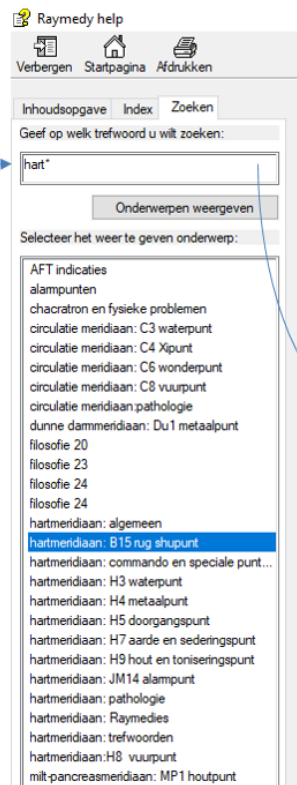

Trefwoorden:

Emotioneel evenwicht

Problemen met verstandskiezen

Hart-Vaatziekten

Panisch, opgewonden, verward, slapeloos

Maag- en darmzweren, peristaltische problemen


De zoekfunctie in de Raymedy informatie

We hebben voor de Raymedys de indicaties, de werkingen en acupunctuurpunten zo goed mogelijk beschreven.

Na het aanklikken van een Raymedy verschijnt deze indicaties, werkingen en behandelpunten wanneer het vakje 'tonen' is aangevinkt.

In de lange lijst raymedys kan je direct naar een raymedy toe springen, zonder lang in de lijst te scrollen door de naam van de raymedy in te vullen in de regel 'zoek naar deze woorden in de raymedys'. In deze regel kan je ook diagnoses en klachten invullen en de raymedys waarvan dit woord in de beschrijving bevatten worden allemaal getoond.

Wanneer je dan klikt op zo'n raymedy naam dan spring je in de lijst naar deze Raymedy. Je moet er dan op klikken zodat deze blauw wordt en dan kan je deze afspelen.

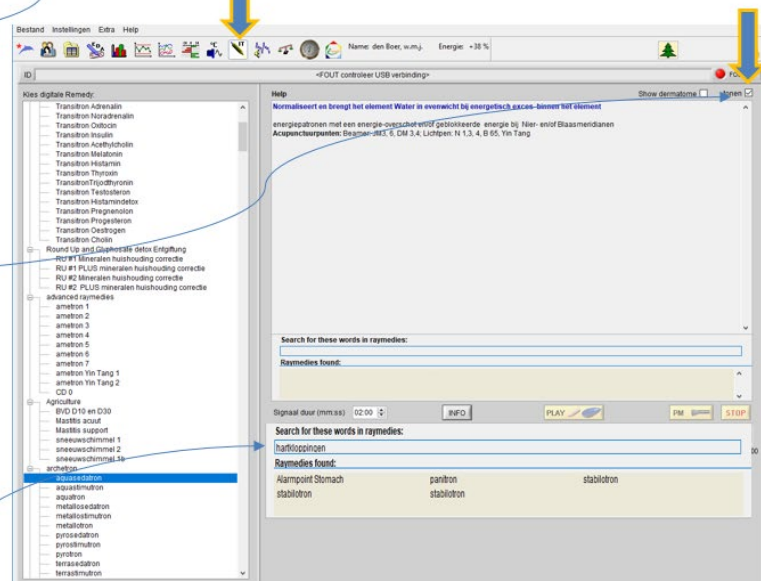

De menu's die je **moet** gebruiken: Instellingen

Algemene Instellingen: vergrendelen van de software zodat de patientengegevens niet door derden kunnen worden ingezien: typ een wachtwoord in en stel in na hoeveel minuten u je wilt dat het systeem vergrendeld wordt.

Hier kan je ook de pieptoon van de meting instellen.

Bestand Instellingen Extra Help

ALGEMENE INSTELLINGEN

Taal - Sprache - Language
Langue - Lisan Nederlands

Taal type Traditional

Programma wachtwoord

Typ wachtwoord opnieuw

Vergrendel programma timer 30 (min)

EDA beep volume 0 20 40 60 80 100

OK Annuleer

Voor de communicatie met de Raymedy server ontvang je een wachtwoord. Dit wachtwoord moet je in de onderste regel invullen. Je kunt dan thuisbehandelplannen naar je patienten versturen.

PRAKTIJK GEGEVENS

Voornaam Willem Maurits *

Achternaam den Boer *

Bedrijf of organisatie (+info) Raymedy International B.V.

arts/coach... instructor

Geb. datum & gesl. 20/04/1952 Man *

Straat & nummer Apeldoornseweg 47 *

Postcode & plaats 6814 BJ Arnhem *

Land Nederland *

Tel. +31 264427706 *

Fax.

e-mail maukdenboer@raymedy.com

Web account password ***** Show

Test account

* velden moeten ingevuld worden.

OK Verwijder gebruiker Annuleer

De menu's die je moet gebruiken: Instellingen


Via de knop 'licentie' kom je eerst op het instellen van de draadloze verbinding.

Voor gebruikers van software Versie 7 is de communicatie met de PowerMe en de ReadMe van belang.

Klik eerst op het apparaat, zet dit aan en het unieke identificatie-adres van het apparaat verschijnt.

Klik hier met de linkermuisknop op tot het vakje links is aangevinkt. Dan wordt dit in het geheugen opgeslagen en uw software communiceert met de PowerMe of de ReadMe.

Voor de i-light, de oranje meetstift en de i-Vac (Skin Care systeem) gelden andere instructies. Deze worden vanzelf zichtbaar.

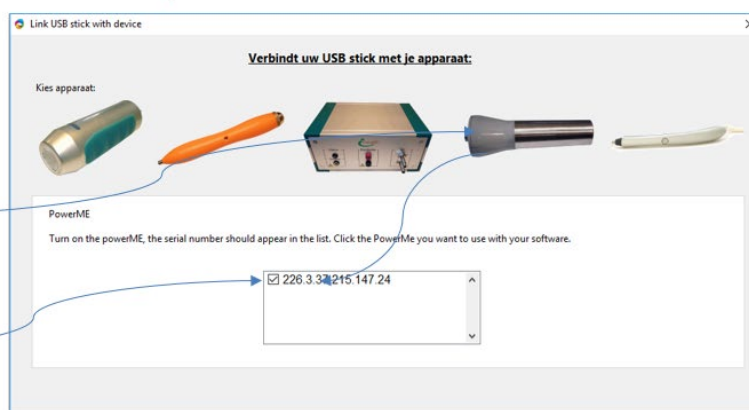


Menu instellingen: licentie

Om de software te kunnen gebruiken is een elektronische licentie nodig.

Deze wordt ieder kwartaal automatisch op de server geplaatst. Een paar dagen voordat de licentieperiode is afgelopen verschijnt er een waarschuwing.

Wij zorgen voor tijdige plaatsing van de licentie op de server. Door de licentie worden de modules geactiveerd conform de met jou gesloten overeenkomst.

Om de licentie van de server af te kunnen halen moet het apparaat met je computer verbonden zijn en ingeschakeld zijn. De firewall moet uitgeschakeld zijn, want deze kan beletten dat de verbinding met onze server tot stand komt. Gebruik de knop 'automatisch downloaden'.

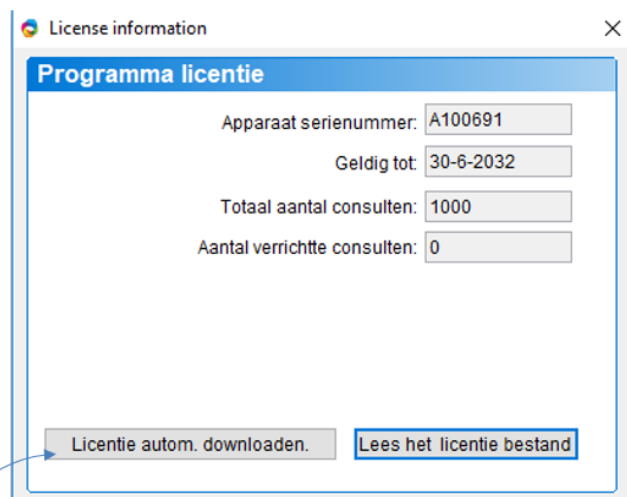

Instellingen: Back-up van je data

We raden je dringend aan om regelmatig een back-up van je data te maken !



Het is niet de vraag of je systeem het een keer begeeft, maar uitsluitend wanneer dat gebeurt. Iedere harde schijf raakt een keer defect.

Sla daarom je back-up data op een externe harde schijf op, op een USB-stick of een SSD-kaart !

Wanneer je data verloren zijn gegaan dan kunnen we je niet helpen en dan is waardevol materiaal voorgoed verdwenen.


Dus:

breng de discipline op om dit goed te doen.

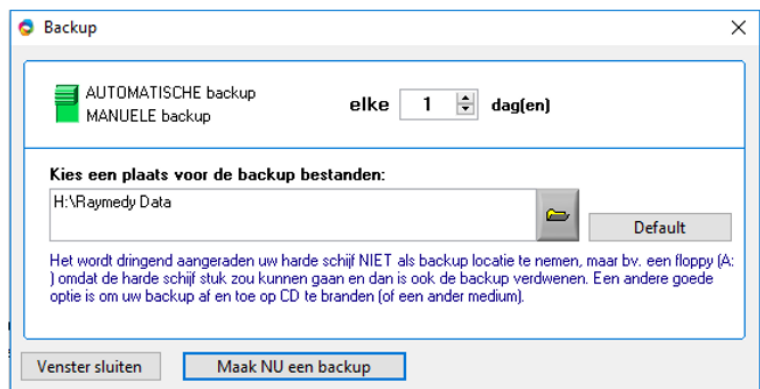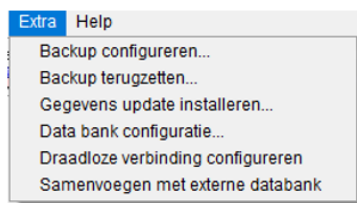



Navigeren door de Raymedy Software V7.

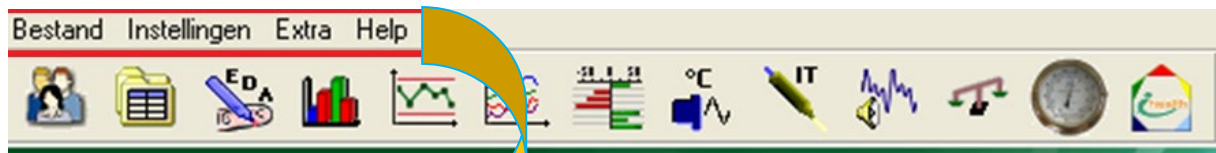


Via de taakbalk kan je alle schermen en functies vinden.


Bestand: print opties



Instellingen: taal, licentie en wellness toepassingen



Extra : backup instellen, updates installeren, draadloze verbinding

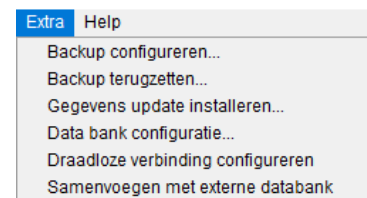


Help: Helpfunctie, systeem informatie







De knoppen op de Menubalk:

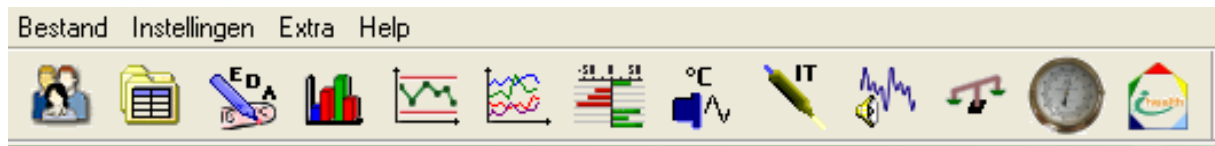

Wat zit onder welke knop?

	Patiënt gegevens		Testresultaten en submenu's Meta-analyse
	Persoonlijk consult gegevens		Raymedy's voor Lichtstift
	Huidweerstandmetingen (EDA)		Raymedy's voor Beamer
	Regulerende capaciteit		Wellness
	Energie verdeling> >Energieverdeling >Symmetrie >Meta-analyse		raymedy plan, zend casus, protocollen
	Therapie assessment		thermografiemodule AFT/ Raymedy/ Zap-scan



Gegevens van Patienten.

		Gegevens	Lokaal ☒	Import ☐		GEGEVENS VAN PATIENTEN
--	--	-----------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------

Er zijn 3 sets data van patienten:

- Lokaal** ☐ Hier vindt je jouw patienten en al hun gegevens. Dit is de default instelling.
- Import** ☐ Wanneer een collega u metingen van een patient doorstuurt en je importeert deze gegevens dan vindt je die in de 'import-data'. Deze gegevens zijn geanonimiseerd, dus zonder naam en adres.
- Deze knop geeft toegang tot de voor iedere Raymedy therapeut toegankelijke casuïstiek.

Zoeken (achternaam)

Gegevens
 Voornaam
 Achternaam
Geb. datum **leeftijd**
Geslacht
Straat & nummer
Postcode & plaats
Land
 Tel.
Fax.
E-Mail
Use casuistry ☒
AFT-frequentie
Anamnese
Opmerkingen

Gegevens van een nieuwe patient invullen:

Nieuwe patienten kunnen worden toegevoegd als je op de knop

links onder klikt:



Wanneer je klikt op dan opent het venster waarin je de anamnese/ziektegeschiedenis kunt opschrijven en in het veld opmerkingen is plaats voor het beschrijven van de behandelingen, ervaringen van de patient van behandeling tot behandeling. In deze velden kunnen onbeperkt opmerkingen worden toegevoegd. Wanneer je van je data regelmatig een back-up maakt op een externe server, harddiskhoef of memory stick dan hoef je niet bang te zijn dat je gegevens kwijt raakt.


Gezondheidsformulier

Het gezondheidsformulier vindt je onderaan het scherm dat de gegevens laat zien van de patient:


Stap 1.



Stap 2.

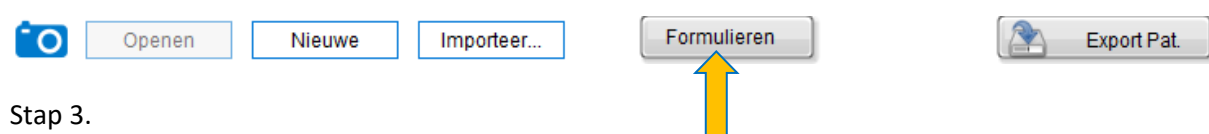

Stap 3.

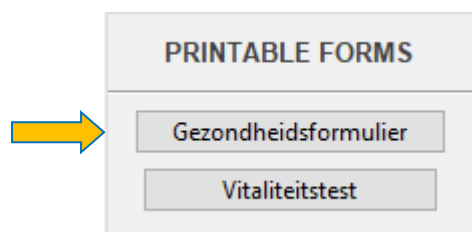

Een grondige en systematische anamnese *is nodig en is de eerste en noodzakelijke stap. De klachten vormen het uitgangspunt voor de behandeling. De gegevens van het gezondheidsformulier en kennis van de persoonlijke omstandigheden, ziektegeschiedenis, en de metingen vormen als het ware een geheel.*

Om e.e.a. overzichtelijk te houden hebben we een anamnese-formulier ontwikkeld. Daarin staan in een aantal groepen of rubrieken aandoeningen vermeld, gekoppeld aan meridiaanfuncties. Je kunt dit formulier aan je patient mailen met het verzoek dit vóór het consult in te vullen en mee te nemen.

We hebben gekozen voor een indeling, waardoor de klachten zo goed mogelijk met zowel de metingen in verband gebracht kunnen worden als ook met wat regulier-medisch gebruikelijk is en voor patiënten herkenbaar is. Dat een aantal klachten elkaar in diverse rubrieken overlappen, is helaas onvermijdelijk. Het anamneseformulier is digitaal beschikbaar door onderin het patientgegevens-

scherm op de knop “formulieren” te drukken. Onder die knop vindt u ook het Vitality life style testformulier. Het maken van formulieren is een wetenschap op zich en er zijn vele goede mogelijkheden. Vanzelfsprekend kan je je eigen formulier gebruiken.

Het volgen van de verbetering in de ernstig(st)e klachten is om meer dan één

reden belangrijk. Wanneer je de ernstigste klachten kunt terugvinden of verklaren met afwijkingen in de metingen van de normen, dan heb je de focus van de behandelingen te pakken en dan kan je vervolgens bepalen hoe je deze gaat helpen oplossen. Op de tweede plaats vergeten de meeste patienten de klachten die ze hadden en concentreren ze zich op de klachten die er nog zijn. Het blijkt voor de tevredenheid met de therapie belangrijk te zijn dat je kunt laten zien dat er vooruitgang in zit ! We raden daarom aan om vanaf het begin de belangrijkste klachten door de patient te laten scoren en dat aan het begin van ieder consult te herhalen. Het is voldoende om dat bij max. 5 klachten te doen. Wanneer de patient het formulier thuis al invult, dan scheelt dat tijd. De klachten die op het formulier staan zijn vanzelfsprekende niet de enig mogelijke. Je kunt in het  formulier dat geopend wordt wanneer je op 'paneel' klikt naar believen klachten toevoegen die niet in het formulier voorkomen. Wanneer je dit formulier gebruikt dan wordt er een grafiek gemaakt van het klachtenverloop.

Anamnese + Opmerkingen (keuze van scans, testmiddel, therapie, resultaat):

Anamnese datum invoegen

14-10-2018: Al een paar jaar vermoeid. Regelmatig hypoglycemie. Verzuurd, kuit en knie blessure door val met hardlopen, linker enkel verstuikt, rechter knie botkneuzing, laatste restje wil niet weg, houdt hog spierspanning in de benen (testen van magnesium, bicarbonaat).
18-11-2018: kuitblessure weg na eerste behandeling opgelost, spierspanning minder erg.

Opmerkingen (keuze van scans, testmiddel, therapie, resultaat) datum invoegen

14-10-2018: blessures met traumatron behandeld. Pijn trok weg en zwelling van de enkel werd minder. Ze heeft een ontgiftingsprobleem: De levermeridiaan is geblokkeerd en zwak en de MP is zwak. Afgaand op de klachten is de pH waarschijnlijk te laag. Aanpak overgewicht noodzakelijk. Ze maakt zich zorgen over haar partner vanwege de zeer extreme duursport. Nodig: voedingsadvies, pH correctie. Ontgiften van de lever.

Cases

Date	Closed	Web	Name
18-2-2019		x	Sportverletzung

Complaints & degree (0..10) Consults in this case Select dashboard

Complaints	GRAAD	
	18-2-2019	4-7-2019
38 Spierkrampen, erger bij oefening	6	0
sportblessure	7	2

Dubbelklik in tabel om klacht niveau toe te voegen. Dubbelklik op de datum kolom om deze te verwijderen.

Ontwikkeling

Diagnose: Burn Out

Wanneer je in dit formulier op een lege regel klikt onder het woord 'complaints/klachten' dan opent een nieuw formulier met de nummering van de klachten zoals deze in het formulier staan. Als je het nummer intypt van een ernstige klacht in de regel waarin nu als voorbeeld sportblessure staat dan verschijnt deze klacht in de lijst met klachten (na dubbelklikken) .

In de loop van deze seminars zullen we ingaan op het belang van het uitwisselen van ervaringen, behandelresultaten en gegevens. Wanneer we allemaal bijdragen aan de opbouw van een database met interessante behandelresultaten, dan hebben we daar individueel ook veel profijt van !

Wanneer je deze stappen tot je routine maakt, dan is het belangrijkste deel van de bijdrage aan de casuïstiek al gedaan. Na afloop van de behandelingen hoef je deze dan alleen nog kort samen te vatten.

Kies klachten:

- Weerstandfuncties**
 - 145 Keel infecties
 - 146 Slechte wondgenezing
 - 147 Slecht herstel van kou/griep
 - 148 Regelmatig zweren/cysten
 - 149 Gezwollen lymfklieren
 - 150 Gevoelig voor griep en kou vatten
 - 151 Bobbelige huid op de achterkant van de ar
 - 152 Ontstoken/bloedend tandvlees
 - 153 Chronische volte in de longen
 - 154 Waterige afscheiding van de neus
 - 155 Meestal ademen door de mond
 - 156 Gezwollen tong
 - 157 Hyperactiviteit
 - 158 Voedselintolerantie / allergie
- Operaties/ziekenhuisopname**
 - Amandelen geknipt
 - Blinde darm operatie
 - Galblaas operatie
 - Baarmoeder operatie
 - Sterilisatie
 - Ongevallen
 - Hernia operatie rug
 - Hernia operatie liezen
 - Keizersnede
 - Andere operaties
 - Abortus/ miskramen
- Tandheelkundige ingrepen**
 - Getrokken kiezen bovenkaak
 - Idem onderkaak

U kunt ook dubbelklikken om toe te voegen.

Voeg klachten toe

Verander geselecteerde klachten

Controleer op updates...

Selecteer de klachten in de linker boom, of u kunt onderstaande woorden om te zoeken naar typen.

U kunt ook een tekst typen en op de knop hieronder klikken.

sportblessure

Als klacht toevoegen

Zoek resultaten:

Mijn lijst met klachten (max 6):

Opmerking: tekst in de cellen bewerkbaar is door in de tekst erop te

38 Spierkrampen, erger bij oefeningen en beweging
sportblessure

verwijder gekozen regel

Sla op en sluit af

Niet opslaan

Het gezondheidsformulier is in groepen onderverdeeld. Voor iedere groep geven we aanbevelingen voor ortomoleculaire middelen die in aanmerking komen voor het behandelen van de klachten uit die groep. Deze middelen kunnen dankzij de gevoeligheid van ons lichaam voor de velden die iedere stof omgeven heel goed worden uitgetest. Dat is één van de onderwerpen van deze handleiding.

GROEP A: Algemene overactiviteit:

overheersing sympathische zenuwstelsel (Sympathicotonie)

Klachtenpatroon: overactiviteit, altijd haast, slapeloosheid; klachten kunnen verergeren door emotionele stress


Yang meridianen overheersen

GEVAAR VAN ACIDOSIS. TE TESTEN MIDDELEN:

Magnesium, Alkaliserende mineralen, Kalium, alfalfa, kelp, gerst (*Hordeum vulgare*)

GROEP B: Algemene onderactiviteit:

De klachten van Groep B vertonen het tegenovergestelde beeld: Overheersing van de Yin-meridianen, overstemmend met verhoudingsgewijze overactiviteit van het Parasympathische zenuwstelsel. De klachten lijken veel op burnout-verschijnselen.

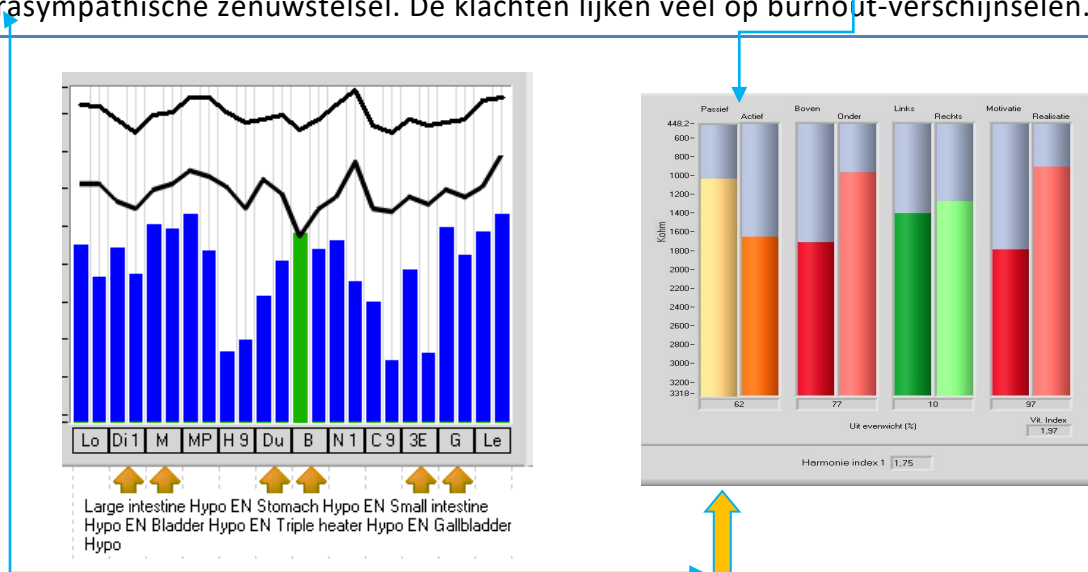

overheersing parasympathische zenuwstelsel (Vagotonie)

Klachtenpatroon: onderactiviteit, lage bloeddruk, verlaagde stofwisseling en vertering) symptomen kunnen verergeren door lichamelijke stress.

Yin meridianen overheersen


Gevaar van alkalose en neiging tot arthrose.

Te testen middelen: Calcium, Vit.B-complex, Vit C, D, en F, Urtica dioica

GROEP C; Koolhydraat-stofwisseling, te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie)

In Groep C staan ontgiftings vragen centraal, tgv exogene en endogene toxinen en koolhydraatstofwisselingsproblemen centraal, wat overeenkomt met stoornissen van de Milt-Pancreas-, Maag-, Drieverwarmer- en Levermeridiaan en de daarbij behorende klachten, die vooral te maken hebben met een te lage of te snel wisselende bloedsuikerspiegel.

Milt-pancreas/Maag- , Drie Verwarmer- en Levermeridianen Te testen middelen: GTF Chromium, Vit B-complex, Choline, Gember, Gymnema sylvestre, Inositol, Kalium, Magnesium, Niacine, Thiamine, Vanadium, Zink

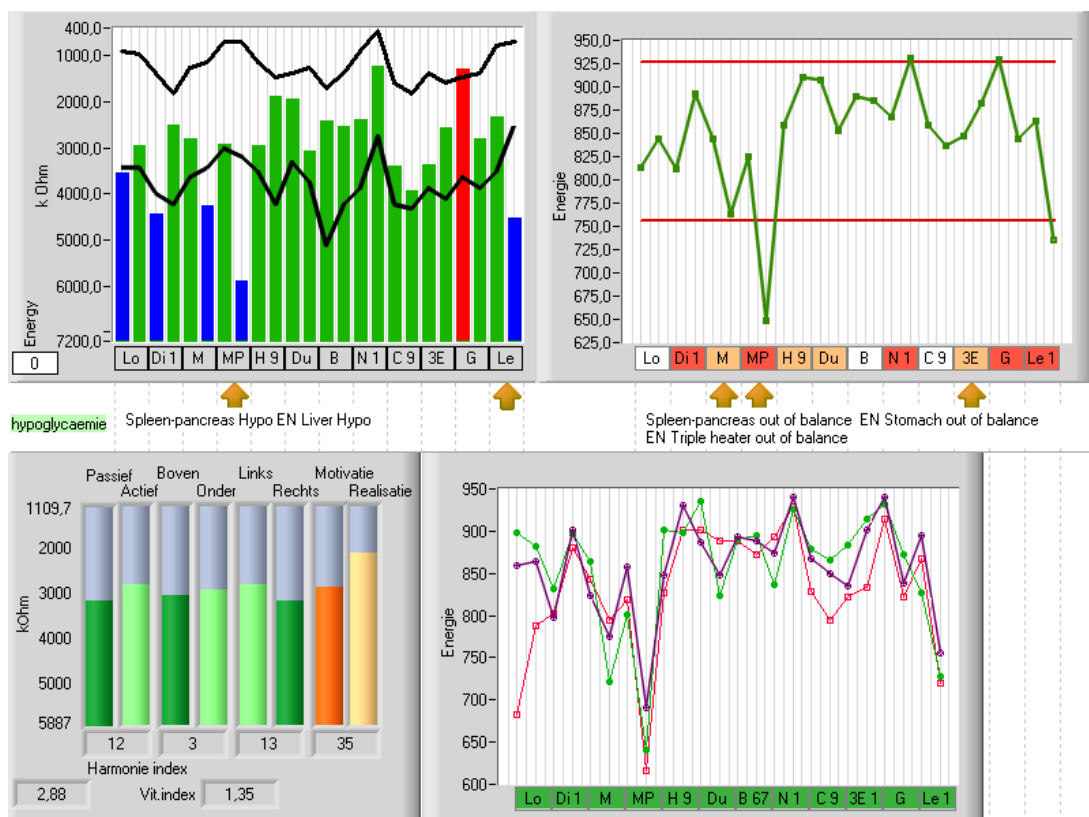



GROEP D: Hart, bloedvaten en circulatie

Groep D gaat over hart-, bloedvaten- en circulatieklachten, wat voornamelijk het domein is van de Vuurmeridianen, behalve die van de Dunne darmmeridiaan.

Hart-, Circulatie-, 3 Verwarmer meridianen.

Te testen middelen: B-plex, Chroom, B, 2Co Q10, Crataegus, Kalium, Magnesium, Thiamine, Niacine, vitamine E, Selenium, Pijnboomschorsextract, Zink

GROEP E: Leverfunctiestoornissen

Groep E gaat over klachten, samenhangend met problemen met de Eiwit-en Vetstofwisseling, en ontgiftingsproblemen gerelateerd aan resp. de Lever- en Galblaasmeridiaan.

Lever- Galblaas meridianen

Te testen middelen: vit B, Carduus Marianus, CoQ10, Taraxacum (Paardebloem), Pijnboomschorsextract

GROEP F: Gastro-intestinale functiestoornissen

Groep F vat alle maag-darmstoornissen samen, behorend bij maag-, milt-pancras- en dunne darmmeridiaan.

Maag-, Milt-pancreas-, Dunne darm, Lever meridianen

Te testen middelen: artemisia absinthium, enzymen, gentiaan, sambucus nigra, zink

GROEP G: Schildklierfunctiestoornissen

Groep G noemt de belangrijkste klachten van de schildklier, de hypofyse en de bijniere, in zowel overactieve als onderactieve toestand, met de daaraan gerelateerde meridianen.

Meridianen; hart, 3 E, Circulatie, M, MP

Te testen middelen: Kalium, Magnesium, Zink, EPA, DHA, GLA, glandulars, Jodium, Magnesium, Selenium, Zink, L-Tyrosine, zware metalen ontgifters



GROEP H: Hypofysectoornissen

De klachten genoemd onder Hypofysectoornissen behoren bij de meridianen 3 Verwarmer, Milt-Pancreas en Circulatie.

3 Verwarmer-, Circulatie-, MP meridianen

Te testen middelen: Mangan, Zink, glandulars, Gingko biloba, Gota Kola (Centella asiatica), Ginseng, serotonine stimulators, Dopamineremmers, Hypofyse/Epifyse glandulars, B plex, Dopamine stimulators

GROEP I- bijnierfunctiestoornissen

De rubriek Bijnierfunctiestoornissen is verbonden met de meridianen 3 Verwarmer, Circulatie, Lever-Galblaas, en Nier.

3 Verwarmer-, Circulatie-, Lever-, GB- Nier meridianen

Te testen middelen: Vitamine B 5,6, B-plex, Pathoteenzuur, Kalium, Magnesium, Zink, Vitamine C, Zoethout, Ginseng (verhoogt ACTH), glandulars,

De groep H bevat 2 subrubrieken: typische vrouwenklachten en typische mannenklachten. Die hangen samen met de meridianen Blaas, Maag (mannelijke en vrouwelijke seksuele organen), Nier, Milt-Pancreas, Lever, 3 Verwarmer, en Circulatie.

GROEP J: Alleen voor vrouwen

B, M-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: Calcium, Magnesium, Zink, Ijzer, Vitamine E, chlorophyl, Folinezuur, B12, B6, glandulars, cimicifuga, Agnus castus, Capsella Bursa Pastora, Soja producten, Dioscorea Villosa (Wilde Yam), Viscum Album, Urtica dioica, Co Enzym Q10, Lapacho, Niacine, Noni, Omega 3 vetzuren, Selenium, Spirulina, Vitamine B Complex, Yam, DHEA



GROEP K: Alleen voor mannen

B-, N-, MP-, Le-, 3E-, P meridianen

Te testen middelen: EPA, DHA, Vitamine E, Zink, Sabal serrulatum, Yohimbe, Ginkgo Biloba, Ginseng, glandulars, Ginkgo Biloba, Ginseng, Guarana, Nutrizyme, Omega 3, Yohimbe, Zink

GROEP L: Longen en ademhalingssysteem

Groep I noemt de belangrijkste klachten van het ademhalingssysteem. Omdat de lichaamsafweer en ontgiftiging (immuunsysteem, slijmvliezen en het lymfesysteem) daarbij een grote rol spelen, valt dat voornamelijk onder de Long- en Dikke Darmmeridiaan. Maar de ademhaling hangt ook samen met de bijholten, en daarmee met de Maag- en Blaasmeridiaan.

Lo-, Di-, B- en M- meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, C, anti-oxydanten, Bplex, glandulars, Verbascum thapsus, Myrrhe, Lomatium dissectum (antiviraal), Lapacho, groene thee, Ginkgo biloba, Ginseng, Guarana, Sabal serrulatum, Vitamine E 400, Yohimbe, Zink

GROEP J: Urogenitaalsysteem

Groep J noemt de klachten die samenhangen met het Urogenitaalsysteem (Blaas- en Niermeridiaan).



GROEP M: immuun systeem (allergische reacties etc.)

Groep M noemt de klachten van een onderactief en een overactief immuunsysteem. Dat heeft effecten op resp. de meridianen Long en Dikke Darm (onderactiviteit), aangevuld met de Niermeridiaan, evt. Galblaas en Lever bij allergische over-activiteit.

Lo-, Di D-, N, Gb-, Le meridianen

Te testen middelen: Vitamine A, antioxydanten, glandulars, Echinacea, Lomatium, propolis, Vitamine E, OPC, Reishi, Selenium, Spirulina, Yamwortel, DHEA, Zink Lapacho, Mangaan, OPC, Selenium, Spirulina




De meting van de huidweerstand



Voordat je de huidweerstand meet, moeten de NAW gegevens van de patient ingevoerd worden.



Daarna moet een nieuw consult ingevoerd worden. Anders verschijnt deze foutmelding:

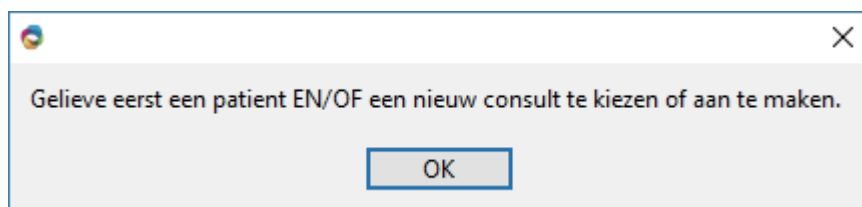

Daarbij klikt u het woord “Nieuw” aan en geeft de reden van het bezoek aan.



De communicatie tussen het apparaat en de computer is in orde als het lampje rechts onder in het EDA-scherm groen oplicht.



Is het rood, controleer dan of het lampje op de I-link brandt en of het meetapparaat ingeschakeld is en of de batterij voldoende geladen is. Zie de indicatie van de batterij



bovenin het EDA-scherm.

Opladen van de batterij in de bijgeleverde batterijlader. Wanneer u een druppellader hebt dan kunnen de batterijen in het laadapparaat blijven.



Vorbereiding van de patient:

De laatste maaltijd is tenminste 1,5 uur voor de behandeling genuttigd. Dan heeft het lichaam de tijd gehad om het voedsel te verwerken en is de belasting door het verteringsproces niet meer in belangrijke mate bepalend voor de energieverdeling.

Op de dag van de meting handen en voeten is het beter dat insmeren met creme, olie, lotions etc achterwege blijft. Oliehoudende stoffen werken isolerend en laten de meetstroom minder goed door.

Help de patient bij het ontspannen en leg uit wat er gaat gebeuren.

Sieraden (ringen) en digitale horloges bij voorkeur afdoen, als dit tenminste zonder veel moeite gaat.

Transpirerende voeten en handen met een doek drogen.

De passieve elektrode om de linker pols vast maken.

De Meetplek en de meting:

Besteed bij de praktijk-inrichting aandacht aan het zo goed mogelijk creëren van een natuurlijke omgeving, met zo min mogelijk elektro-smog en sluit de mogelijkheid uit dat de patient zich oplaadt met statische elektriciteit (geen nylon vloerbedekking). Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan in een stedelijke omgeving waar zendmasten in de buurt kunnen staan, waar in de omgeving veel WiFi routers zijn en door het gebouw veel kabels lopen. Het is niet mijn bedoeling een heksenjacht te starten, maar wat je zelf redelijkerwijs kunt doen, doe dat:


- Direct naast de meetplek geen DEC telefoon, niet direct naast een PC zitten maar tenminste 1,5 m er van af. Voor een adapter geldt hetzelfde.
- Leg je Telefoon meer dan 1,5 meter van je af,
- zet de draadloze printer uit als deze vlak bij de meetplek staat.
- Wanneer de lucht erg droog is (bij strenge vorst) laat dan de patient de handen kort onder de kraan houden (en dan afdrogen) zodat statische lading wordt afgevoerd.

Het meten is geen wedstrijd. Druk de meetpunt rustig in en laat daarna de punt terugveren. Het apparaat heeft wat tijd nodig om de meetpuls het lichaam in te sturen en via de passieve elektrode voldoende meetwaarden te verzamelen. Om precies te zijn is de benodigde tijd


0,2 seconden. Wanneer de meting ongeldig is (te kort waardoor er te weinig meetwaarden zijn of de gesampelde waarden vertonen teveel spreiding), dan hoort u een waarschuwingssignaal.

De plaats van de meetpunten

Het meetpunt ligt waar de twee lijnen langs de nagelriemen elkaar kruisen. Je kunt die punten ook voelen, omdat het bindweefsel bij de acupunctuurpunten iets losser is. Bovendien voel je een botrand. Je moet met de meetpunt op het zachte weefsel drukken en niet op de stugge rand van het nagelbed. Volgorde van de meetpunten: De volgorde wordt door het programma aangegeven:



1. Duim links mediaal
2. Wijsvinger links mediaal
3. Middelvinger links mediaal
4. Ringfinger links lateraal
5. Pink links lateraal
6. Pink links mediaal etc.

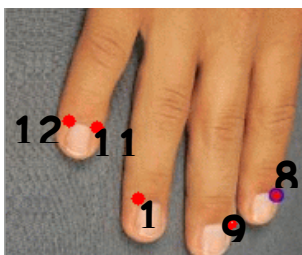

0	Lo 11	0
0	Di 1	0
0	C 9	0
0	3E 1	0
0	H 9	0
0	Du 1	0
0	MP 1	0
0	Le 1	0
0	M 45	0
0	G 44	0
0	N 1	0
0	B 67	0

Verbind de binnenkant van de linkerpols van de patient met de passieve electrode aan de binnenkant.

Doe een meetronde van 24 punten

Herhaal de meting op een punt met extreme meetwaarden door dat meetveld opnieuw aan te klikken, of stel dat automatisch in. Het nameten van één (of twee) extreme waarden doen we zodat we weten dat het

daadwerkelijk een meetpunt betreft met een hoge weerstand en niet een zeer kortdurende, misschien toevallige afwijking. In de therapie is een extreme waarden een belangrijk

☒ extreme waarden nameten	1
--	---

criterium. Zorg dat 'extreme waarden nameten' aangevinkt is en op 1 staat

Herhaal de meetronde na de provocatie met het 100 Hz signaal.

** Je kunt de beamer testen met de provocatie procedure.

Wat gebeurt er bij een EDA-meting?

Je meet de elektronische huidweerstand in K-Ohm aan de begin- en eindpunten van de 12 meridianen op handen en de voeten, 24 in totaal.

De meetstift is zodanig verend dat de meetdruk op het meetpunt altijd gelijk is.

De meting komt tot stand door een extreem lage stroomsterkte (0,9 Microamperé) en een zeer korte meetduur(200msec.)



Meetwaarden van gezonde mensen liggen tussen de 500 tot 5500 K-ohm. Jonge mensen hebben een lagere huidweerstand dan oudere. M.a.w. de cellen van jonge gezonde mensen zijn actiever dan bij ouderen. Het systeem houdt rekening met de toenemende weerstand t.g.v. de stijgende leeftijd.

Diverse meetmogelijkheden:

- Meting op 24 punten meting waardoor je een volledige beeld van alle meridianen krijgt;
- Het meten op 2-punten om middelen op de probleem-meridiaan snel te testen als voor-selectie van middelen die je daarna op alle meridianen gaat testen;
- 6 –punts EMT wordt behandeld in deel 3. EMT is ontwikkeld om snel en effectief raymedies of supplementen te testen (EMT= Elektronische Middelen Test) ;
-


- 1- punts EMT meting met de instelling „klassiek“ , waarmee snel raymedies of supplementen worden getest. Deze werkwijze vormt een aanzienlijke verbetering t.o.v. de klassieke elektro-acupunctuur meting volgens Voll want de meting is pijnloos, niet beïnvloedbaar door degene die meet, gebeurt met een veel geringere meetstroom die de meridiaan niet beschadigt en is zeer nauwkeurig.

1 punts meting wordt later behandeld. De opgave / doel ervan : zoek naar het middel(-en) om de zwakste meridiaan te versterken. Toepassing: ingewikkelde gevallen waar een groot aantal middelen getest moet worden. Dient als snelle voor-selectie.

Door jezelf voorgeprogrammeerde test-protocollen.:

Het maken en onderhouden van je eigen test-protocol voor de middelen van een fabrikant waarmee je goede ervaringen hebt is erg praktisch want:


- Je kunt daardoor deze metingen delegeren.
- Je slaat geen middel over.
- Je werkt systematisch
- De naam van het testmiddel wordt automatisch ingevuld zodat je snel kunt werken
- Je kunt altijd nieuwe middelen en indicaties voor middelen toevoegen op grond van nieuwe inzichten die je opdoet bij het lezen van artikelen, cursussen, eigen ervaringen.

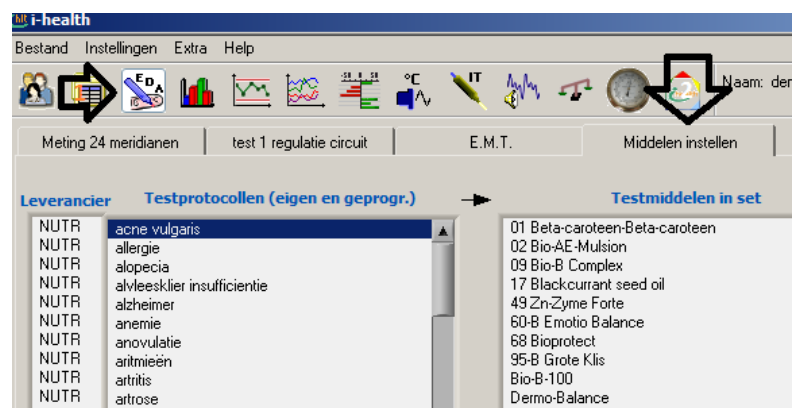


We hebben voorbeeld-protocollen voor de middelen van twee fabrikanten voorgeprogrammeerd. Deze kunnen niet worden veranderd.

Je voert je eigen protocol als volgt in:

1. Klik op het EDA-Icoon (Pijl 1).
2. Klik vervolgens op de tab “Middelen instellen(Pijl2) ”.
3. Voer de namen van alle middelen in waarvan je test-buisjes hebt: Klik op ‘bewerk lijst’.

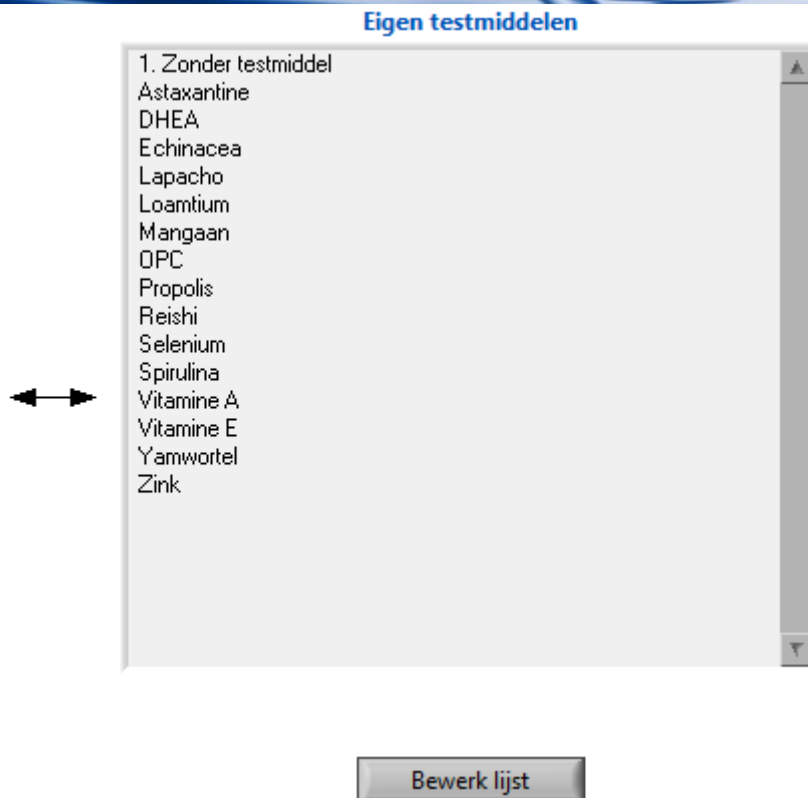

3. Klik op  **Nieuwe** Dan verschijnt het volgende scherm

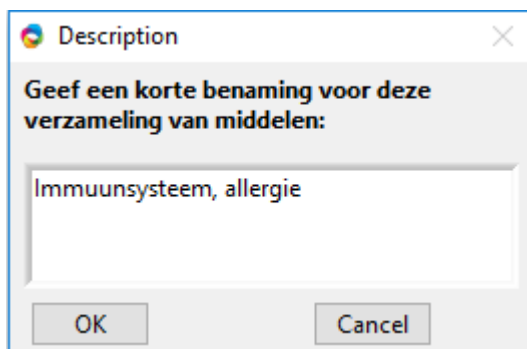

4. vul de naam in voor welke klacht je een protocol opstelt: Bijvoorbeeld 'immuunsysteem'.

5. Kies uit je lijst met middelen de stoffen uit die goed zijn voor het immuunsysteem en voeg deze aan het test-protocol toe door op deze knop te drukken 

Let op: kies altijd eerst '1. Zonder test-middel' , d.i. de meting na de provocatie. Daarna doe je de tweede meetronde, met het eerste testmiddel, enz.

Klik nu op de linker tab "**meet 24 meridianen**" om terug te keren in het EDA-scherm (pijl)



[ortho] Übergewicht
[ortho] Übergewicht und glz.Firmikuten
Bloedarmoede
Immuunsysteem, allergie
Immuunsysteem, allergie

Testmiddelen: <geen>

Klik dan op “**geen**” op de onderste balk links, naast “**Testmiddelen**”

Door op “**geen**” te klikken op de onderste balk links (pijl 1), wordt de indicatielijst zichtbaar.

Door het selecteren van “**Bloedarmoede**”(pijl 2), verschijnt eerst de ‘lege meting’ en na die meting de naam van het eerste testmiddel van de bloedarmoede-testlijst die je zelf hebt geprogrammeerd direct boven de twee meetkolommen van de 24 meetpunten:

1.		
0	Lo 11	0
0	Di 1	0
0	C 9	0
0	3E 1	0

1. B-12 2000		
0	Lo 11	0
0	Di 1	0



Provocatie en vergelijken van metingen

Een enkele meting geeft slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie. Bij het testen van medicamenten is het noodzakelijk, alle meridianen zodanig extra te prikkelen dat de regulatiecapaciteit van het lichaam tot het uiterste beproefd wordt. Daardoor wordt duidelijk wat de zwakste meridianen zijn. Vervolgens worden de reacties van de meridianen op geneesmiddelen, ortomoleculaire middelen, voeding, homeopatische middelen, fytotherapeutica gemeten. Na een provocatie is duidelijk welke de zwakke en geblokkeerde meridianen zijn. Deze provocatie is een integraal en fundamenteel gedeelte van het testgebeuren. **De derde meting of de meting na de provocatie geeft problemen het beste weer.**

We onderscheiden twee soorten provocaties.

1. Met de AFT-Beamer;

2. Meting volgens protocol  Volgens protocol =>   waarbij de derde meting als meting na een provocatie gezien kan worden. Dit is een zachtere aanpak




die als voordeel heeft dat de derde meting ook een heel goed inzicht geeft in de invloed van emoties en trauma's.

- Belangrijk: de functie van de **100Hz provocatie** knop provocatie in het EDA-scherm is tevens dat daarmee getest wordt of de beamer naar behoren functioneert!! Wanneer je een foutmelding ziet controleer dan de verbinding met het itronic apparaat en de jackplug. Als desondanks de foutmelding terug blijft komen, dan is er waarschijnlijk sprake van een kabelbreuk van de beamer.

Verloop van de provocatie met het 100 Hz signaal via de beamer:

Houd de AFT-Beamer na het klikken op gedurende 15 tot 20 **100Hz provocatie** seconden aan de bovenkant van het hoofd ofwel de kruin om een prikkeling te geven. Dit signaal wordt door de meeste mensen niet gevoeld. Een enkeling vindt het onaangenaam.


Meet direct na de provocatie voor de tweede keer. Zwakke-meridianen worden zwakker, de waarden van gezonde meridianen veranderen weinig. Starre, te weinig regulerende meridianen zijn na de eerste meting niet zichtbaar, maar wel door de eerste en de tweede meting te vergelijken. Starre meridianen noemen we meestal geblokkeerde meridianen. De grens trekken we bij veranderingen van meting tot meting wanneer deze kleiner zijn dan 6 a 8 %. In het scherm 'therapie assessment' kan je deze grens zelf instellen:



Met deze provocatie breng je het lichaam aan de grens van zijn regulatiecapaciteit. De metingen na een provocatie zijn normaal gesproken stabiel. Hoe groter het energieverlies door de provocatie, des te kleiner is de energiereserve van de meridiaan waarvan de energie zo sterk vermindert.

Vergelijking van beide metingen (de grafiek „**Therapie assessment**“), maakt het mogelijk de reactie van het lichaam in detail te zien. Voor een inschatting van het effect van een medicamenten-test waarbij de patient tijdens de meting contact had met het middel (meting x+1) altijd met de vorige meting (meting x) vergelijken. De grafiek kan alle metingen gelijktijdig laten zien . Het beeld „**Testresultaten**“, toont of een middel energie gaf (groene balk naar rechts, dus een stimulerende invloed) of energie vroeg, (rode balk naar links) dus een belastende invloed uitoefende.

Belangrijk: Na de provocatie richt u zich met de therapie op de zwakste meridiaan en op het meridiaan-paar met de grootste disbalans tussen links en rechts.




De Interpretatie van de metingen.

EDA vergemakkelijkt en ondersteunt de diagnose en maakt een snel overzicht van de problematiek duidelijk. Het vervangt echter *niet* een formele diagnose of een diagnostische procedure. EDA is een afkorting voor 'Electro Dermal Assessment' of 'Electrodermal Diagnostic Aid'. We gebruiken deze aanduiding omdat de aanduiding in de software moet aansluiten bij begrippen die voor medisch gecertificeerde systemen erkend zijn.

Wanneer gedurende de behandelperiode de meetwaarden verbeteren dan duidt dat op een verbeterd zelf-regulerend vermogen (Homeostase). Dit wordt bijna altijd gevolgd door een toename van het algemene welbevinden.


Patienten begrijpen het scherm 'regulatie-vermogen' het snelst. 'Hoe meer groene balken, hoe beter' is eenvoudig en goed te onthouden.

Regulerende capaciteit.



Regulatievermogen = vermogen tot Homeostase

Ziekte en klachten worden veroorzaakt door een gebrek aan energie of een energieoverschot van één of meer meridianen. Het diagram laat de absolute weerstandswaarden zien, vergeleken met de normwaarden voor weerstanden die horen bij gezonde lichamen. Als de verticale balken binnen de twee parallelle lijnen allemaal *groen* zijn, beschikt het lichaam over optimale regulatie-, aanpassings- en herstelcapaciteit, neutraliseert risicofactoren en komt tijdelijke stress te boven op een natuurlijke en flexibele manier. Weerstand en energie zijn omgekeerd evenredig met elkaar: veel weerstand betekent dat de organen en weefsels die met de meridiaan zijn verbonden weinig energie hebben. Weinig weerstand betekent dat het signaal weinig weerstand ondervindt op zijn weg door de meridiaan. Weinig weerstand duidt op verhoogde potentiaalverschillen tussen de binnenkant en de buitenkant van een cel. Over het algemeen praten we over energie, maar we meten de weerstand die meetstroom op zijn weg door de meridiaan ondervindt.

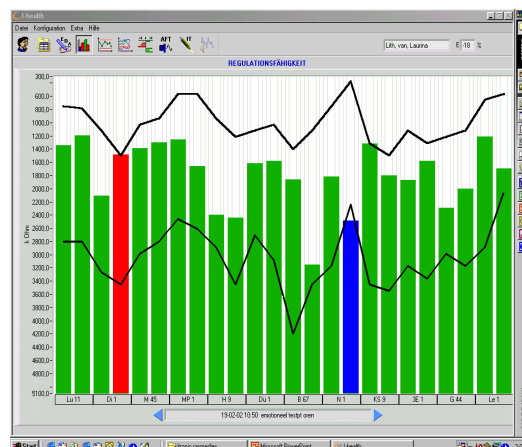

De meetwaarden in **kΩ** (kilo ohm) staan links naast de y-as.



Een overvloed aan energie wordt door de *rode* balken weergegeven. Energie overschot wordt niet per se door de patient gevoeld als een fysiek robuuste belastbaarheid, gevoel over veel energie of prestatie-vermogen te beschikken. Overenergie duidt op:

- ontsteking of infectie in de acute fase;
- stress, hyperactiviteit;
- verzuring.

Gebrek aan energie (= verhoogde weerstand) wordt door *blauwe* balken weergegeven.

Deze grafiek 'Regulerende capaciteit' laat de gemeten weerstandswaarden zien en deze worden vergeleken met de normwaarden. Weinig weerstand: veel energie. Veel weerstand: weinig energie (als in de Wet van Ohm).

Groene balken (tussen de parallel lopende zwarte lijnen): optimale regulatie- en aanpassingscapaciteit = Homeostase. Optimale capaciteit om te herstellen of te genezen.

Rode balken (boven de bovenste horizontale zwarte lijn): hyperactief. Ontsteking, infectie in de acute fase of verzuring.

Blauwe balken (onder de onderste zwarte lijn): belemmerde functie of organische storing. Deze kan verschillende oorzaken hebben:

- belasting door toxinen uit het milieu, uit de voeding;
- door niet goed verlopende stofwisseling (verkeerde voeding, ongunstige darmflora, ;
- een tekort aan één of meer voedingsstoffen (aminozuren, enzymen, macro- of micro elementen);
- chronische ontstekingen;
- slechte doorbloeding, slechte voorziening met voedingsstoffen, te weinig zuurstof. \


U kunt voorwaarts door de metingen bladeren door met de muis op de blauwe driehoekjes te klikken die onder de grafiek staan.



Bij een optimale regulatie en gezondheid is ligt het energieverbruik van een twintigjarige bij ongeveer 800 Watt na activering van de circulatie. Dus niet in rusttoestand, dan verbruikt het lichaam veel minder energie. 's Avonds laat nemen de weerstanden toe, wanneer het lichaam overschakelt op 'rust'.

De Raymedy software corrigeert de normcurven in overeenstemming met de actuele leeftijd van de patient.

In het hokje bovenin de grafiek wordt de actuele energie van de patient uitgedrukt in percentage





Een geleidelijk teruglopen van de energie met het ouder worden is des levens loop en dus normaal, vandaar dat de normcurve wordt aangepast aan de leeftijd van de patient.

Energetische toestand van de meridianen

1341	2112	1384	1258	2394	1614	1850	1817	1317	1871	2288	1211	links
Lu 11	Du 1	M 45	MP 1	H 9	Du 1	H 67	M 1	KS 9	KE 1	G 44	Lu 1	K 12
1199	1482	1290	1656	2437	1577	3152	2405	1803	1582	2801	1630	rechts

Normale bereik = 1.000 – 2.000 kOhm voor volwassenen en 400-800 kOhm voor kinderen

Bij volwassenen: 500 – 700 kOhm = sterk energieoverschot

Door vochtige huid, verkramping met stuwung , verzuring, ontsteking, koorts

Minder dan 500 kOhm = zeer sterk energieoverschot


Ontspanning en ontzuring zijn noodzakelijk

Therapeutische hypothesen: ingrijpen door ontspanning, energietransport, inname van calcium, magnesium, ontstoring, shiatsu, chacratron....., gebruik van raymedys op sederingspunten, gebruik van *sedatron raymedys, behandelen van een ontsteking wanneer deze in de acute fase is.

Duidelijk verhoogde huidweerstand, blauwe balken:

Therapie hypothesen of mogelijkheden:


- onderzoek aan welke voedingstoffen (mineralen, energiebronnen, aminozuren, enzymen) gebrek is (Denk aan de Wet van Liebig ' ook wel de wet van het minimum genoemd, toegepast op de mens: de voedingsstof die relatief het minste aanwezig is bepaalt het niveau van de stofwisseling'.
- Is er sprake van een toxische belasting (milieu, voeding);
- Worden voedingsstoffen niet goed opgenomen en verteerd ?
- Dysbiose ? Leaky gut ?
- Onderactiviteit endocriene klieren ? Hormonale tekorten ?
- Chronische infectie ?
- Chronische stress ?

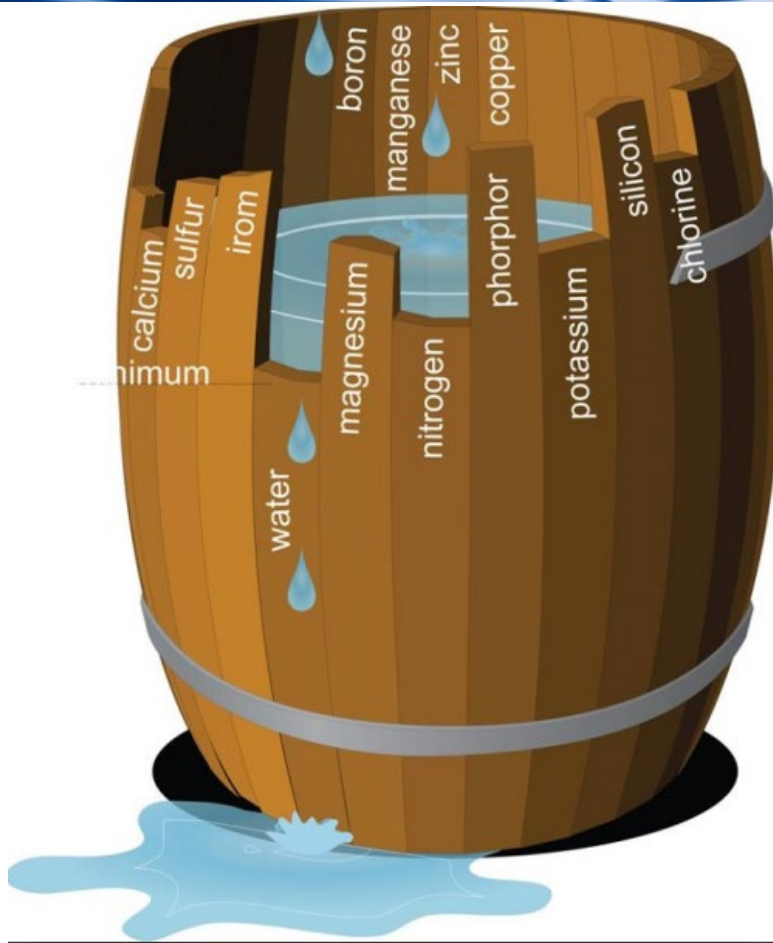

De wet van Liebig




Samenvatting:

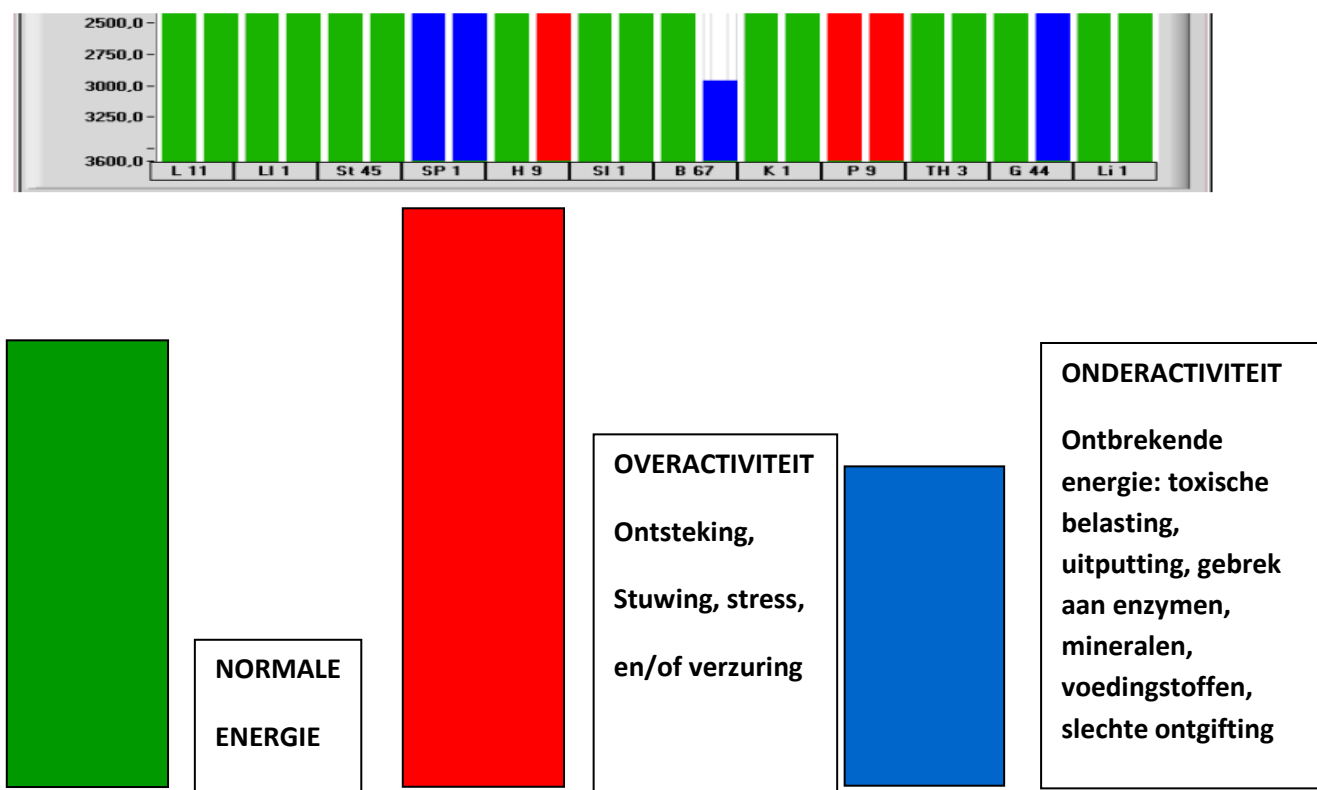

Boven de zwarte normlijn: hyper **rood**
Ontsteking, verzuring, stagnatie

Tussen de normlijnen: **groen** Normale regulatie

Onder de onderste normlijn: hypo **blauw** Deficiëntie

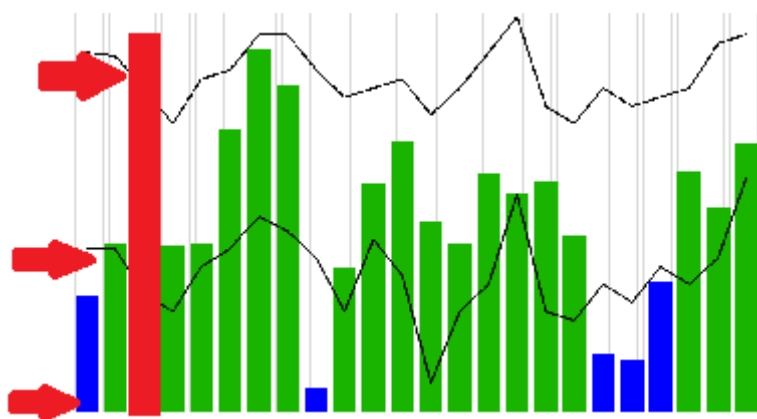



Met deze grafiek wordt in één oogopslag duidelijk welke meridiaan-paren uit evenwicht zijn.

Prioriteit licht bij de behandeling van de zwakste meridiaan en bij de meridiaan die het meest uit evenwicht is. We onderscheiden drie categorieën:


In balans: het energie verschil is $< 30\%$ Het meridiaan-paar krijgt geen kleur.

Attentie: het energie verschil is $> 30\%$ en $< 70\%$. Het meridiaan-paar wordt oranje gekleurd

Kritisch: Het energie verschil is $> 70\%$. Het meridiaan-paar wordt rood gekleurd.

Wanneer een groot energie verschil langere tijd optreedt, dan ontstaan er klachten. De verklaring is dat de processen die door het meridiaan-paar van energie worden voorzien niet goed gereguleerd worden.

Vanuit de opvatting 'mind over matter' biedt deze grafiek het best mogelijke inzicht hoe belastende emoties, soort stress, compensatiemechanismen en gedachtenpatronen de energiehuishouding beïnvloeden en zich uiteindelijk als lichamelijke klachten gaan manifesteren.

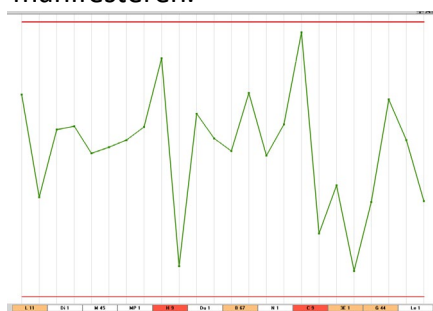

MP 1	H 9	Du 1
Kritisch!		Attentie!



De energetische uitkomst (resultante) van zowel een lichamelijke belasting, ziekte, litteken en de roofobouw die trauma's, negatieve kernovertuigingen, frustraties, enz. zien we in één en dezelfde grafiek. Het is een persoonlijke keuze van de therapeut of je eerst in gaat op de emoties of op de lichamelijke oorzaak van de onbalans van het meridiaan-netwerk.

In de grafiek symmetrie ziet men de disbalans in procenten. Wijst de balk naar rechts dan is de rechter meridiaan ten opzichte van de linker de zwakkere partner. Wijst de balk naar links dan is de linker meridiaan de relatief zwakkere.



De meta-analyse:

yin/yang, boven/onder, links/rechts, vuur/water, vitaliteits-index, harmonie-index

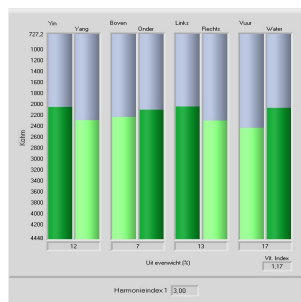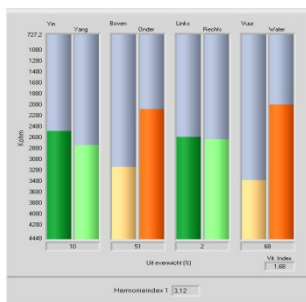

De Yin meridianen zijn de lo-, MP-, H-, N-, C- en Levermeridianen. Het zijn de meridianen die de vaste of dichte organen reguleren. Zij reguleren de opbouw, de anabole processen, ook wel als herstelprocessen en als 'nacht'reactie aangeduid. De Nervus vagus, het cholinergisch systeem (het

zenuwstelsel in de hersenen dat acetylcholine (Ach) gebruikt als neurotransmitter) >> ontspanning en weefsel herstel.

De Yang meridianen zijn de DiD-, M-, Du-, B-, 3^E- en Gb- meridianen. Het zijn de meridianen die de holle ruimte organen reguleren (m.u.v. de 3 E). Zij reguleren de actie, de energie-voorziening, de katabole processen: sympathicus, adrenergisch systeem(m.b.t. sympathische zenuwvezels die bij prikkeling stoffen produceren met het effect van adrenaline)>> activiteit, arbeid, prestatie, lichamelijke energie.

Belangrijke relaties met de emoties:

De meridianen die door de linker lichaamshelft verlopen worden beïnvloed door emoties die te maken hebben met het verleden, familie- en relatiethema's.


De rechter meridianen worden vooral beïnvloed door: toekomstverwachtingen, spanningen op het werk, relaties met collega's, gebrek aan erkenning op het werk, positie in het vakgeboed en verhoudingen met chefs.


De Boven meridianen zijn de meridianen die op de Ting-punten van de vingers worden gemeten. Wanneer de bovenmeridianen een energiegebrek vertonen dan duidt dit op de volgende mogelijke oorzaken: verminderde voeding van de hersenen, verminderde drainage van de hersenen, toxische belasting, >> gebrekkige regulatie, controle en feed-back.

De Onder meridianen. Dit zijn de meridianen die de vertering van het voedsel reguleren, de opname van voedingsstoffen, secretie en ontgiftiging. In geval van energiegebrek >> gebrekkige resorptie, eliminatie en excretie>>

Een belangrijk algemeen punt:


De longmeridiaan staat op de eerste plaats. Dat is historisch zo gegroeid. Bij de beoordeling van de afwijkingen van de normen nemen deze een bijzondere plaats in. Meer dan andere meridianen werken energie problemen van de longmeridiaan verder in het systeem door omdat de longmeridiaan het immuunsysteem reguleert. Als de longmeridiaan asymmetrisch is of te weinig energie heeft dan is de kans heel groot dat er sprake is van een infectie, bacterieel, viraal, parasitair of een schimmelinfectie. Een infectie is heel dikwijls niet tegelijkertijd zichtbaar als een regulatie-probleem van de Dikke Darm meridiaan.

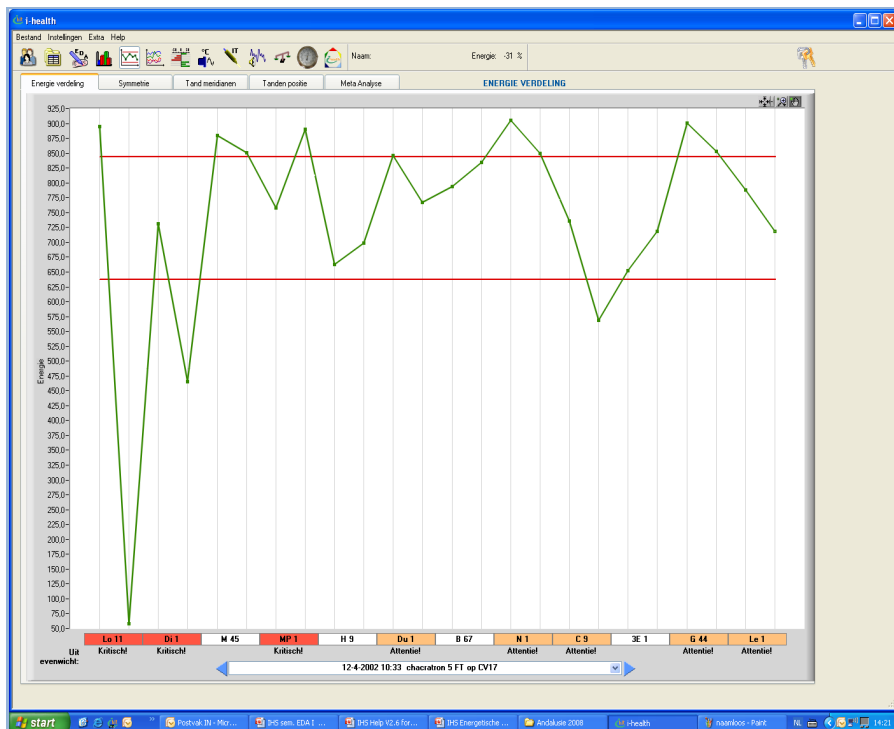



THERAPIE ASSESMENT.

Het vergelijken van metingen: waar wijzen verschillen tussen metingen op?

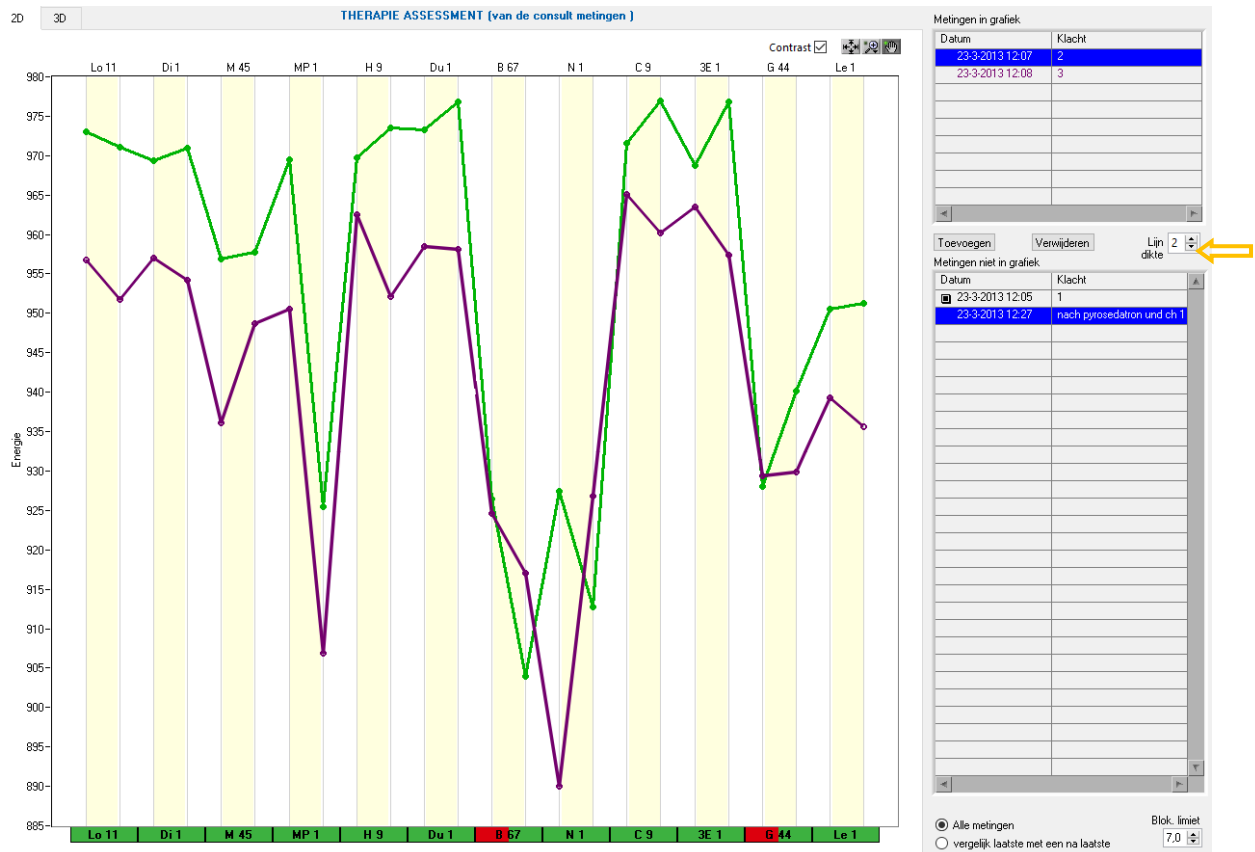

Deze grafiek dient om:

- reacties op behandelingen te beoordelen;
- Veranderingen die in de loop van de tijd optreden zichtbaar te maken;
- Reacties op medicijnen, ortomoleculaire middelen, enz in detail te beoordelen.

We raden aan om de blokkade limiet op 8% in te stellen. Veranderingen die kleiner of gelijk zijn aan 8%, worden met een rood vlaggetje in de x-as weergegeven. Kleine veranderingen duiden op een verminderde aanpassing van de gevlagde meridiaan. Één van de therapiedoelen is om de aanpassingscapaciteit te vergroten.






Voor het vergelijken van de laatste meting met de voor-laatste activeren we de instelling


☒ vergelijk laatste met een na laatste

Ons lichaam reguleert voortdurend. De waarden verschillen dus van meting tot meting. De veranderingen zijn vergelijkbaar met de variatie van bloeddrukmetingen en vele labwaarden.



Een rode vlag duidt op nauwelijks veranderde energie: geen reactie op de behandeling of testmiddel, gering aanpassingsvermogen van de functies aan wijzigende omstandigheden. Je kunt dit vergelijken met iemand waarvan de pols nauwelijks veranderd wanneer deze 2 trappen op rent. Dat is ook niet gezond.

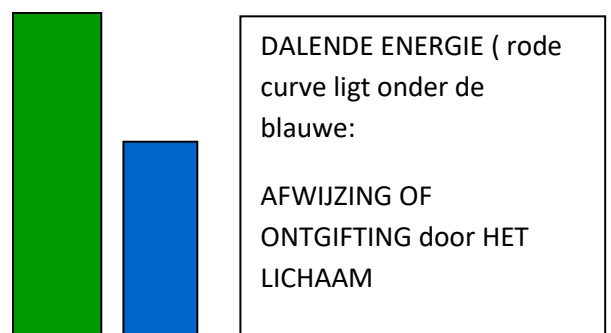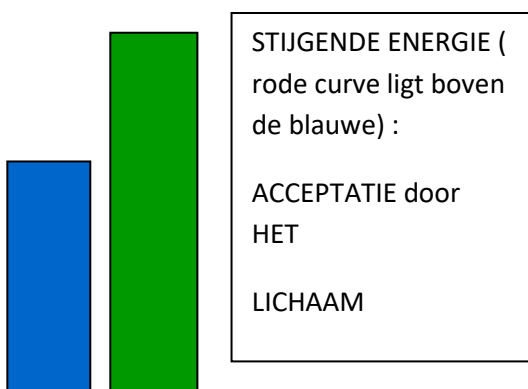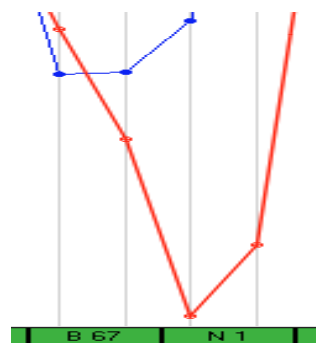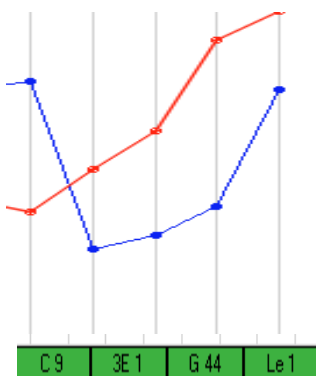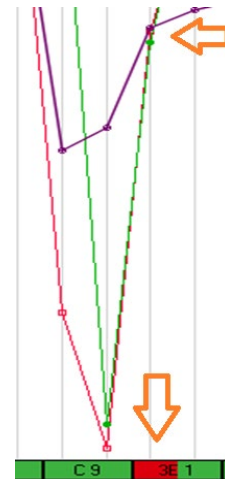

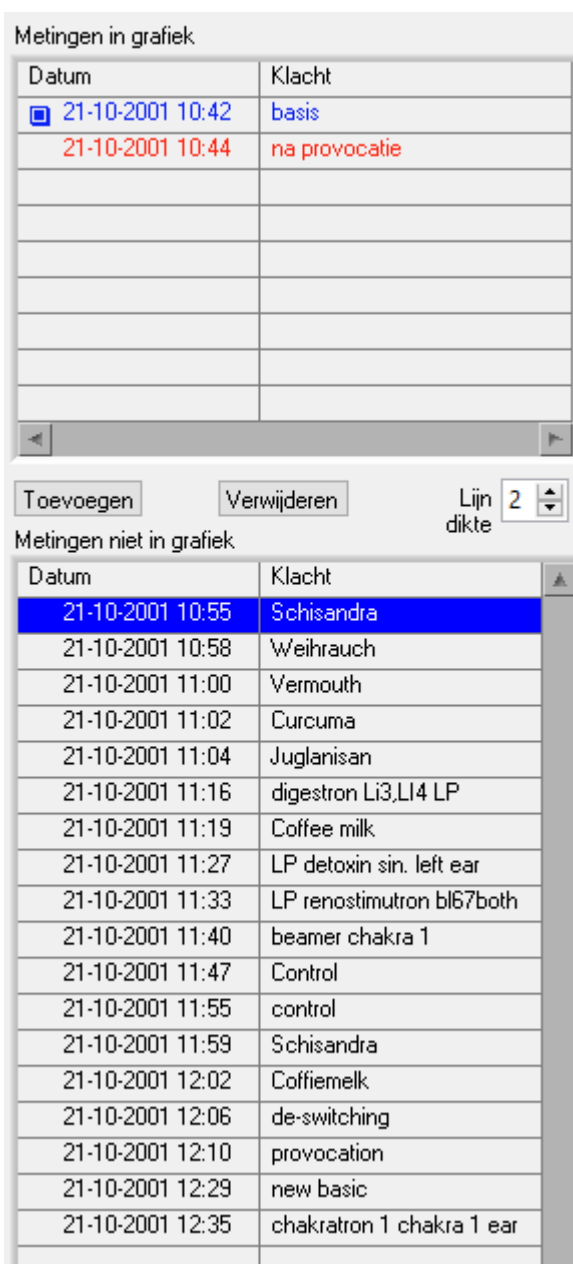

Voor het onderscheiden van een specifieke meting: selecteer die meting in de lijst; de gekozen grafiek wordt dan knipperend weergegeven.


U kunt de dikte van de lijnen instellen.

De werking van een testmiddel is bij iedere meridiaan te zien. Hiervoor


vergelijkt u altijd de een na laatste (blauwe) met de laatste (rode) meting. Als het punt dat bij een meridiaan hoort op de rode curve hoger ligt dan op de blauwe dan is de energie toegenomen. Ligt het punt lager, dan is de energie afgenomen.

We zoeken middelen die:

- de meridianen die het zwakste zijn energie geven, zonder dat er meridianen zijn waarvan de energie (duidelijk) verslechterd.
- Die het energie-overschot van meridianen die teveel energie hebben verminderen. Dus dan mag de energie van

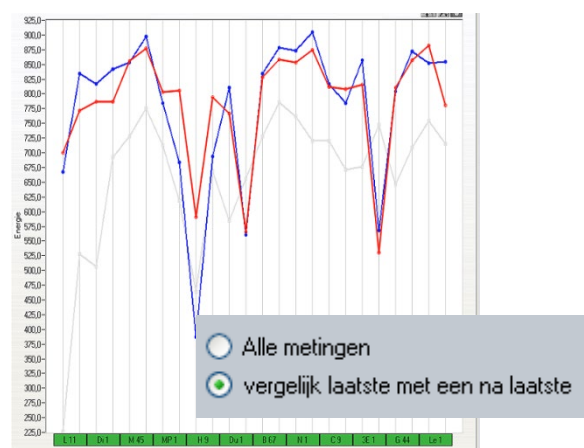

zo'n meridiaan verminderen.

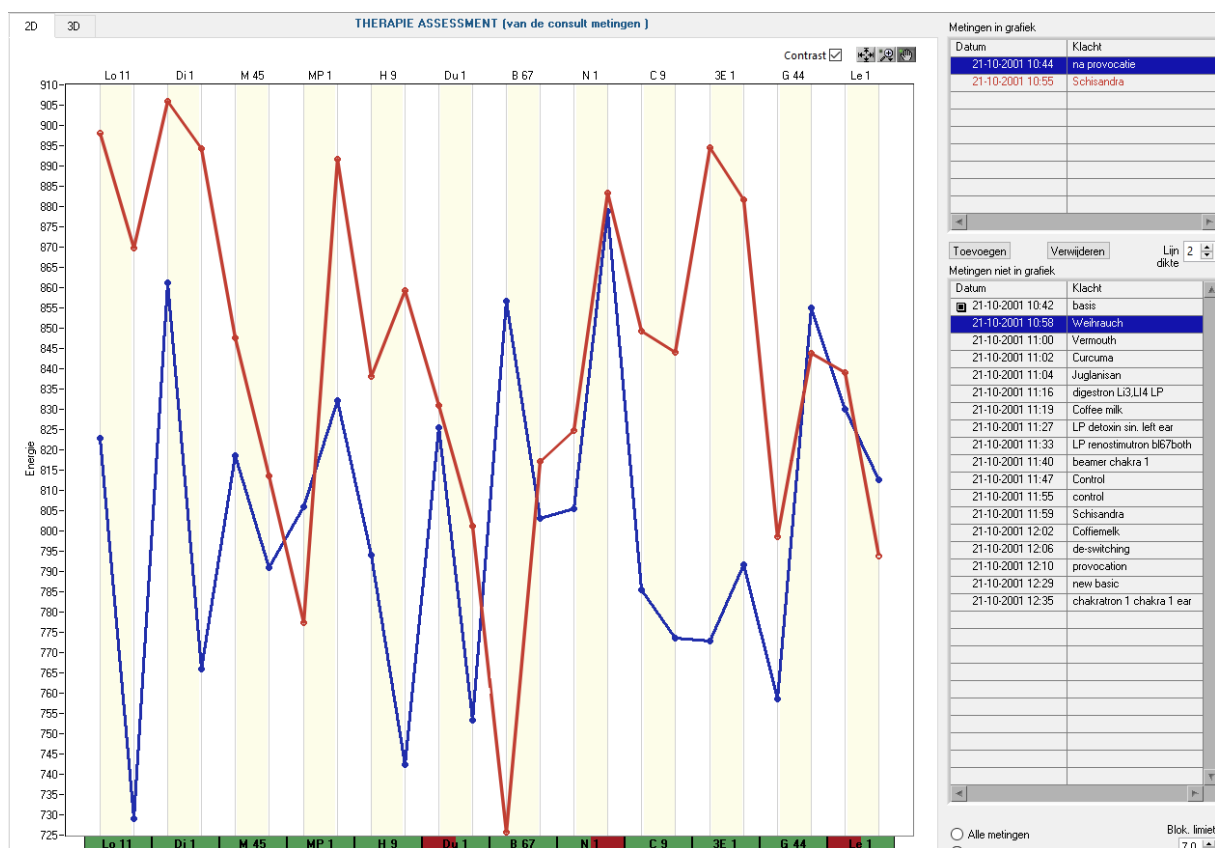


De blauwe curve: direct na de provocatie gemeten. De rode curve met het middel Schisandra. Schisandra wordt bij vele klachten ingezet en dikwijls wordt de gunstige werking op de lever genoemd.


In dit geval verbetert de energie van de meeste meridianen. De Dunne Darm links, de Niermeridiaan rechts en de Levermeridiaan links veranderen heel weinig, om precies te zijn < 8% . Zie de rode vlaggetjes.

De Milt-Pancreas meridiaan vermindert een heel klein beetje. De linkerblaasmeridiaan wordt duidelijk slechter. Wanneer er sprake is van een blaasmeridiaan gerelateerd probleem of een al zwakke meridiaan dan is dit middel in ieder geval niet aan te raden. Het kan zonder bedenkingen worden voorgeschreven in combinatie met een middel dat de energie van de linker blaasmeridiaan verhoogt. In dit geval is dat Alsem of Absinth (Artemisia absinthium). Zie de volgende curve. De energie wordt van vrijwel geen enkele meridiaan minder, maar de blaasmeridiaan (links) verbetert aanzienlijk ! Zie de oranje pijl onder de volgende grafiek. Deze patient kan zich dus beperken tot het innemen van Schisandra en Alsem.

Deze figuur laat de reactie van de meridianen op Absinthium zien. Dit was het middel dat als derde getest werd, na Wierrook (Weihrauch).

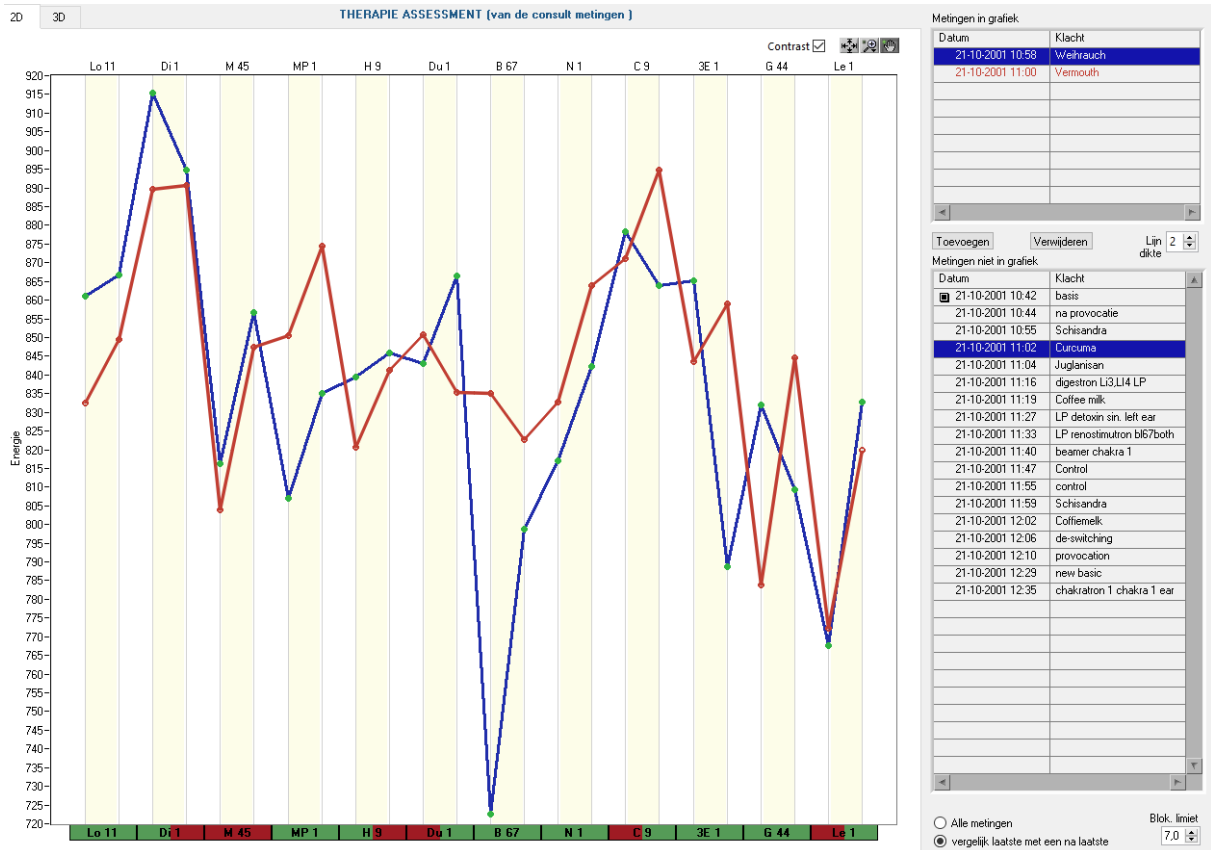

We vergelijken telkens de laatste meting met de voorlaatste. Door het lichaam in contact te brengen met een stof reageert het meridiaan systeem. Zodra we de stof wegnemen, reguleren de meridianen verder vanuit de toestand waarin het door beïnvloeding door het laatste middel is gebracht. Daarom is het van belang dat de tussentijd tussen de tests zo kort mogelijk is.



De grafiek Testresultaten

Meridianen

Tand afwijkingen

Meta analyse

Meridianen

Rood= energie afname

Groen= energie toename

Grijs: onnauwkeurigheid. Je zoekt naar stoffen die een grotere toename veroorzaken.

Je kunt de gemiddelde energie verandering van alle meridianen samen laten zien, maar ook voor iedere afzonderlijke meridiaan.

De meridiaan waarvan links een '●' staat is de meridiaan die reageert als het gemiddelde van alle meridianen. De meridiaan waarvan links een 'x' staat wijkt het meest af van het gemiddelde van de reacties.

Deze grafiek helpt om de stoffen te bepalen die de grootste energetische toename veroorzaken.


Let op: De interpretatie kan verschillen afhankelijk van de het energie niveau van de client. Bij iemand die hyper is, kan een rode balk (het kost energie) toch positief zijn omdat een reductie van de energie in dat geval nodig is.



Tand afwijkingen.

Iedere tand of kies is met 2 meridianen verbonden. De verstandskiezen zijn zelfs aan 4 meridianen gekoppeld, de vier vuur meridianen Hart, Dunne Darm, Drievoudig Verwarmer en de Circulatie meridiaan.

Deze relaties zijn in de software te vinden door te gaan naar de grafiek 'energieverdeling' => Tandens positie.




Over de relatie tussen gezondheid en het gebit zijn boeken vol geschreven. Een praktische aanpak is om bij therapie- resistente patienten na te gaan onder welk gebitselement een ontsteking aanwezig is, of zich zware metalen hebben verzameld.

Wortelkanaalbehandelingen zijn een bron van narigheid doordat alleen de allergrootste kanalen zijn gereinigd, maar de fijnere structuren nog vol zitten met toxinen.

Raymedy is geen voorstander van radicale, ingrijpende saneringen, maar van een stapsgewijze aanpak. Met de Raymedy's Focutron, dentosanotron, cicatron kan een indruk verkregen worden welke tanden in aanmerking komen voor een nader onderzoek door de tandarts. In het voor-traject kunnen deze signalen goede diensten bewijzen en helpen om haarden en stoorvelden op te ruimen.

Tandens positie: relaties tussen tanden en kiezen en meridianen. De eerst genoemde meridiaan verklaart voor 70% de energie, de tweede speelt dus de tweede viool met 30% van de invloed.

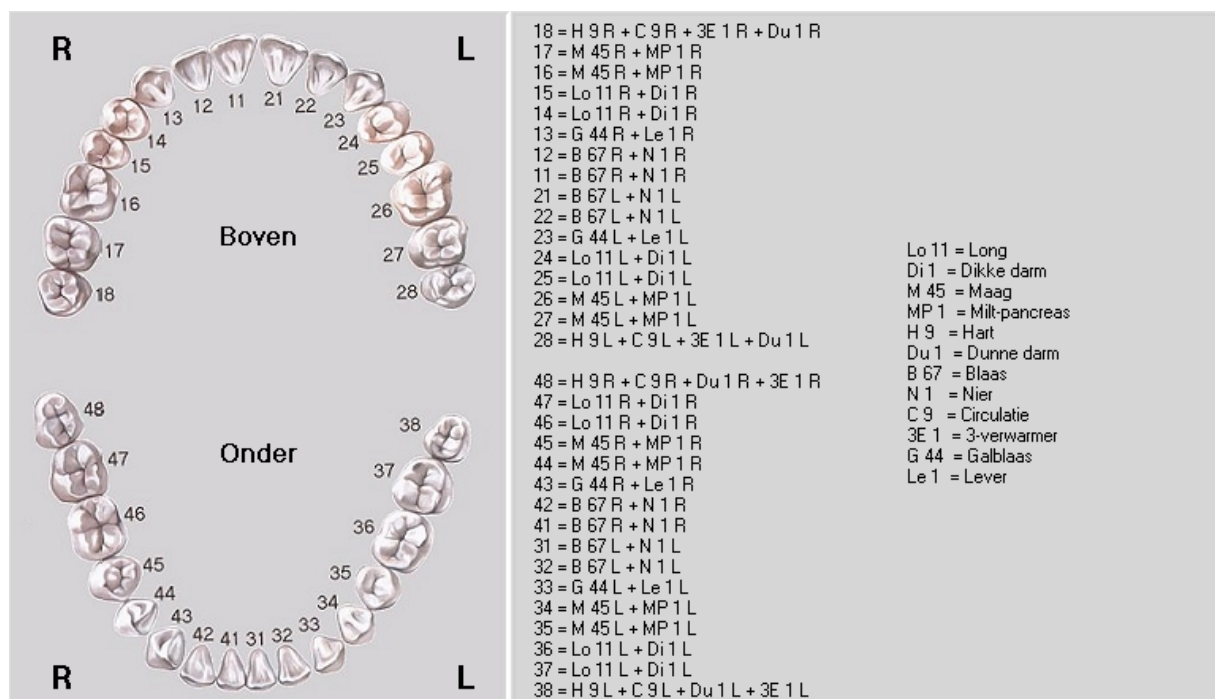

Meta-analyse

Meridianen	Tand afwijkingen	Meta-analyse	TEST RESULTATEN (van de consult metingen)		
SEQ.	Middel	Rang	Score	%Variatie	
5	Vermouth	1	37,2	+ 4	
18	provocation	2	62,4	- 5	
20	chakratron 1 chakra 1 ear	3	87,7	+ 34	
17	de-switching	4	89,8	- 48	
3	Schisandra	5	93,4	+ 21	
4	Weihrauch	6	116,2	- 4	
12	beamer chakra 1	7	121,1	- 81	
13	Control	8	141,4	+ 22	
7	Juglanisan	9	157,6	- 9	

Dit scherm geeft inzicht in twee aspecten:

- De energie toename ;
- De kwaliteit van de energie: werkt een middel harmoniserend. Een middel werkt harmoniserend wanneer het de score verlaagt.

Een meting krijgt een groene kleur in de tabel wanneer het middel een energie-toename veroorzaakt (of hooguit een minimale afname (= grijze zone) **en** harmoniserend werkt. Van een harmoniserende werking is sprake wanneer de energie niveaus van de meridianen minder van elkaar verschillen dan in de voorgaande meting. Het middel met de laagste score werkt het meest harmoniserend.

We zoeken middelen die én energie geven (als er sprake is van een energie-tekort van het hele systeem of aan een van de zwakke meridianen) én die gelijktijdig harmoniserend werken.

Middelen die in de tabel van een rode kleur worden voorzien werken disharmonie in de hand. Wanneer men voedingsmiddelen test dan vindt men onder de rood-gekleurde middelen de verwekkers van overgevoeligheidsreacties van allergische reacties.

14	control	14	245,6	+ 17
15	Schisandra	15	271,0	+ 2
9	Coffee milk	16	276,9	+ 6
11	LP renostimutron bl67both	17	277,0	- 18
10	LP detoxin sin. left ear	18	299,5	+ 5
19	new basic	19	308,7	- 49
8	digestron Li3, Li4 LP	20	330,2	+ 14

Attentie:

De tabellen laten vereenvoudigingen van de werkelijke reacties zien.

We bevelen het daarom aan de tabellen te gebruiken voor een eerste schifting en vervolgens helpen de curven om de definitieve keuze te bepalen.